

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0171 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : DC POWER SUPPLY

Fabricante : HEWLETT PACKARD

Modelo / Número de Parte : 6267B **Número de Serie** : 1539A02537

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,8°C **Humedad Relativa** : 40%

Procedimiento : 33K1-4-25-1, 30 SEPTEMBER 2000, CHANGE 11 - 30 NOVEMBER 2005

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	02-feb-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

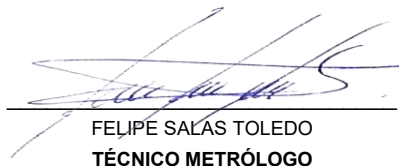
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0171

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
		10,01	10,00	10,00	-0,01	0,80
		20,17	20,00	20,00	-0,17	0,80
		30,25	30,00	30,00	-0,25	0,80
		40,26	40,00	40,00	-0,26	0,80
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
TERMINAL FRONTAL		A	A	A	A	A
		1,019	1,000	1,000	-0,019	0,20
		2,025	2,000	2,000	-0,025	0,20
		3,030	3,000	3,000	-0,030	0,20
TERMINAL TRASERO		A	A	A	A	A
		2,011	2,000	2,000	-0,011	0,20
		4,027	4,000	4,000	-0,027	0,20
		6,055	6,000	6,000	-0,055	0,20
		8,037	8,000	8,000	-0,037	0,20
		9,963	10,000	10,000	0,037	0,20
Ripple Noise	3 A / 40 V	0,474 mV				

FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración