

Certificado de Calibración*Calibration Certificate*

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo / Work Order : CG6925755998
Fecha Emisión / Emission Date : 05 de junio de 2025
S. S. C. C. : 1670070

Objeto / Object : Reloj Comparador Digital
Fabricante / Manufacturer : Facom
No. de Parte / Part No. : 1365
No. de Serie / Serial No. : 39150
Rango / Range : 0 mm – 12,5 mm
Resolución / Resolution : 0,001 mm
ID. ENAER : FA-0303
ID. F.A.CH. : -----
Procedimiento / Procedure : T.O. 33K6-4-889-1

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard	MAQ MED UNIVERS
Modelo / Model	828PC-WIN
No. Serie / Serial number	1176/05
Certificado No. / Certificate N°	060824SP0001
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Vencimiento / Due	06 de agosto de 2025
Emisor / Origin	ENAER – CHILE
Trazabilidad / Traceability	NIST – U.S.A.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

Las unidades de medición realizadas están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

Resultados de Calibración
Calibration Results

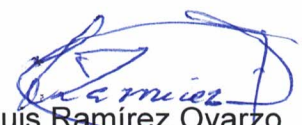
Lectura del I.B.C.	Lectura ($\bar{x}$) Patrón	Error ($\bar{x}$)
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,000
0,100	0,100	0,000
0,300	0,301	-0,001
0,800	0,800	0,000
1,500	1,501	-0,001
2,000	2,000	0,000
2,500	2,501	-0,001
3,000	3,000	0,000
3,500	3,501	-0,001
4,000	4,000	0,000
4,500	4,501	-0,001
5,000	5,000	0,000
7,500	7,502	-0,002
10,000	10,000	0,000

U. Total $k=2$	0,002 mm
Exactitud Entregada por el Fabricante	$\pm 0,005$ mm
Lugar de Calibración / Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,0°C $\pm$ 2°C 49,1% H. R. $\pm$ 3% H. R.

Fecha de Calibración/Calibration Date : 05 de junio de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date : 05 de junio de 2026


 José Guerrero Araya
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory

Página / Page 2 of 2