

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
 Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
 Orden de Trabajo / Work Order : CG6925760190
 No. Remisión / Remission Number : SSCC: 1742708
 Fecha de Emisión / Emission Date : 24/11/ 2025

 Objeto / Object : Micrómetro Interior de Tres Contactos
 Fabricante / Manufacturer : Mitutoyo
 No. de Parte / Part Number : 368-101
 No. de Serie / Serial Number : 60949
 Rango / Range : 6 mm – 8 mm
 Resolución / Resolution : 0,001 mm
 Código FACH : S/C
 No. de Control ENAER : FA-1065
 Procedimiento / Procedure : T. O. 33K6-4-15-1

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard	: Ring Gage Set
Fabricante / Manufacturer	: Starrett
Modelo / Model	: Master Class X
No. Control / Control Number	: ST-0058
No. Serie / Serial Number	: S/S
No. Certificado / Certificate Number	: 290425ST0058
Vencimiento / Due	: 29/04/2026
Emisor / Origin	: ENAER
Trazabilidad / Traceability	: NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

Valor del Patrón (mm)	Lectura del Equipo en Ensayo (mm)	Desviación (mm)
6,000 (X)	6,001	0,001
8,000 (X)	7,999	-0,001

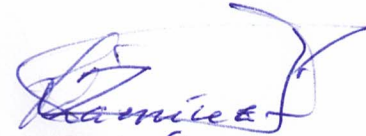
Observaciones / Observations:

Fecha de Calibración / Calibration Date: 24 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento / Due Date: 24 de noviembre de 2026

U. Total $k=2$	0,001 mm
Exactitud del Fabricante / Manufacturer Accuracy	$\pm 0,002$ mm
Lugar de Calibración / Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,3 °C ± 1 °C (46,2 % $\pm 0,3$)% H. R.


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory