Reporte técnico de secuenciación

1. Datos de la corrida

Corrida	RUN-2609
Panel	Panel Hereditario 50 genes
Muestras procesadas	12
Fecha de emisión	29/09/2026


2. Resumen ejecutivo

La corrida RUN-2609 incluyó 12 muestras del Panel Hereditario 50 genes. 6 muestras resultaron aptas, 2 aptas con observaciones y 4 no aptas para reporte. Las causas de rechazo fueron: clasificación no ACMG (1 muestra), cobertura media insuficiente (1 muestra), uniformidad de cobertura baja (%≥20x) (1 muestra), calidad de bases baja (%Q30) (1 muestra), lecturas insuficientes (1 muestra), VAF fuera de rango (1 muestra). Se identificaron variantes patogénicas o probablemente patogénicas en: TP53 (1), BRCA1 (1), CHEK2 (1). Los resultados deben ser revisados y firmados por el responsable técnico.

Fuente del texto: Plantilla automática

3. Control de calidad por muestra

Muestra	Tipo	Lecturas	%Q30	%Dup	Cob. media	%≥20x	Estado
BS-2609-01	Sangre periférica	3,858,253	94.5	8.7	377	96.4	APTA
BS-2609-02	Saliva	4,944,390	86.5	8.5	284	96.3	APTA
BS-2609-03	Tejido FFPE	2,880,477	91.0	15.9	407	98.4	NO APTA
BS-2609-04	Sangre periférica	4,945,266	94.5	13.6	414	96.2	NO APTA
BS-2609-05	Saliva	620,000	88.6	9.6	48	81.2	NO APTA
BS-2609-06	Tejido FFPE	3,258,021	86.9	10.6	203	98.7	APTA
BS-2609-07	Sangre periférica	4,867,132	86.5	17.5	283	97.2	APTA CON OBSERVACIONES
BS-2609-08	Saliva	4,956,024	94.3	11.5	223	99.0	APTA
BS-2609-09	Tejido FFPE	2,843,324	74.5	20.3	355	97.1	NO APTA
BS-2609-10	Sangre periférica	2,807,026	87.1	18.6	216	97.9	APTA
BS-2609-11	Saliva	2,664,447	94.7	34.8	369	99.1	APTA CON OBSERVACIONES
BS-2609-12	Tejido FFPE	3,926,576	92.3	16.1	290	99.2	APTA

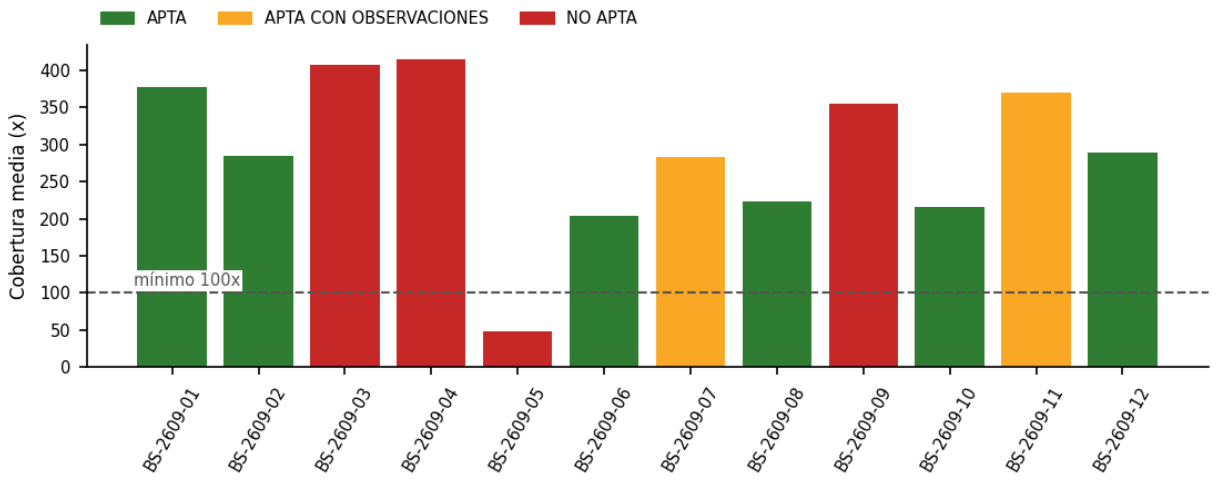

4. Variantes patogénicas / probablemente patogénicas

Solo se listan variantes de muestras aptas. Clasificación según ACMG/AMP.

Muestra	Gen	Cromosoma	Posición	HGVS c.	VAF	Prof.	Clasificación
BS-2609-01	BRCA1	17	43,094,464	c.5266C>T	0.49	318	Patogénica
BS-2609-07	TP53	17	7,674,220	c.743G>A	0.48	12	Patogénica
BS-2609-08	CHEK2	22	28,695,868	c.1100C>T	0.51	264	Probablemente patogénica

5. Observaciones de validación

7 errores y 2 advertencias detectados automáticamente.

Nivel	Archivo	Muestra	Detalle
ERROR	variants	BS-2609-03	BRCA2 c.7007G>A: VAF=1.35 fuera de [0,1]
ERROR	variants	BS-2609-04	MLH1 c.1852A>G: clasificación 'Maligna' no es ACMG
ERROR	qc_metrics	BS-2609-05	lecturas insuficientes: total_reads = 620,000 < 1,000,000
ERROR	qc_metrics	BS-2609-05	cobertura media insuficiente: cobertura_media = 48.3 < 100
ERROR	qc_metrics	BS-2609-05	uniformidad de cobertura baja (%≥20x): pct_bases_20x = 81.2 < 90
ERROR	qc_metrics	BS-2609-09	calidad de bases baja (%Q30): pct_q30 = 74.5 < 75
ERROR	qc_metrics	BS-2609-99	sample_id no existe en samplesheet
WARN	variants	BS-2609-07	TP53 c.743G>A: profundidad=12 < 20
WARN	qc_metrics	BS-2609-11	duplicación alta: pct_duplicados = 34.8 > 30

6. Aprobación

_____ _____

Elaborado por Revisado y aprobado por