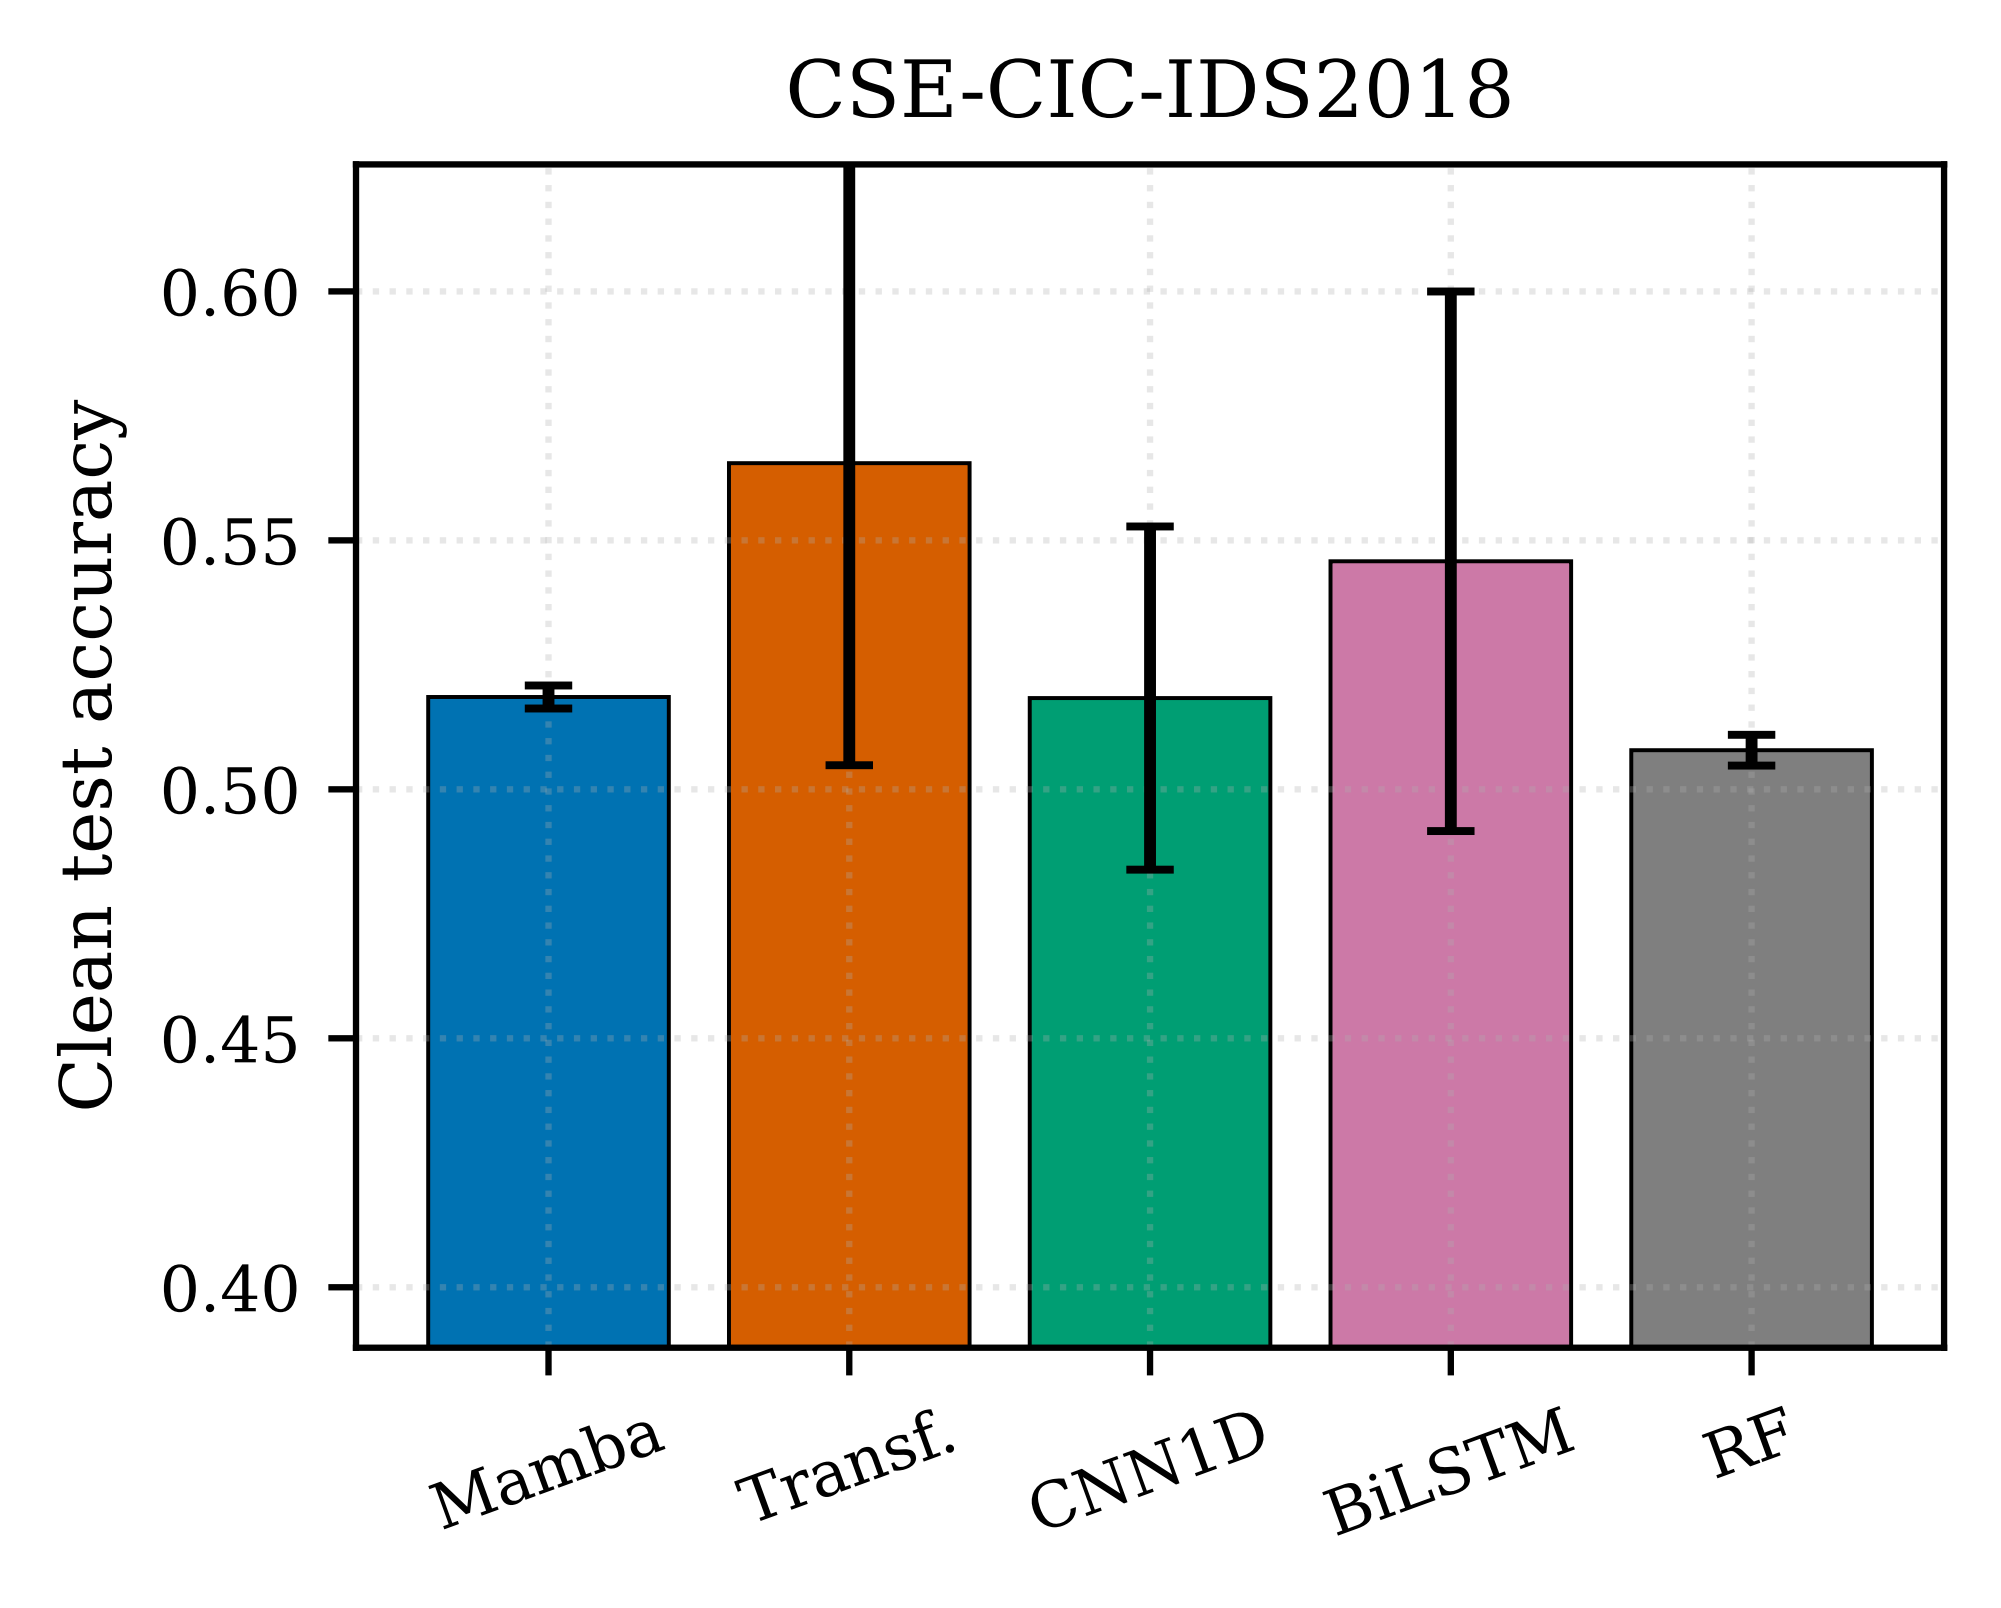
CSE-CIC-IDS2018
Clean test accuracy
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
Mamba
Transf.
CNN1D
BiLSTM
RF