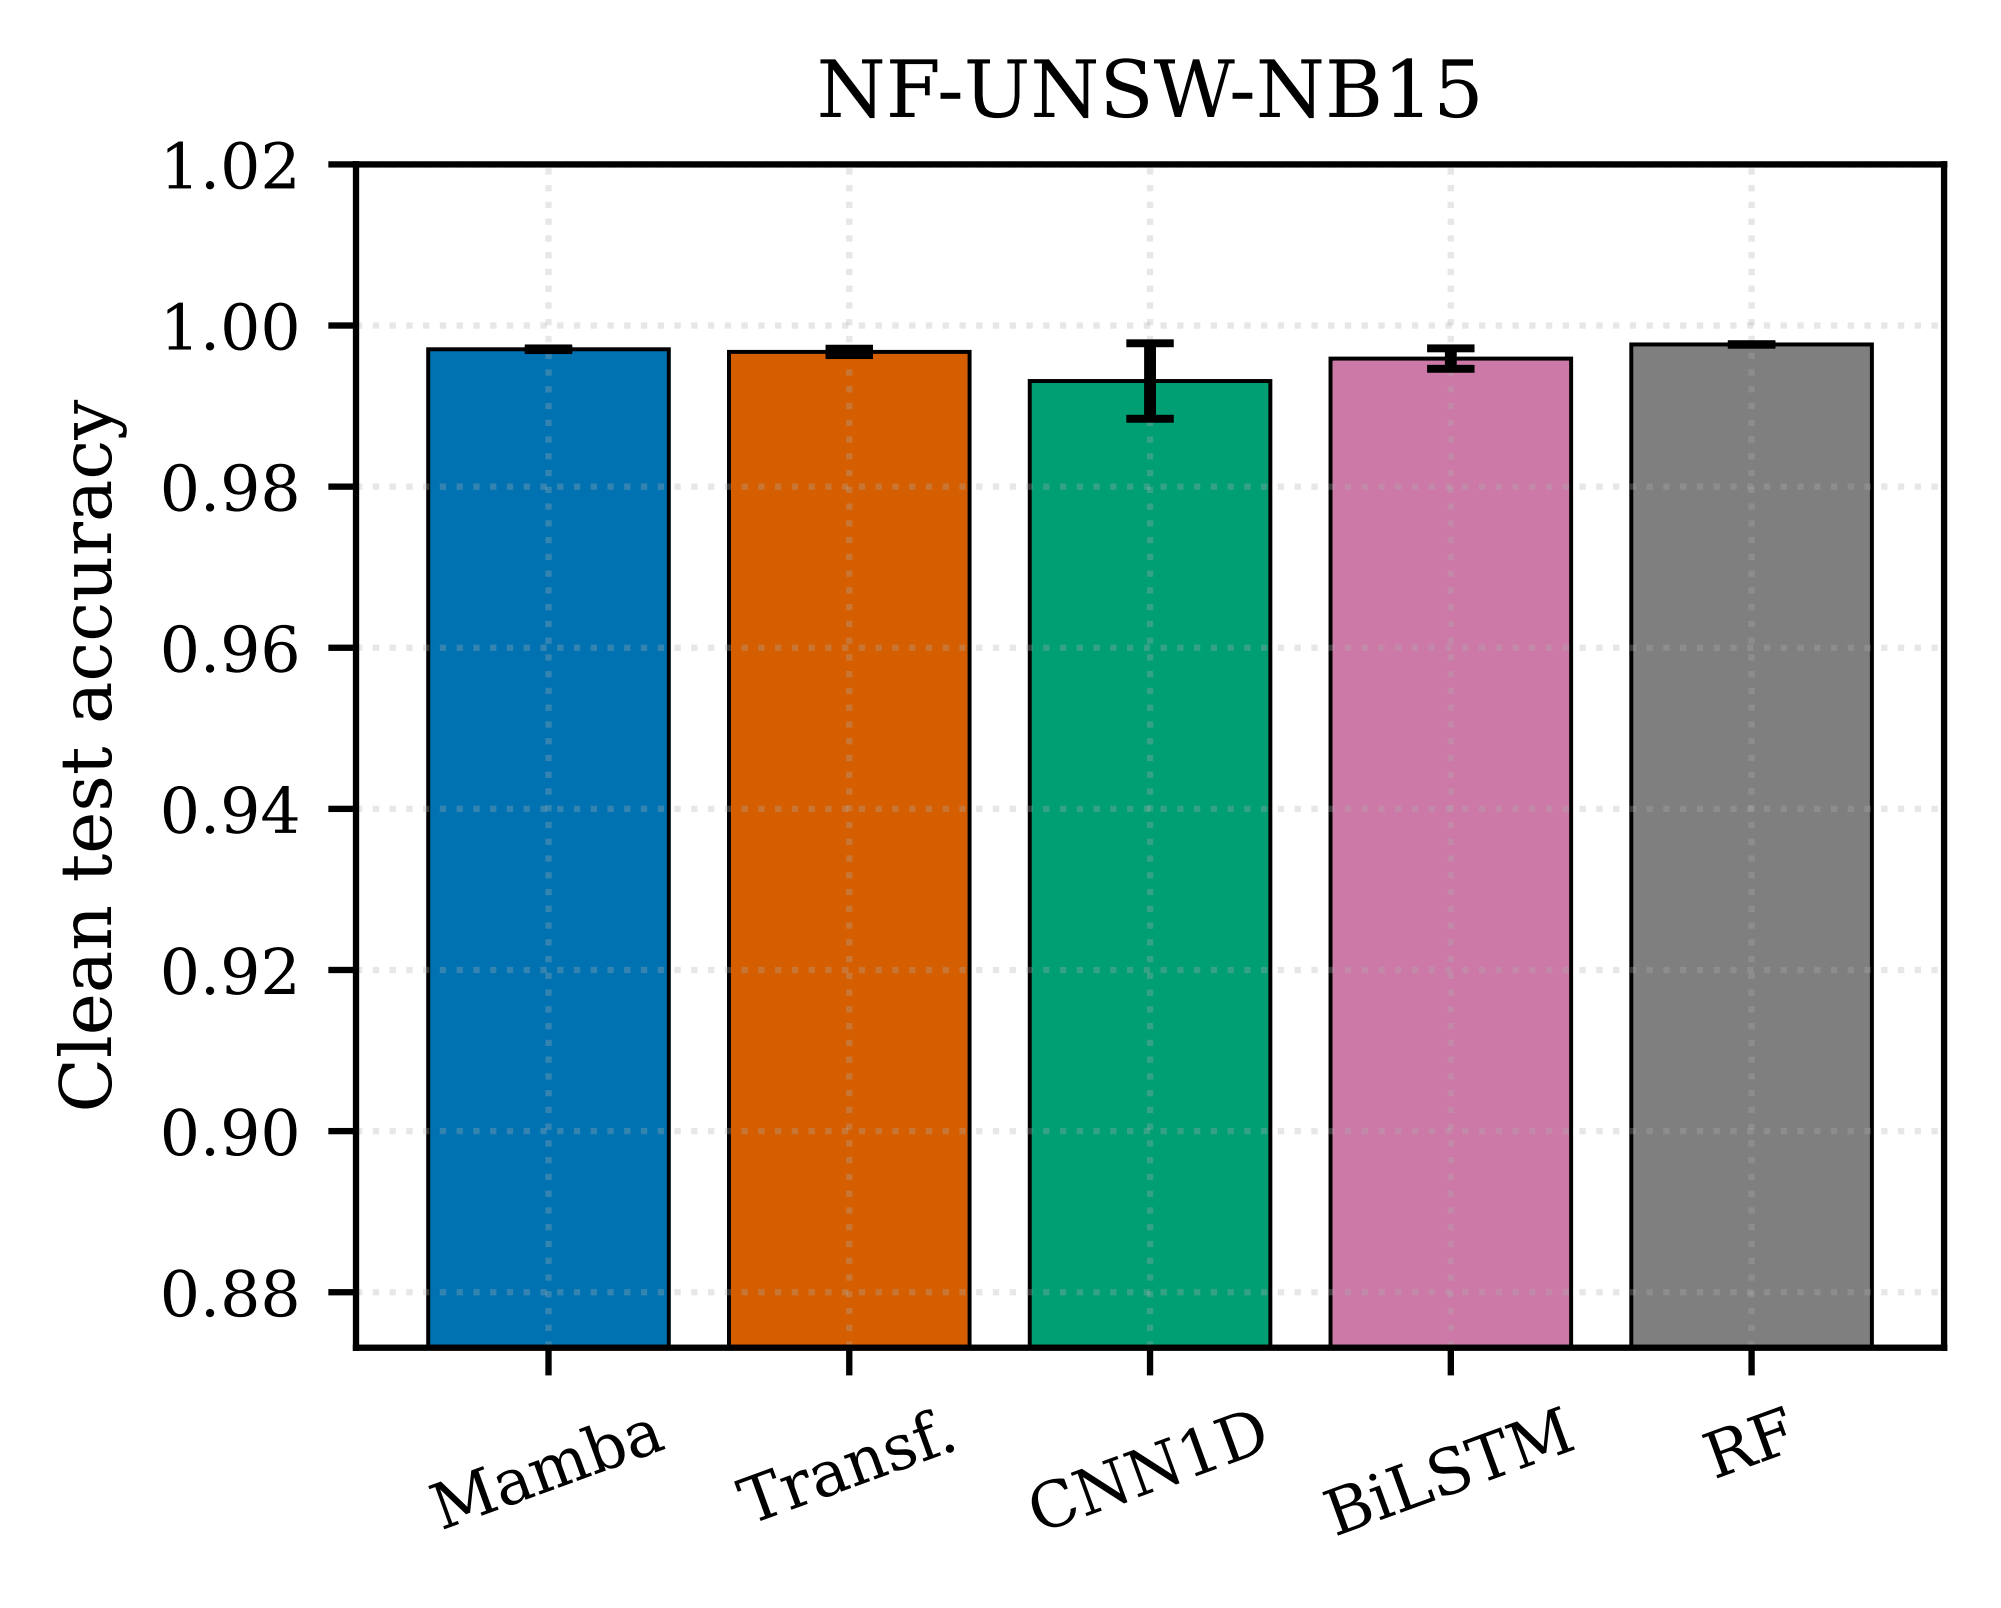
NF-UNSW-NB15
Clean test accuracy
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
Mamba
Transf.
CNN1D
BiLSTM
RF