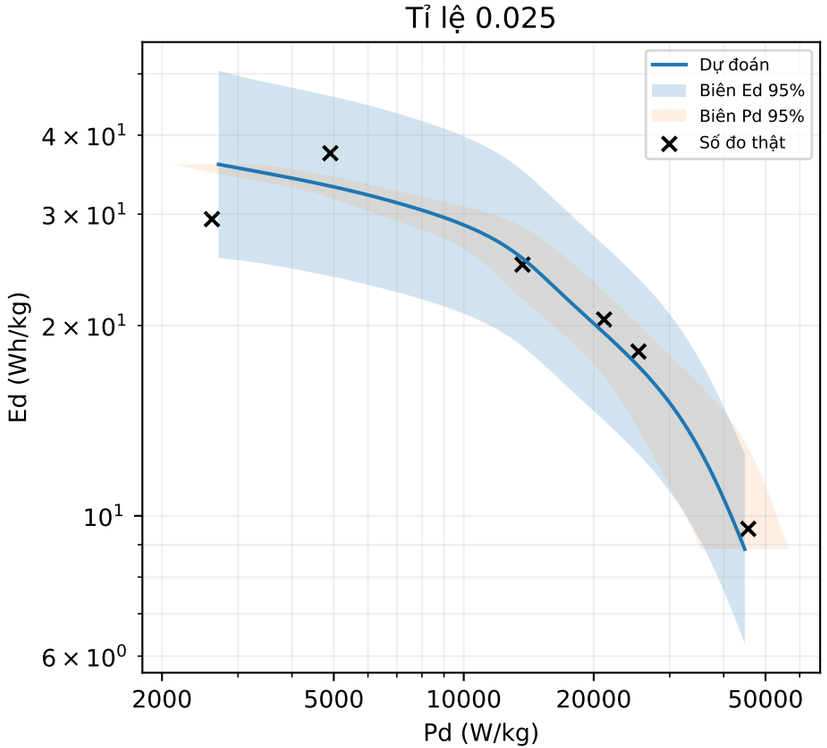

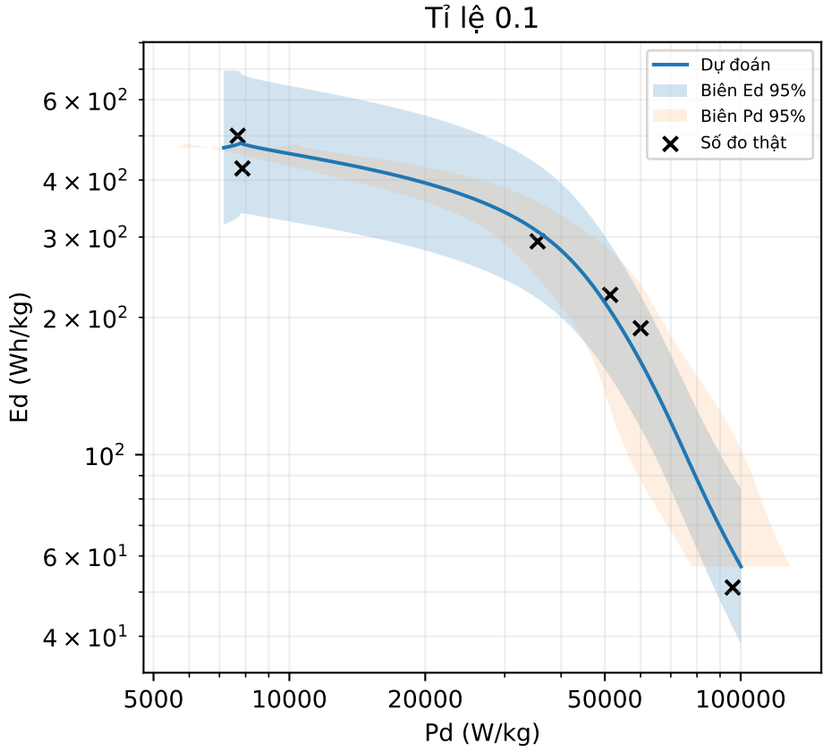

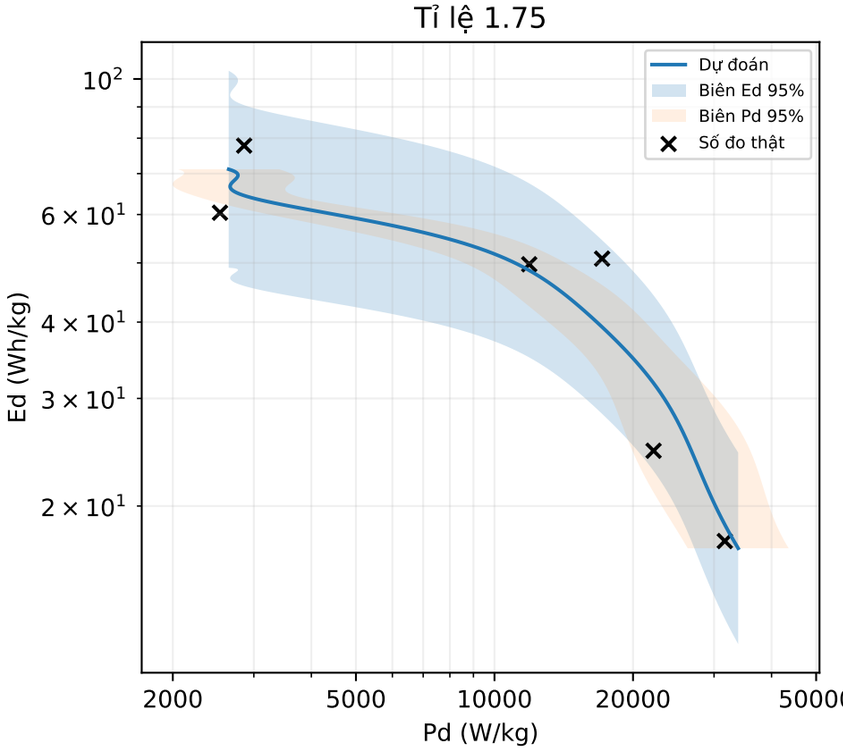

khớp lại để sử dụng, không phải kết quả kiểm tra; mô hình gpr, cách A (chỉ số đo thật)
Biên Ed/Pd riêng, không phải khoảng đồng thời.