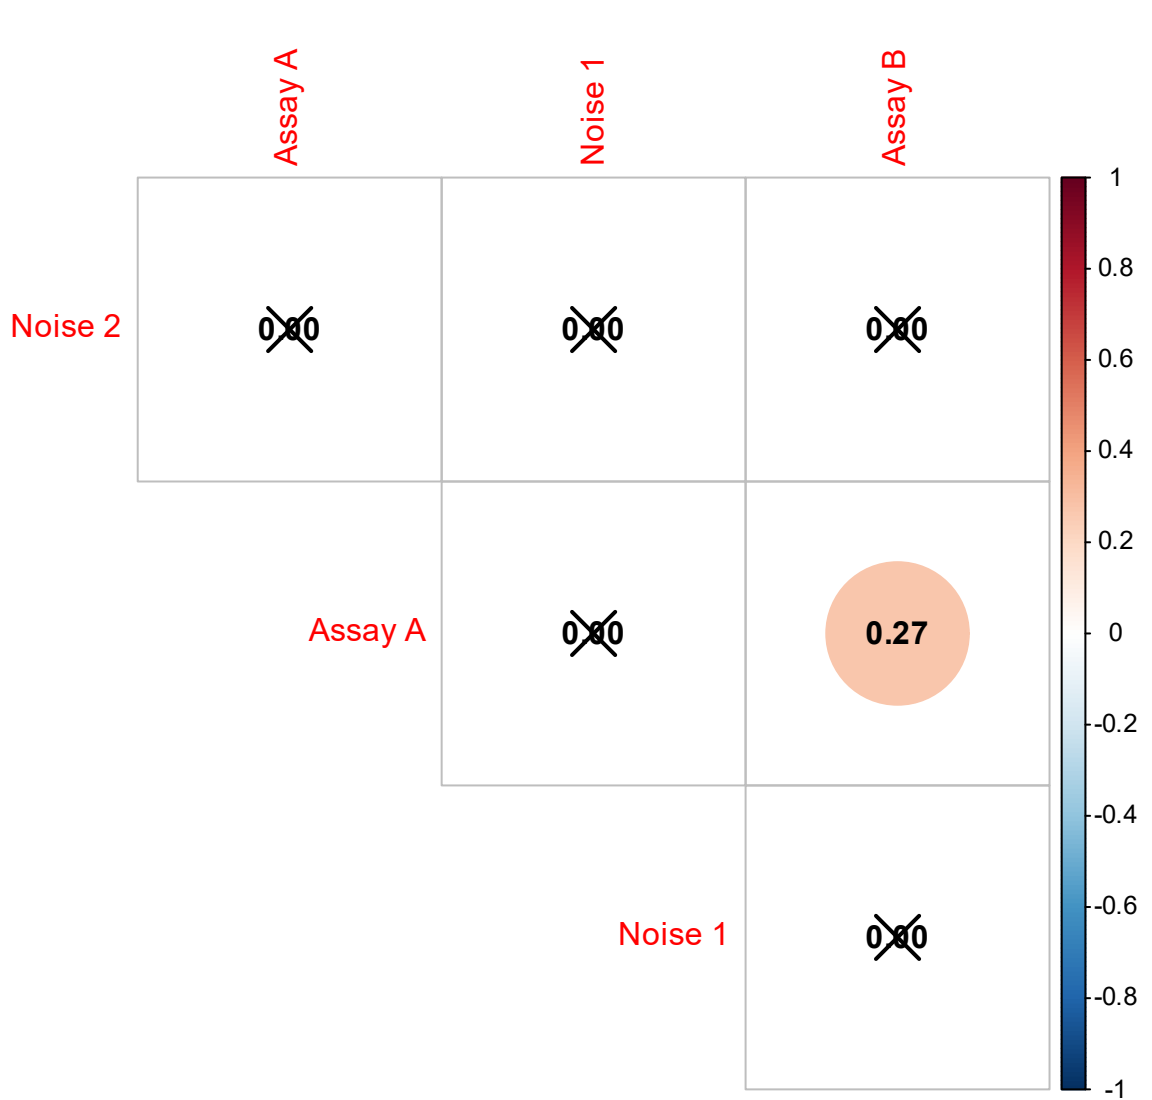
Assay A
Noise 1
Assay B
Noise 2
0.00
0.00
0.00
Assay A
0.00
0.27
Noise 1
0.00
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1