

## S-PARAMETERS

S\_Param

SP1

Start=0.5 GHz

Stop=6 GHz


Step=0.1 GHz

## OPTIONS

Options

Options1

Temp=16.85

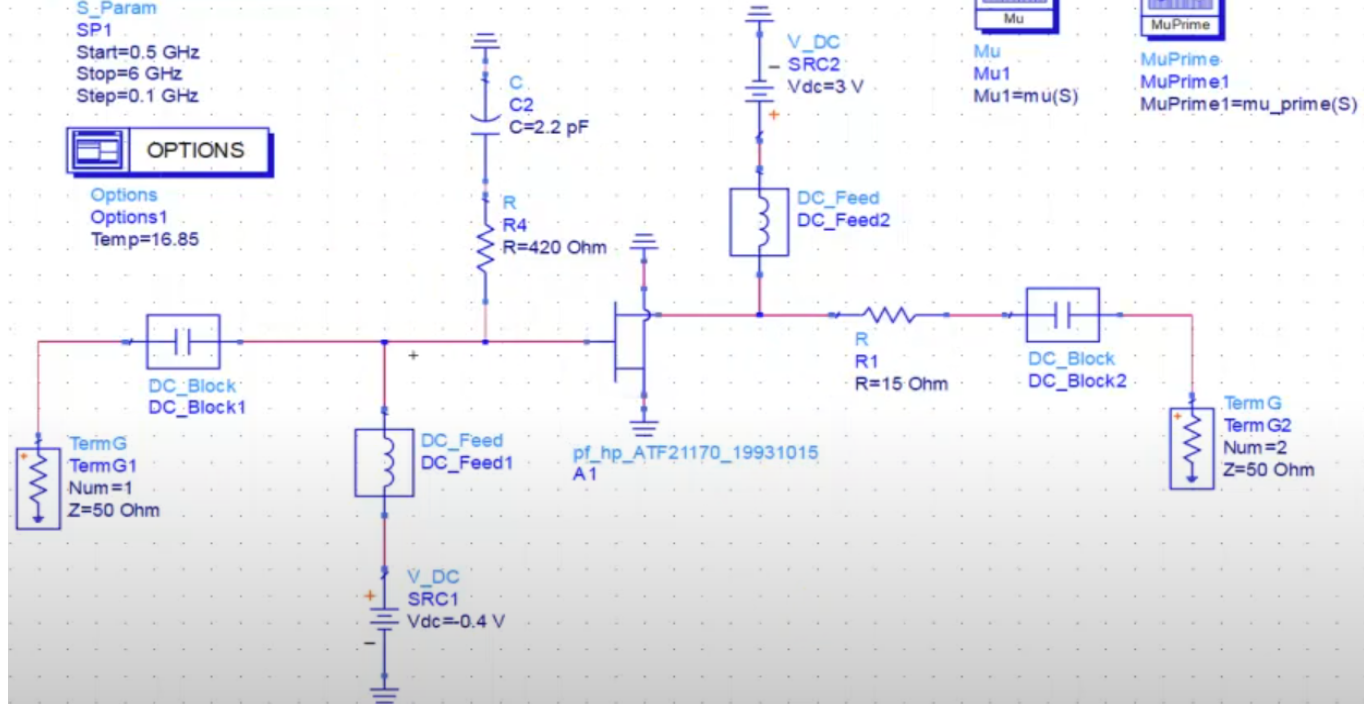

Mu  
Mu1  
Mu1=mu(S)



MuPrime  
MuPrime1  
MuPrime1=mu\_prime(S)