

## جدول کابل کشی تابلو سـانتـریفـیوژ اتاق عمل


کابل / سیم	سطح مقطع	محل
کابل-افشان	5 * 2.5	از منبع تامین سه فاز به تابلو سـانتـریفـیوژ
کابل - افشان	4 * 1	از محل فرمان (اضطراری) به تابلو سـانتـریفـیوژ
کابل -افشان	3 * 1	از تابلو سـانتـریفـیوژ به محل تاج پنل
کابل شیلد و فویل- مقنولـی	6 * 0.25	از تابلو سـانتـریفـیوژ به محل تاج پنل

لازم به ذکر می باشد در جدول بالا موارد ذیل رعایت شود

الف: کابل و سیم به تابلو سـانتـریفـیوژ  
حدود دو متر اضافه در نظر گرفته شود

ب: با توجه به محل جانمایی تاج پنل  
حدود یک متر کابل اضافه در نظر گرفته شود

ج: موارد مصرفی تابلو سـانتـریفـیوژ  
نول , ارت , R, S, T

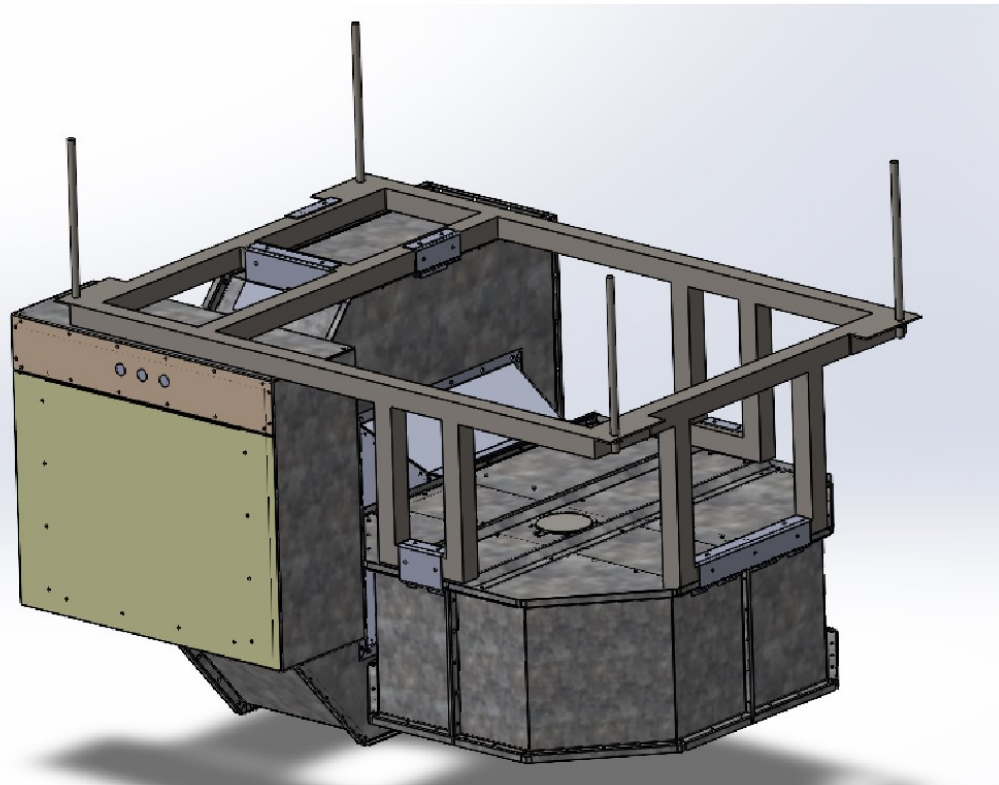

## سیستم الکتریکال سـانتـریفـیوژ

				1401/04/06
NAME	SIGNATURE	DATE		
DRAWN	VAKILZADEH	DWG NO.		
REVISION	Rev.	SCALE:1:1	SHEET 1 OF 5	

## شماتیک مسیر کابل کشی تابلو سـانتـریفیوژ اتاق عمل

	کابل 5 * 2.5	
از محل فرمان/اضطراری	کابل 4 * 1	
	کابل 6 * 0.25	
	کابل 3 * 1	

پیشنهاد می گردد محل قرار گیری تاج پـنـل در زیر ساعت و کرنومتر اتاق عمل قرار گیرد و ارتفاع از کف تمام شده اتاق عمل 180 سانتی متر باشد



لازم به ذکر می باشد که علاوه بر خاموش-روشن نمودن سـانتـریفیوژ از تاج پـنـل نقطه دیگری جهت اضطراری بودن تامین شده است نیاز به کابل فرمان به سطح مقطع کابل 4 \* 1 از محل اضطراری به تابلو سـانتـریفیوژ مورد نیاز می باشد در صورت صلاح دید انجام شود. در غیر اینصورت روی درب تابلو سـانتـریفیوژ نصب می گردد

## سیستم الکتریکال سـانتـریفیوژ

	NAME	SIGNATURE	DATE	1401/04/06
DRAWN	VAKILZADEH		DWG NO.	
REVISION	Rev.		SCALE:1:1	SHEET 2 OF 5

مشخات فنی تابلو سالتتریفیوژ اتاق عمل


W توان	A شدت جریان	HZ فرکانس	V ولتاژ
1500	4	50	380

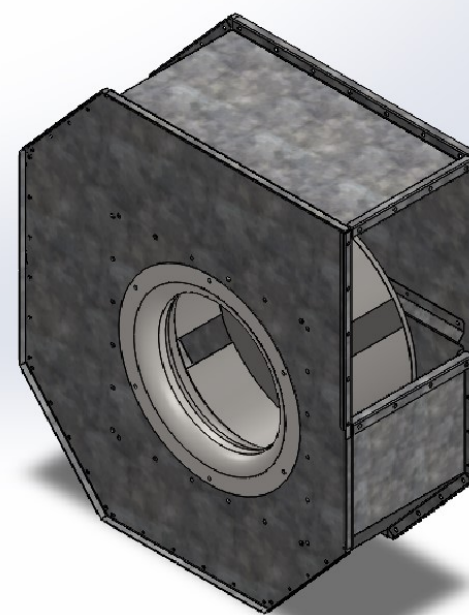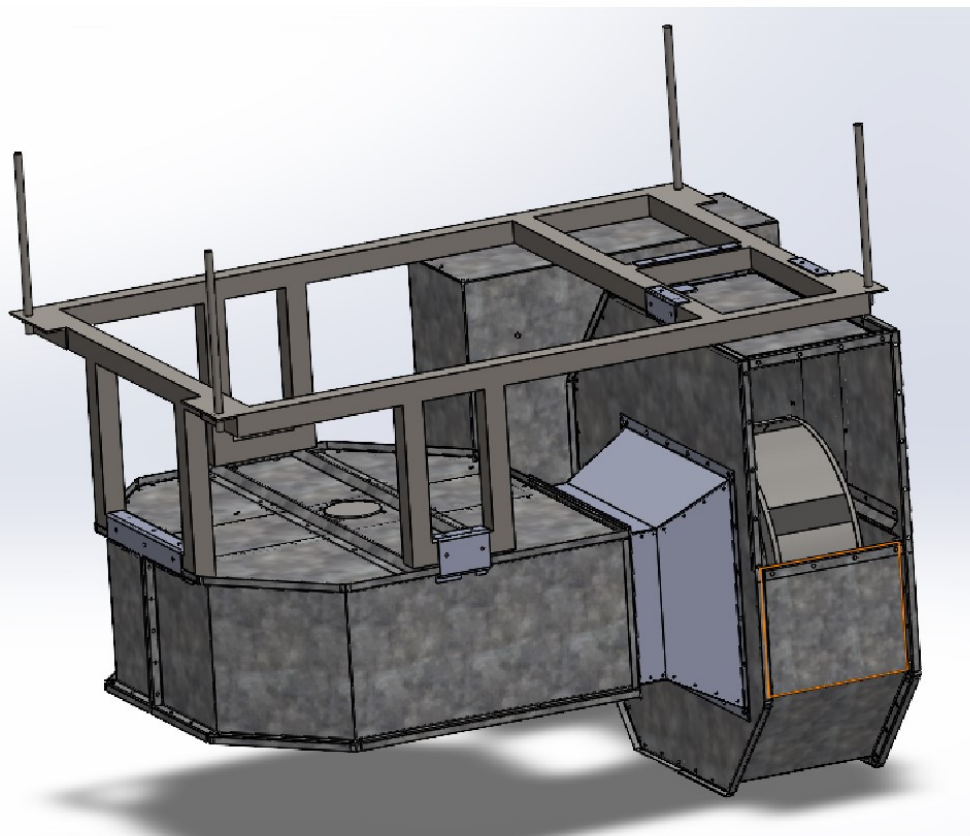

سیستم الکتریکال سالتتریفیوژ


				1401/04/06
	NAME	SIGNATURE	DATE	
DRAWN	VAKILZADEH		DWG NO.	
REVISION	Rev.		SCALE:1:1	SHEET 3 OF 5

### External Dimensions

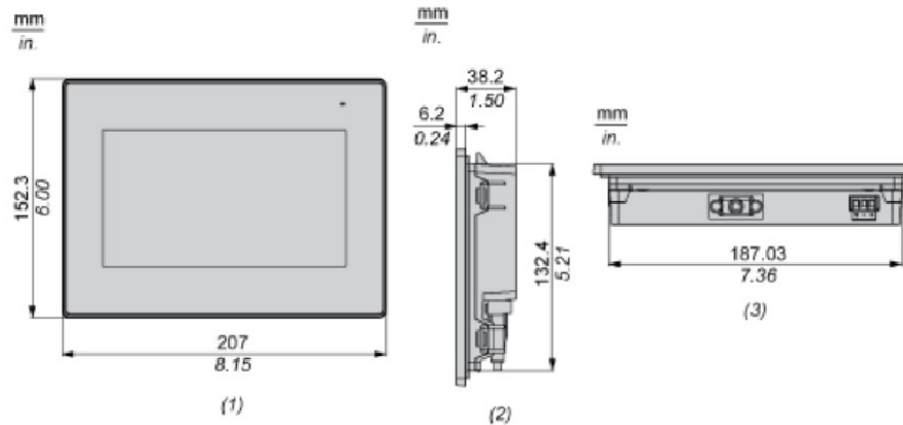

- (1) Front  
(2) Right  
(3) Bottom

### Panel Cut Dimensions

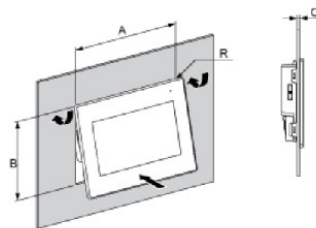


A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
190 <sup>+1</sup>	7.48 <sup>+0.04</sup>	135 <sup>+0.7</sup>	5.31 <sup>+0.03</sup>	1...5	0.04...0.19	3 max	0.12 max.

سیستم الکتریکال ساتر فیوژ

		NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	VAKILZADEH			1401/04/06
REVISION	Rev.			DWG NO.
				SCALE:1:1
				SHEET 4 OF 5

## Installation with Installation Fasteners

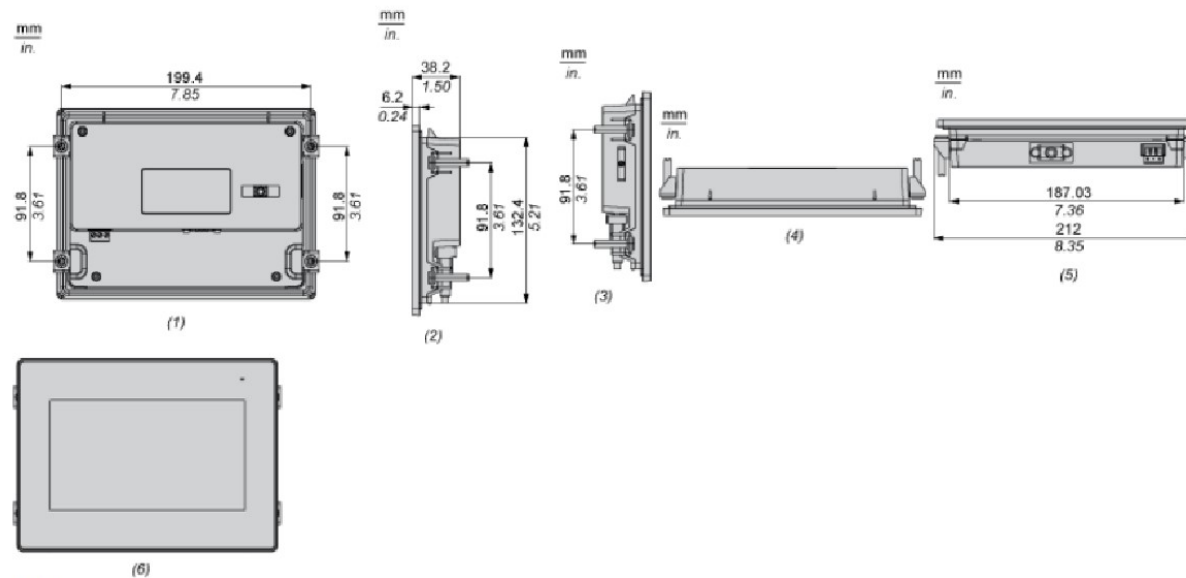

سیستم الکتریکال سالتریفیوژ

	NAME	SIGNATURE	DATE	1401/04/06
DRAWN	VAKILZADEH		DWG NO.	
REVISION	Rev.		SCALE:1:1	SHEET 5 OF 5