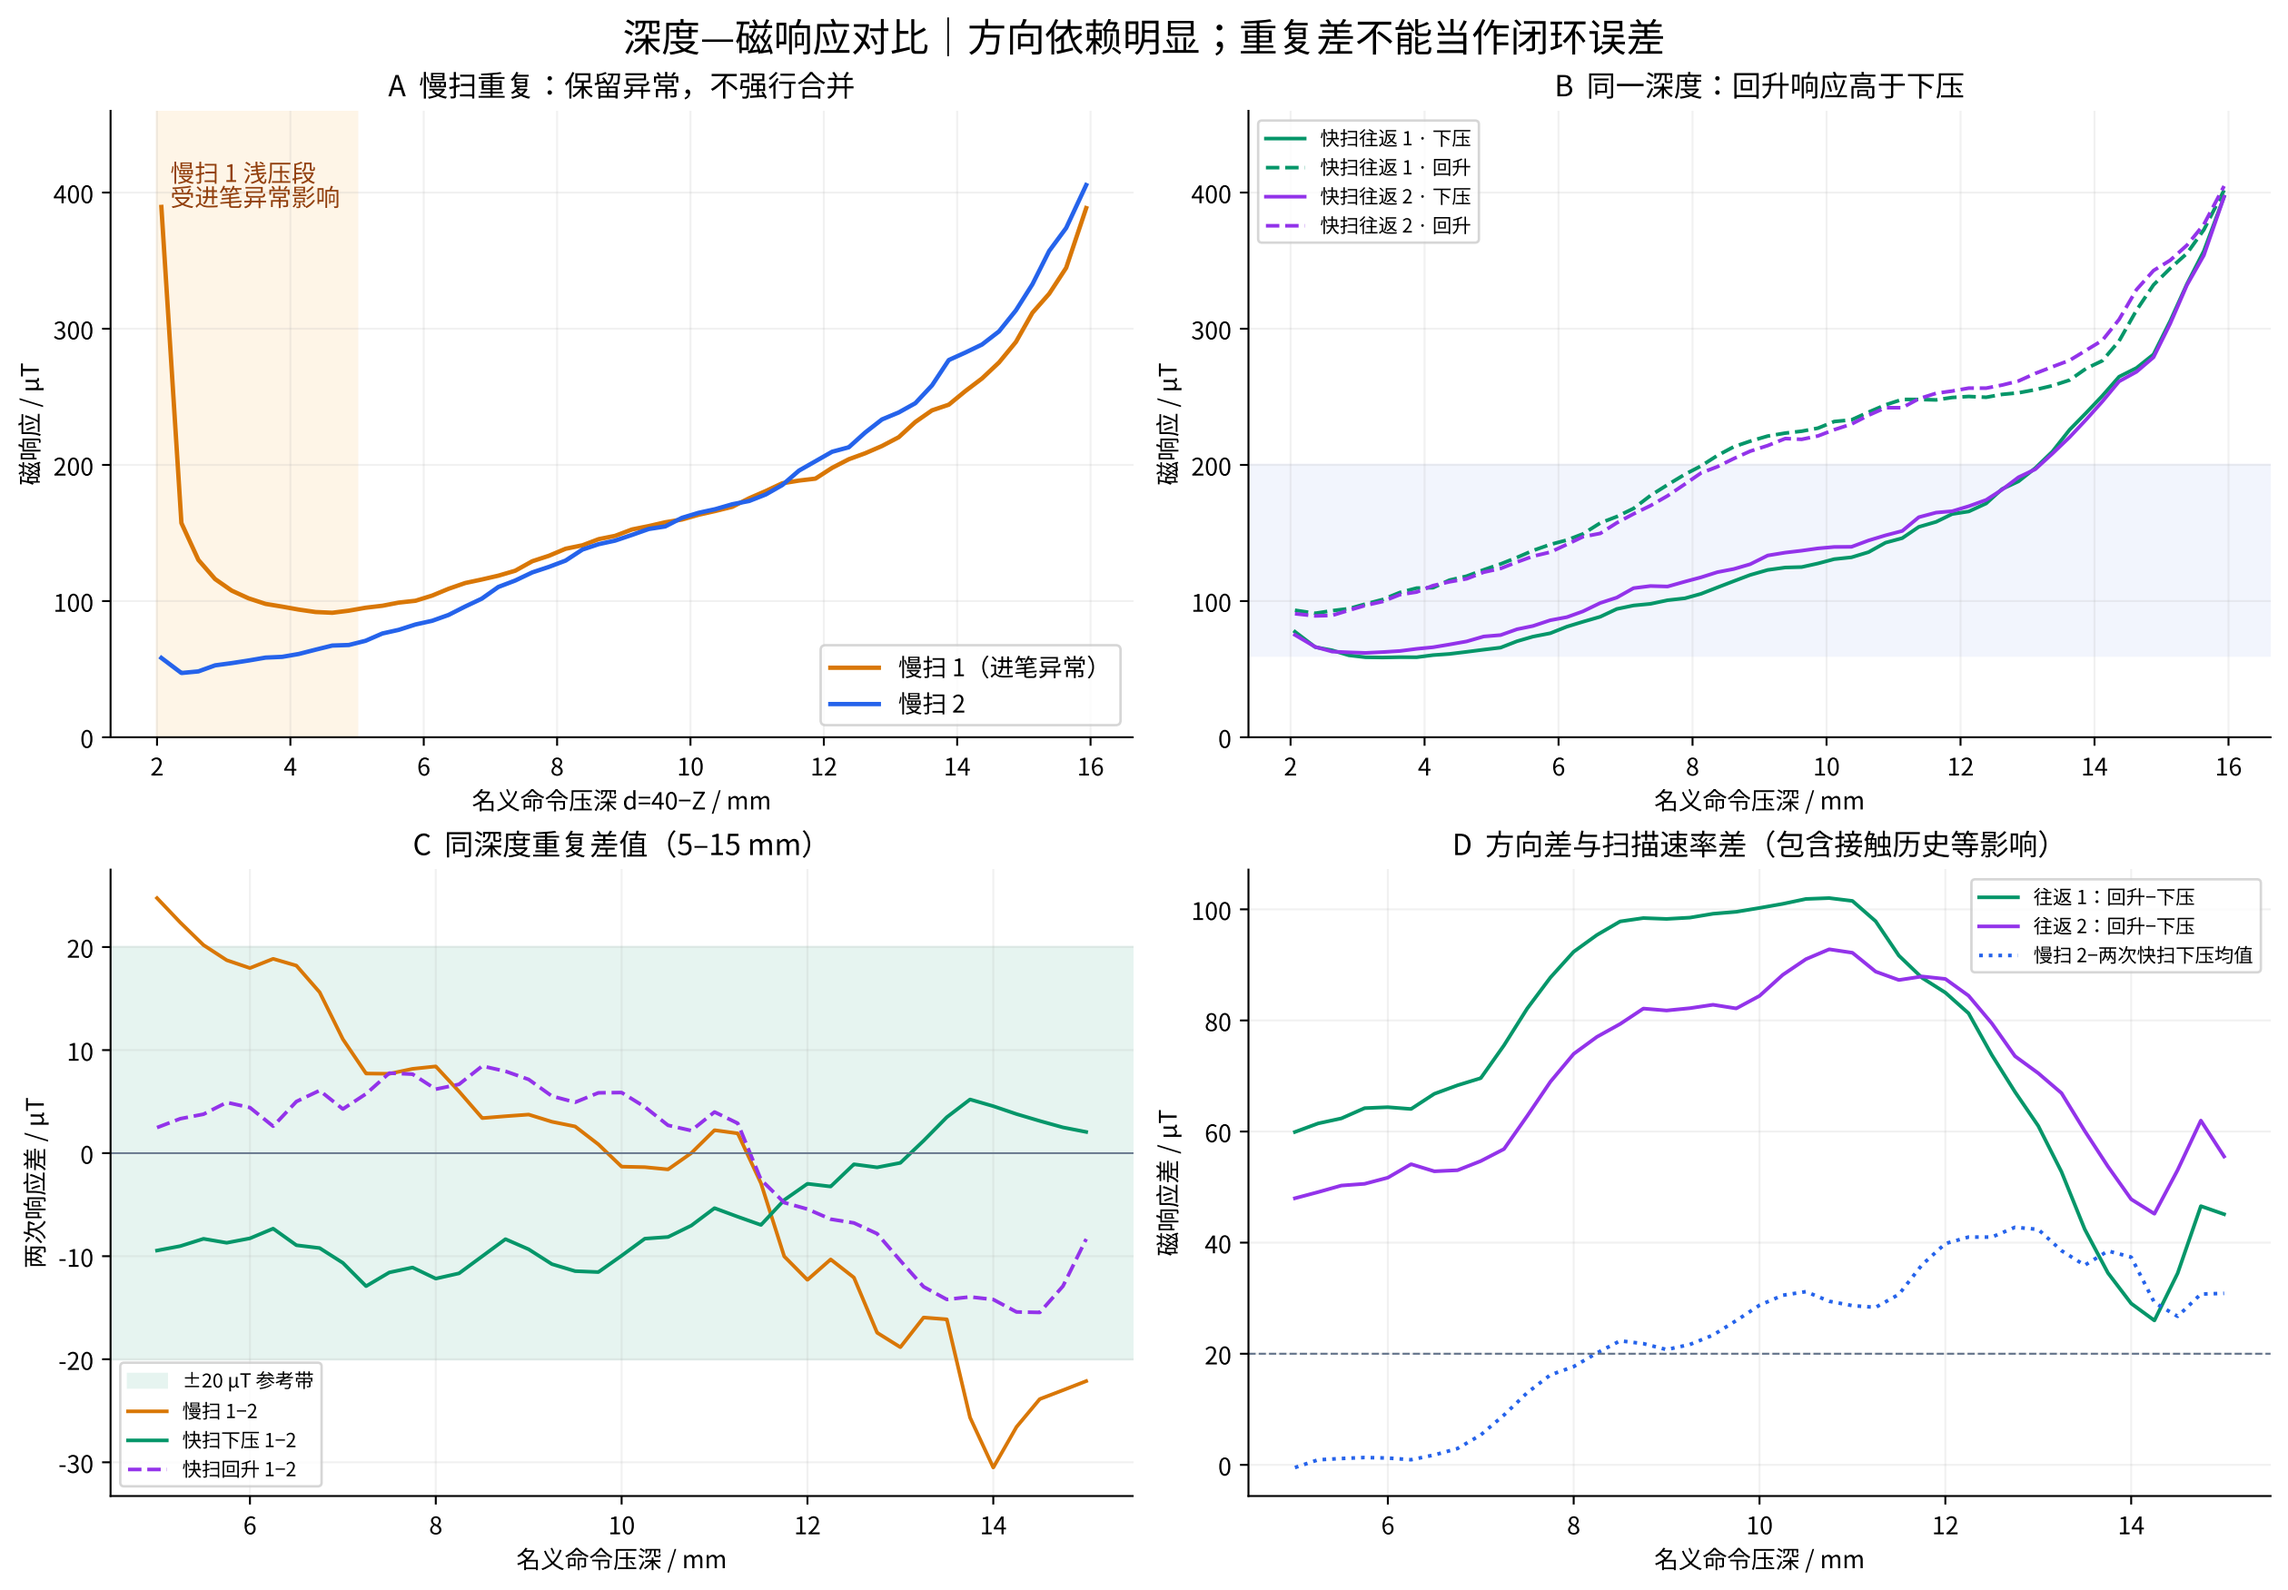
深度—磁响应对比｜方向依赖明显；重复差不能当作闭环误差
A 慢扫重复：保留异常，不强行合并
慢扫 1 浅压段
受进笔异常影响
慢扫 1（进笔异常）
慢扫 2
磁响应 / μT
名义命令压深 d=40−Z / mm
B 同一深度：回升响应高于下压
快扫往返 1 · 下压
快扫往返 1 · 回升
快扫往返 2 · 下压
快扫往返 2 · 回升
磁响应 / μT
名义命令压深 / mm
C 同深度重复差值（5–15 mm）
±20 μT 参考带
慢扫 1–2
快扫下压 1–2
快扫回升 1–2
两次响应差 / μT
名义命令压深 / mm
D 方向差与扫描速率差（包含接触历史等影响）
往返 1：回升−下压
往返 2：回升−下压
慢扫 2−两次快扫下压均值
磁响应差 / μT
名义命令压深 / mm