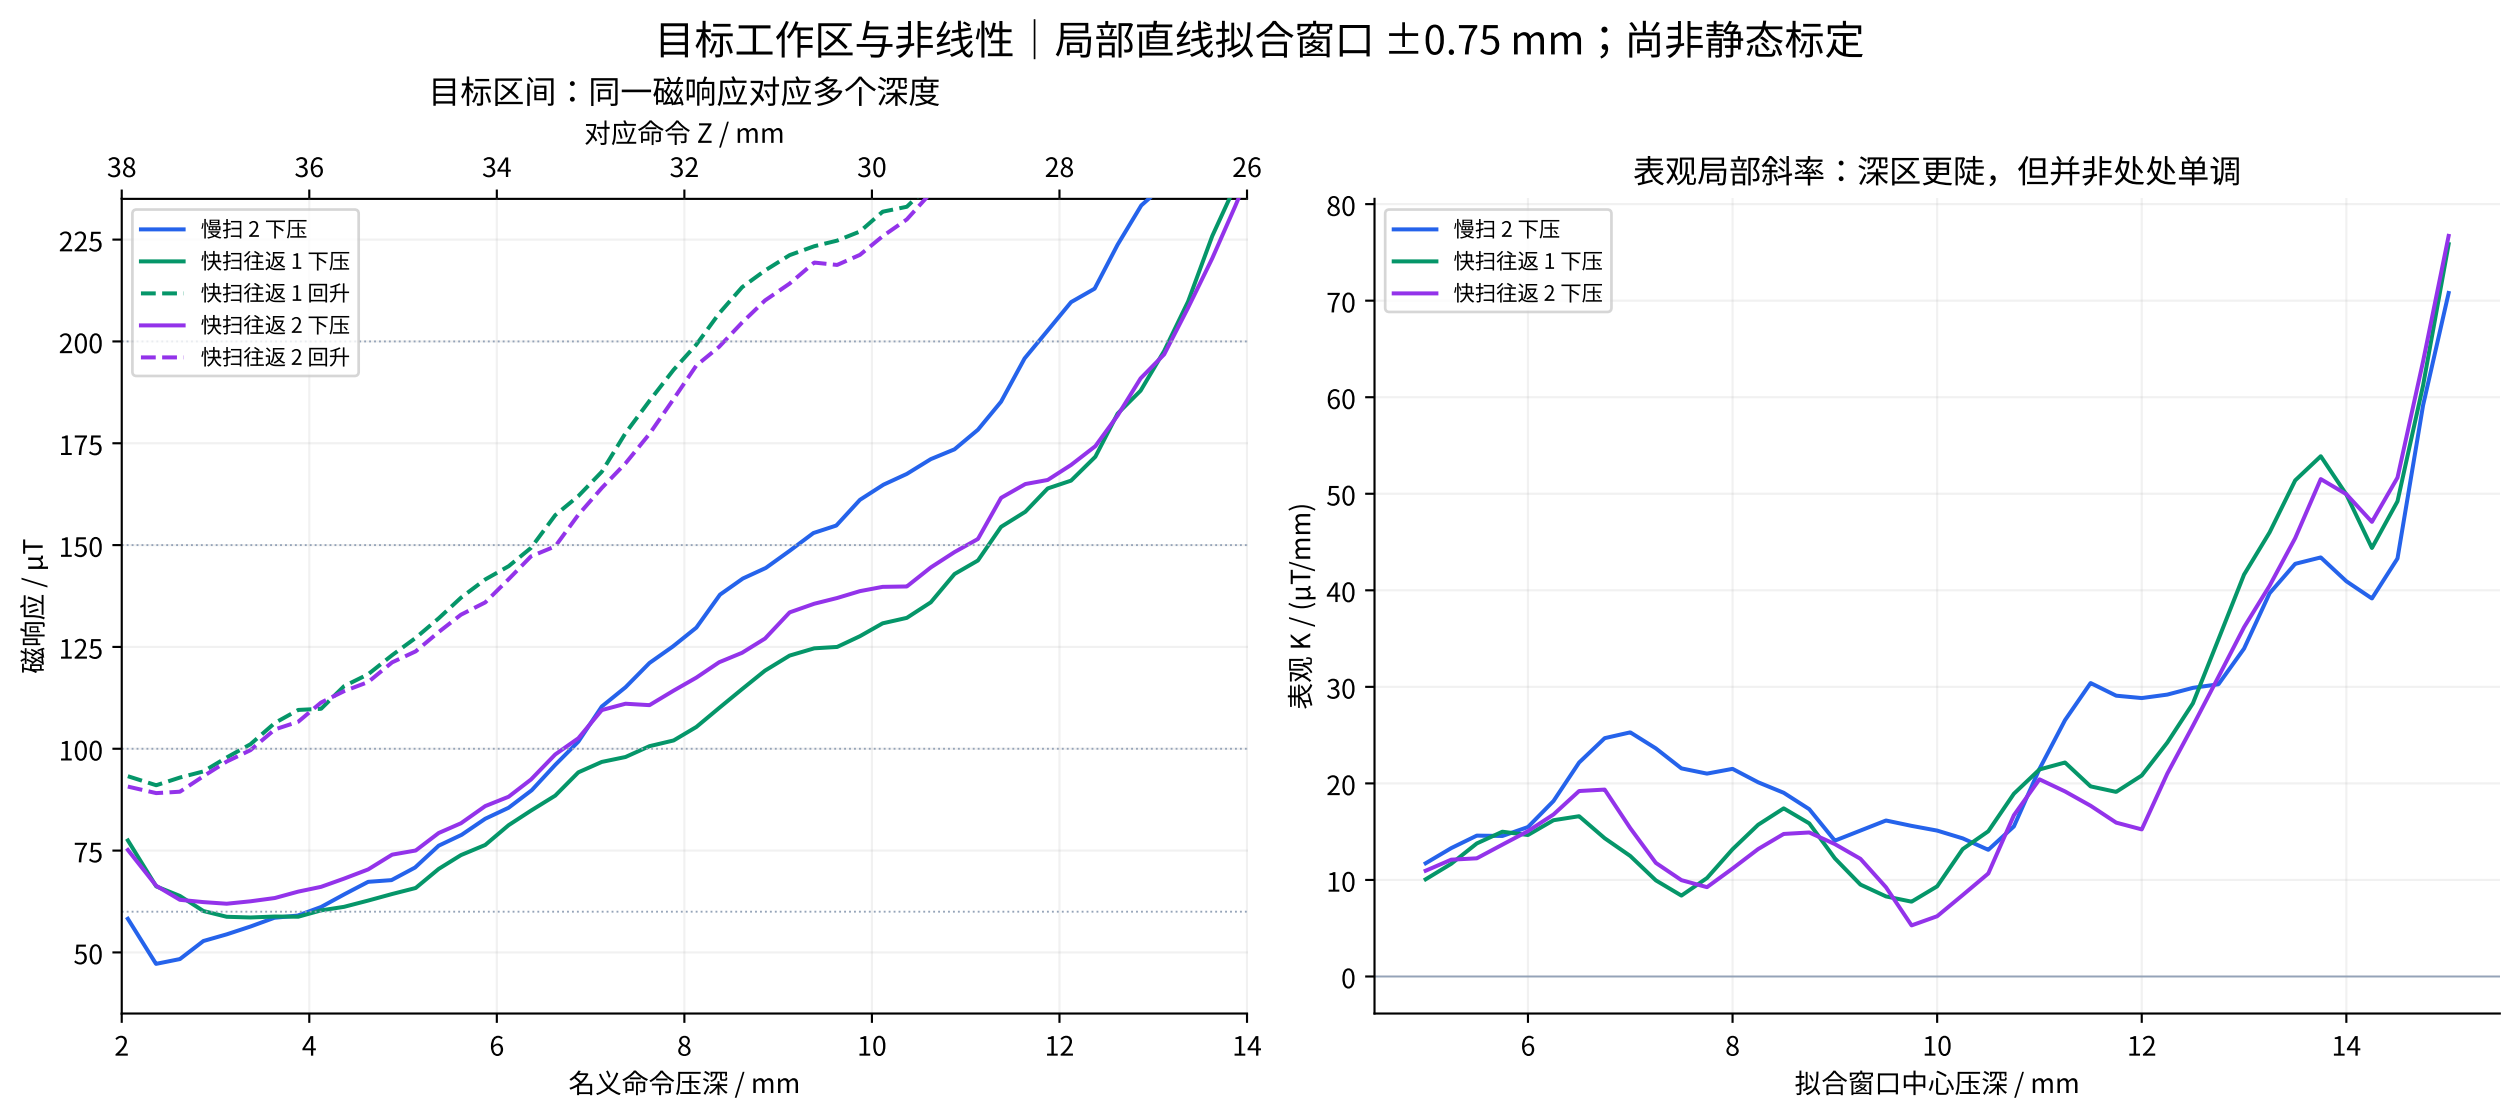
目标工作区与非线性｜局部直线拟合窗口 ±0.75 mm；尚非静态标定
目标区间：同一磁响应对应多个深度
对应命令 Z / mm
38
36
34
32
30
28
26
慢扫 2 下压
快扫往返 1 下压
快扫往返 1 回升
快扫往返 2 下压
快扫往返 2 回升
磁响应 / μT
225
200
175
150
125
100
75
50
2
4
6
8
10
12
14
名义命令压深 / mm
表观局部斜率：深区更陡，但并非处处单调
慢扫 2 下压
快扫往返 1 下压
快扫往返 2 下压
表观 K / (μT/mm)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6
8
10
12
14
拟合窗口中心压深 / mm