


Valori di misurazione / Trend
Nome dispositivo: REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) (Serial Number M6042E04484)
Periodo di tempo: 8/03/2022 11.00.00 a 8/03/2022 14.00.34

9/03/2022 9.50.31

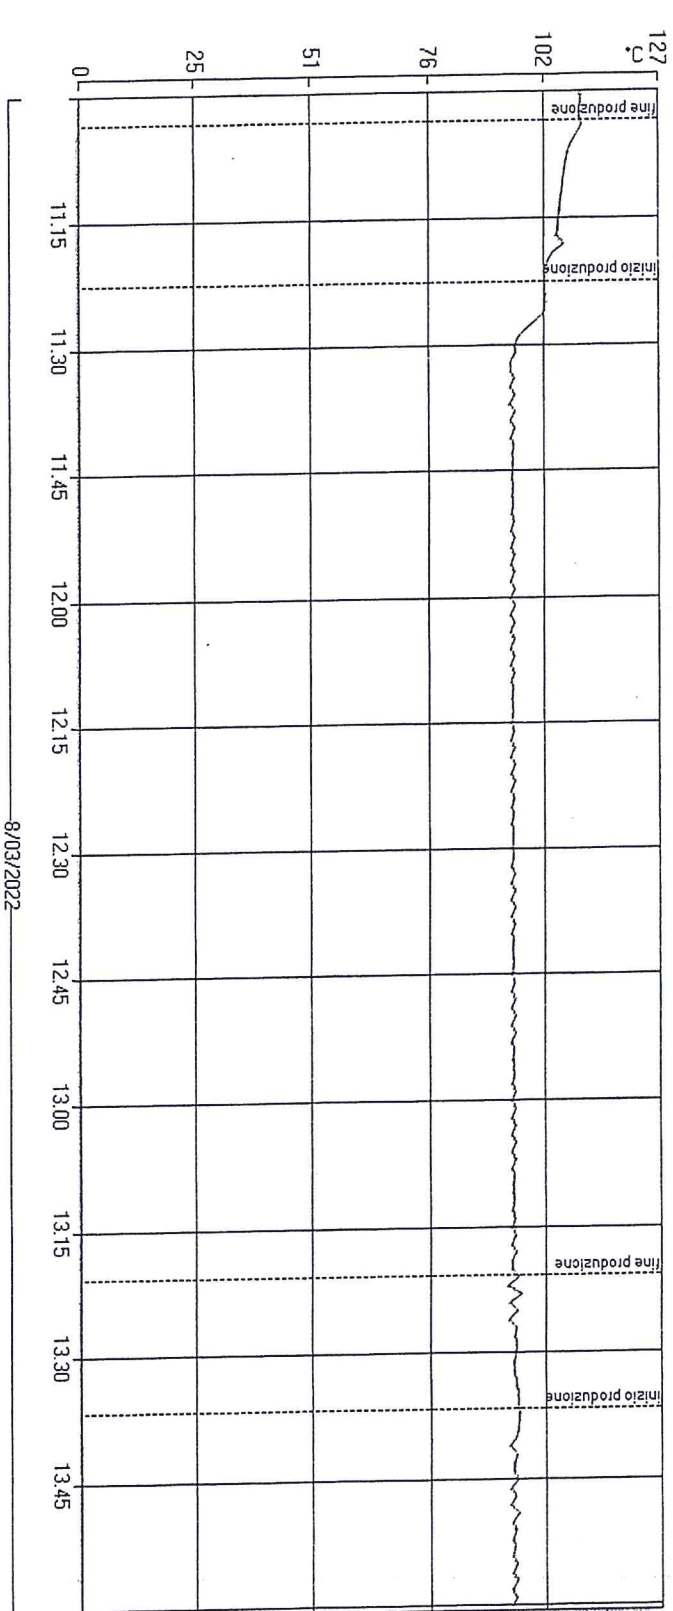

- ☒ TEMP.PAST [°C]
- ☐ TEMP.USCIT [°C]
- ☐ P2.P1 [BAR]
- ☐ PORTATA [m³/h]
- ☐ bassa temp. past
- ☐ sterilizzazione
- ☐ produzione
- ☐ lavaggio