

Rapporto di taratura

Endress+Hauser

People for Process Automation

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Numero rapporto

Data taratura

04/11/2024

Cliente

Denominazione AGRUMIGEL SRL

Indirizzo VIA CENTINEO 4

CAP/Comune 98051 BARCELLONA P.G.

Numero 00223287

intervento

Luogo di esecuzione

Denominazione AGRUMIGEL SRL

Indirizzo VIA CENTINEO 4

CAP/Comune 98051 BARCELLONA P.G.

Contatto Ms. ROBERTA MICALIZZI

Dati strumento (UUT)

Modello ZAMA 2XPT100

Numero di serie IT24318

TAG T1T-PST-TUB

Parametro Temperatura

Campo di misura -200 a 850 °C
Segnale di uscita 4 a 20 mA
Campo di taratura -200 a 850 °C

Accessori/Componenti

Modello	Descrizione	Numero di serie
BeR 900	Pannello Operatore/Visualizzatore "Automation Panel 900"	IT24301
RSG45-A1L0/0	Advanced Graphic Data Manager RSG45	M6042D04484

Riferimenti utilizzati

Descrizione	Numero di serie	Numero certificato	Data di taratura
Termometro P750	75020110989	LAT 078 240564-1	09/05/2024
Fornetto Fluid H100	R606 21	N.A	09/05/2024


SOP di taratura utilizzata

SOP numero	Titolo SOP
PT.T70.R3	Taratura in campo della misura di temperatura

Valori di taratura "as found"

Punto di prova	Set point	Valore di riferimento	Valore UUT	Deviazione*	± MPE
	°C	°C	°C	°C	°C
1	0	49,42	48,5	-0,92	1,0
2	0	89,07	88,4	-0,67	1,0
3	0	118,93	118,3	-0,63	1,0

*Deviazione tra Valore UUT e Valore di riferimento

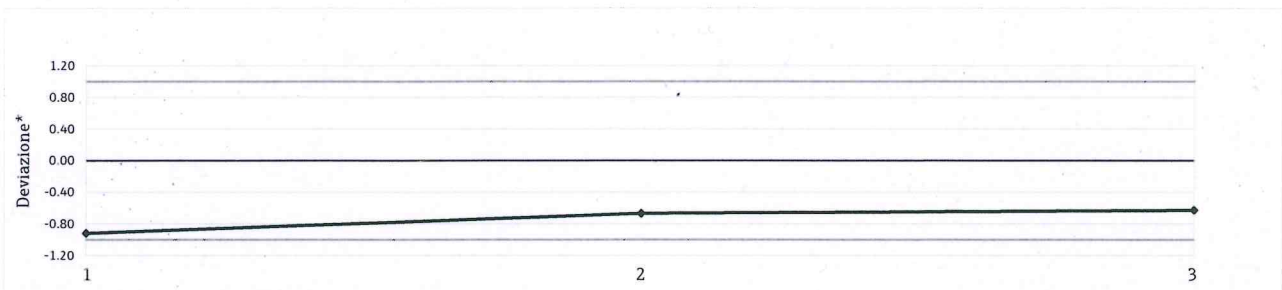

Conformità UUT

☒ Strumento conforme

☐ Strumento non conforme

Il presente rapporto di taratura documenta la tracciabilità riferita a standard nazionali o internazionali, le unità di misura impiegate sono in accordo con il Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo rapporto di taratura può essere pubblicato o riprodotto solo integralmente. I risultati di misura e la dichiarazione di conformità si riferiscono esclusivamente allo strumento tarato. La conformità alla specifica è dichiarata senza tenere conto dell'incertezza di misura.

Alberto Crisci

Tecnico
Firma

Alberto Crisci

Stampato il

05/11/2024