




LOW-PASS FILTER ORDER 4TH (<154HZ)

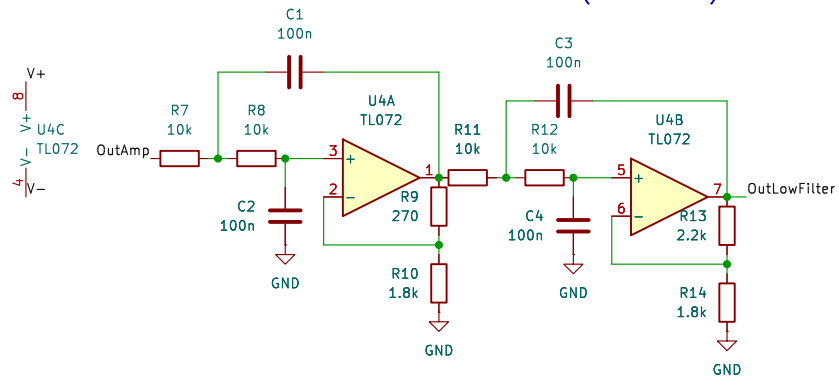


NOTCH-FILTER (~50HZ)

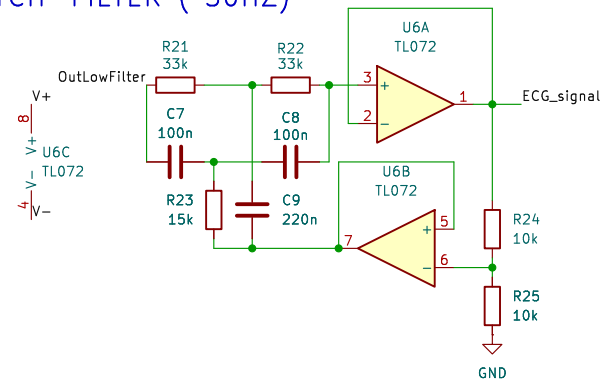

INSTRUMENTAL AMPLIFIER

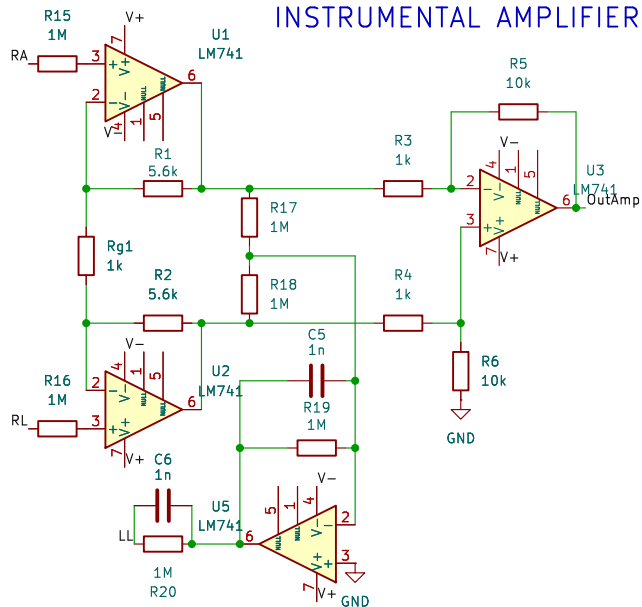

I/O TERMINAL

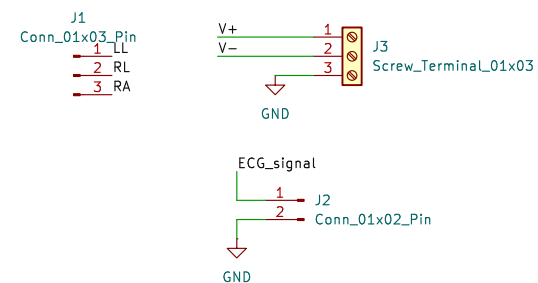

TEAM DESIGN: 22200009 – 22200026 – 22200027 – 22200034

Sheet: /

File: ECG_simple.kicad_sch

Title: ECG CIRCUIT USING OPAMP LM741 & TL072

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 9.0.1

Rev:

Id: 1/1