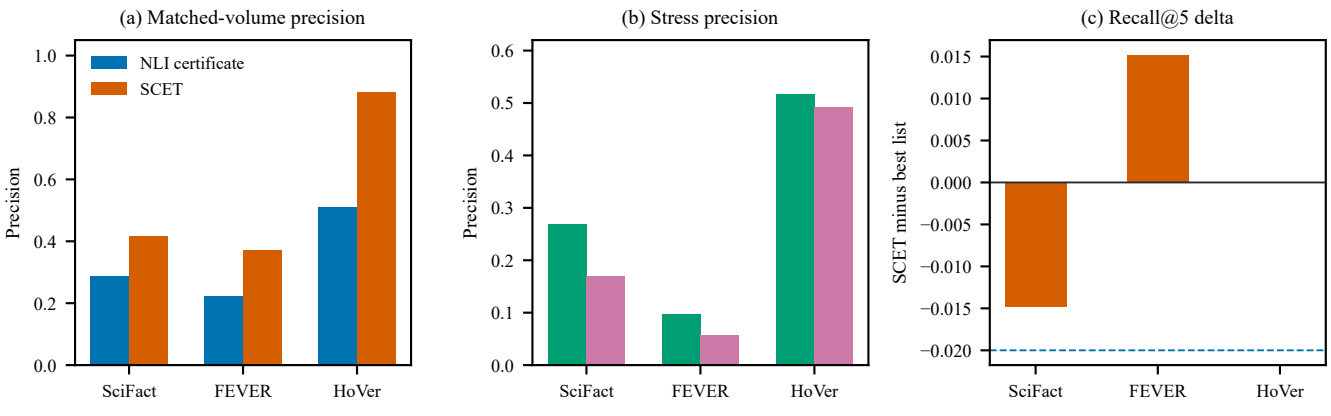
(a) Matched-volume precision
NLI certificate
SCET
Precision
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
SciFact
FEVER
HoVer
(b) Stress precision
Precision
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
SciFact
FEVER
HoVer
(c) Recall@5 delta
SCET minus best list
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
SciFact
FEVER
HoVer