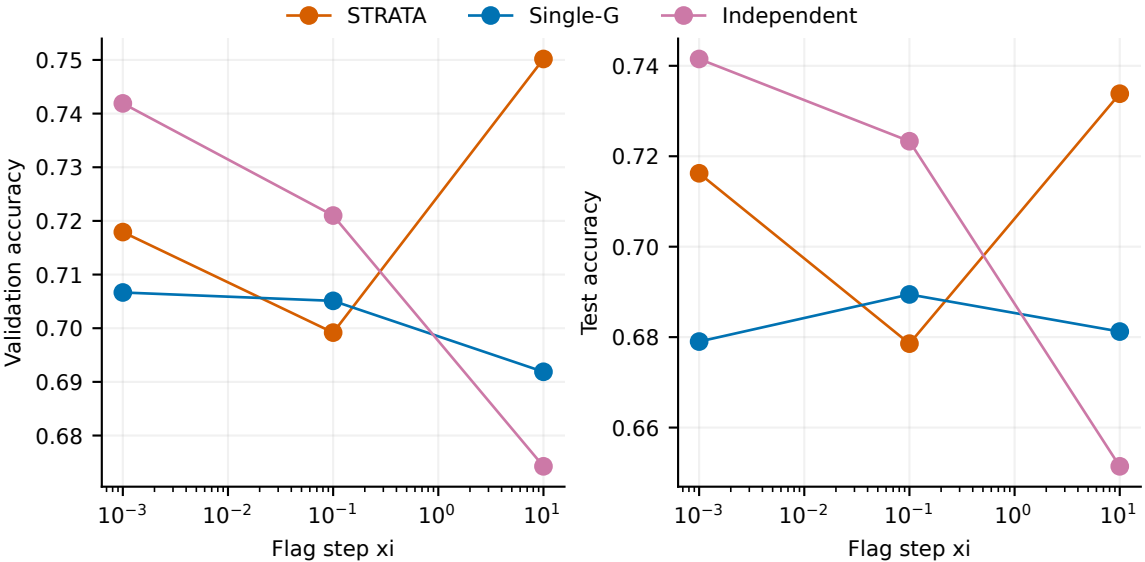
STRATA
Single-G
Independent
Validation accuracy
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Flag step xi
Test accuracy
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Flag step xi