







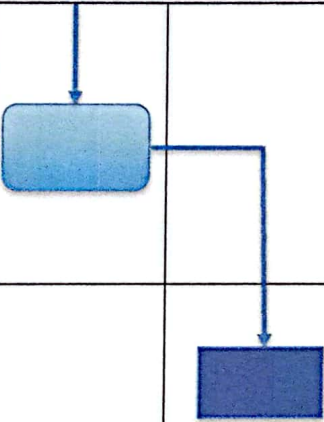

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN KALIBRASI PERALATAN MEDIS DI KLINIK BNNP NTB



**BIDANG REHABILITASI
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 PROVINSI NTB**

Nomor SOP	SOP/ Rh.01/01/ 76 / 2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Februari 2024
Disahkan oleh	<div style="text-align: right;">  Kepala BNNP NTB <u>Brigjen. Pol. Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.</u> NRP. 67050428 </div>
Nama SOP	Kalibrasi Peralatan Medis
Dasar hukum:	Kualifikasi pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;	1. Petugas klinik
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;	2. Petugas rehabilitasi

NO	URAIAN KERJA	Pelaksana		PJ Klinik	Kelengkapan	MUTU BAKU		KET.
		Petugas Klinik	Petugas Kalibrasi			Waktu	Output	
1.	Petugas kesehatan harus mengidentifikasi peralatan yang memerlukan kalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.				Daftar peralatan	10 Menit	Bukti tindakan	
2.	Memastikan peralatan dalam kondisi baik dan layak untuk dikalibrasi. Memeriksa apakah ada kerusakan fisik atau fungsi yang dapat mempengaruhi hasil kalibrasi.				Alat Tulis	20 Menit	Idem	
3.	Klinik pratama membuat jadwal kalibrasi untuk setiap peralatan yang memerlukan kalibrasi.				Idem	10 Menit	Idem	
4.	Pengelola klinik akan mengoordinasikan terkait proses kalibrasi pda pihak yang telah melakukan kerja sama untuk proses kalibrasi.				Alat Komunikasi	20 Menit	Idem	
5.	Teknisi kalibrasi mengikuti prosedur kalibrasi yang ditetapkan oleh produsen peralatan atau standar industri.				Peralatan Kalibrasi	120 Menit	Idem	

6.	Hasil kalibrasi dicatat dalam lembar catatan kalibrasi yang sesuai. Informasi yang dicatat harus mencakup tanggal kalibrasi, hasil kalibrasi, tindakan perbaikan (jika ada), dan nama teknisi yang melakukan kalibrasi.			Alat Tulis	10 Menit	Idem	
7.	Setelah selesai melakukan kalibrasi, pengelola melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa peralatan telah dikalibrasi dengan benar.			Alat Tulis	15 Menit	Idem	