


REV.	ZONE	NOTES	DRAWN	DATE	CHKD&APP.	DATE
1.						

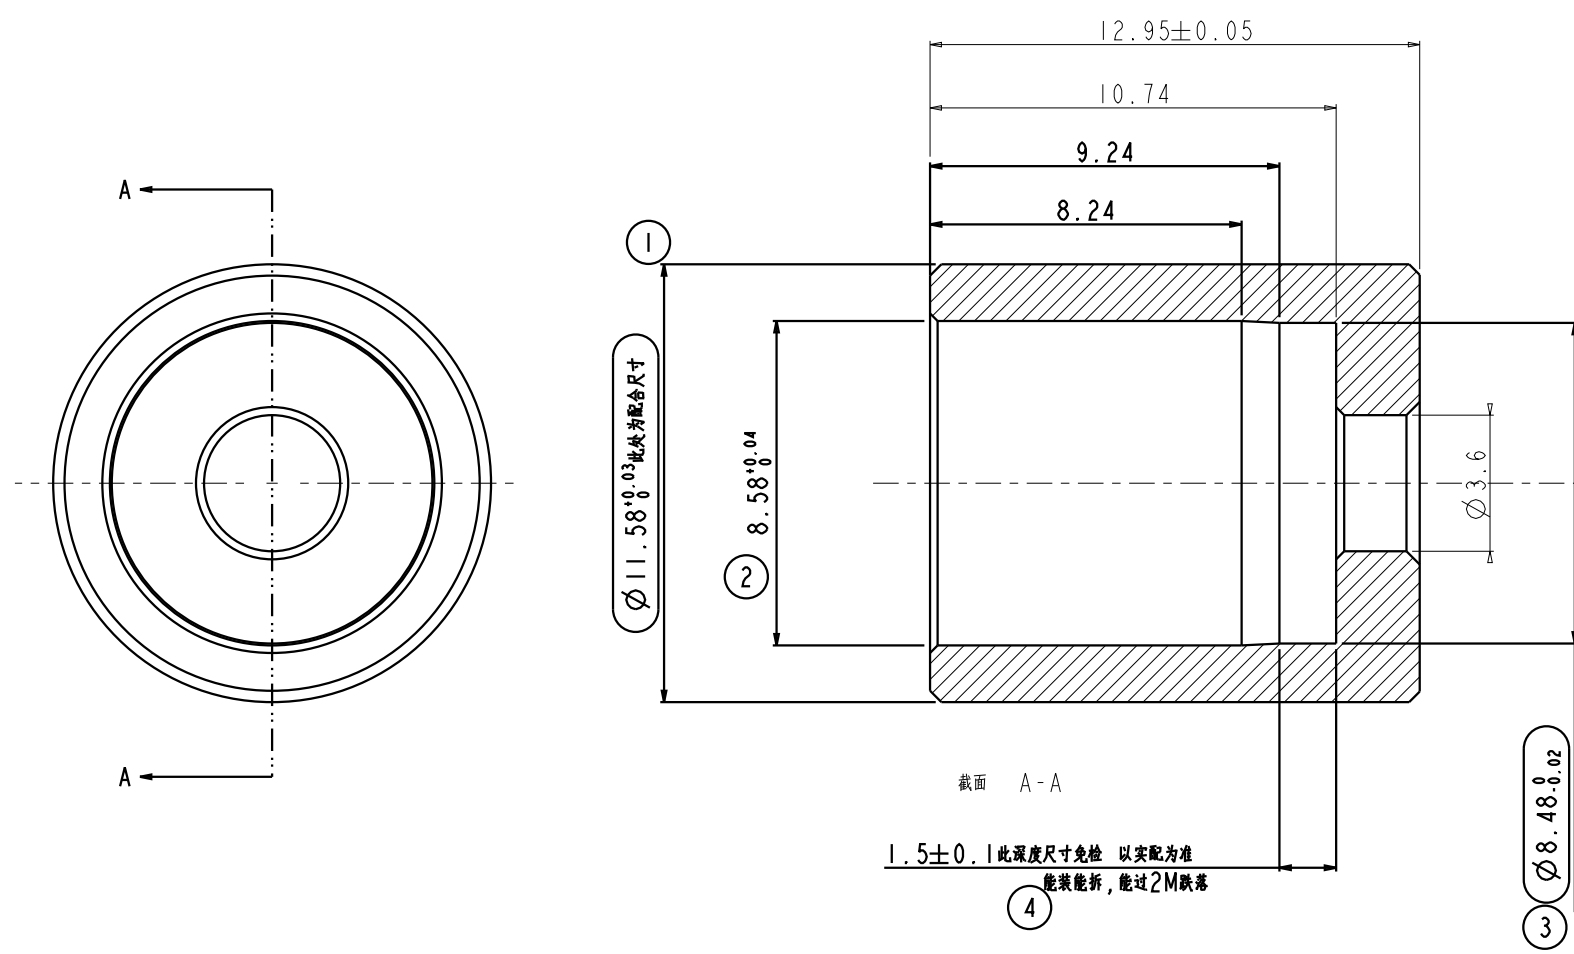

注

- 1 材质为黄铜 表面光亮 清洗干净
- 2 未注尺寸请以电子档为准, 未注倒角 $C=0.2$
- 3: 带编号尺寸为重点检测尺寸! 但4号尺寸不检 只实配。
- 4 3、4号尺寸需与散热金属套实配能装能拆 能过2M跌落

机密

审批
2017.07.14
iHealth

LEVEL	GENERAL TOLERANCE			PART NAME (零件名称)		Famidoc			
DTM	A	B	C	散热器压块					
< 5	± 0.03	± 0.1	± 0.15	MATERIAL (材料)					
> 5-15	± 0.05	± 0.1	± 0.15	黄铜					
> 15-50	± 0.05	± 0.1	± 0.2	PRODUCTION NAME		PRODUCTION NO	DRAWING	DATE	
> 50-100	± 0.08	± 0.2	± 0.3	体温计		FDIR-V14	(设计)	(日期)	2017628
> 100	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.2\%$	$\pm 0.3\%$	FILE NUMBER					
ANGULAR	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	文件编号					
SELECT LEVEL									
B									
SCALE	UNITS	REV.	SHEET	表单编号					
<比例>	<单位>	<版本>	<页次>	QR-12-118					
MM			1 of 1	版次					
				V1.0					
						CONFIRM	DATE	DATE	
						(批准)	(日期)	(日期)	