


REV.	ZONE	NOTES	DRAWN	DATE	CHKD&APP.	DATE
1.						

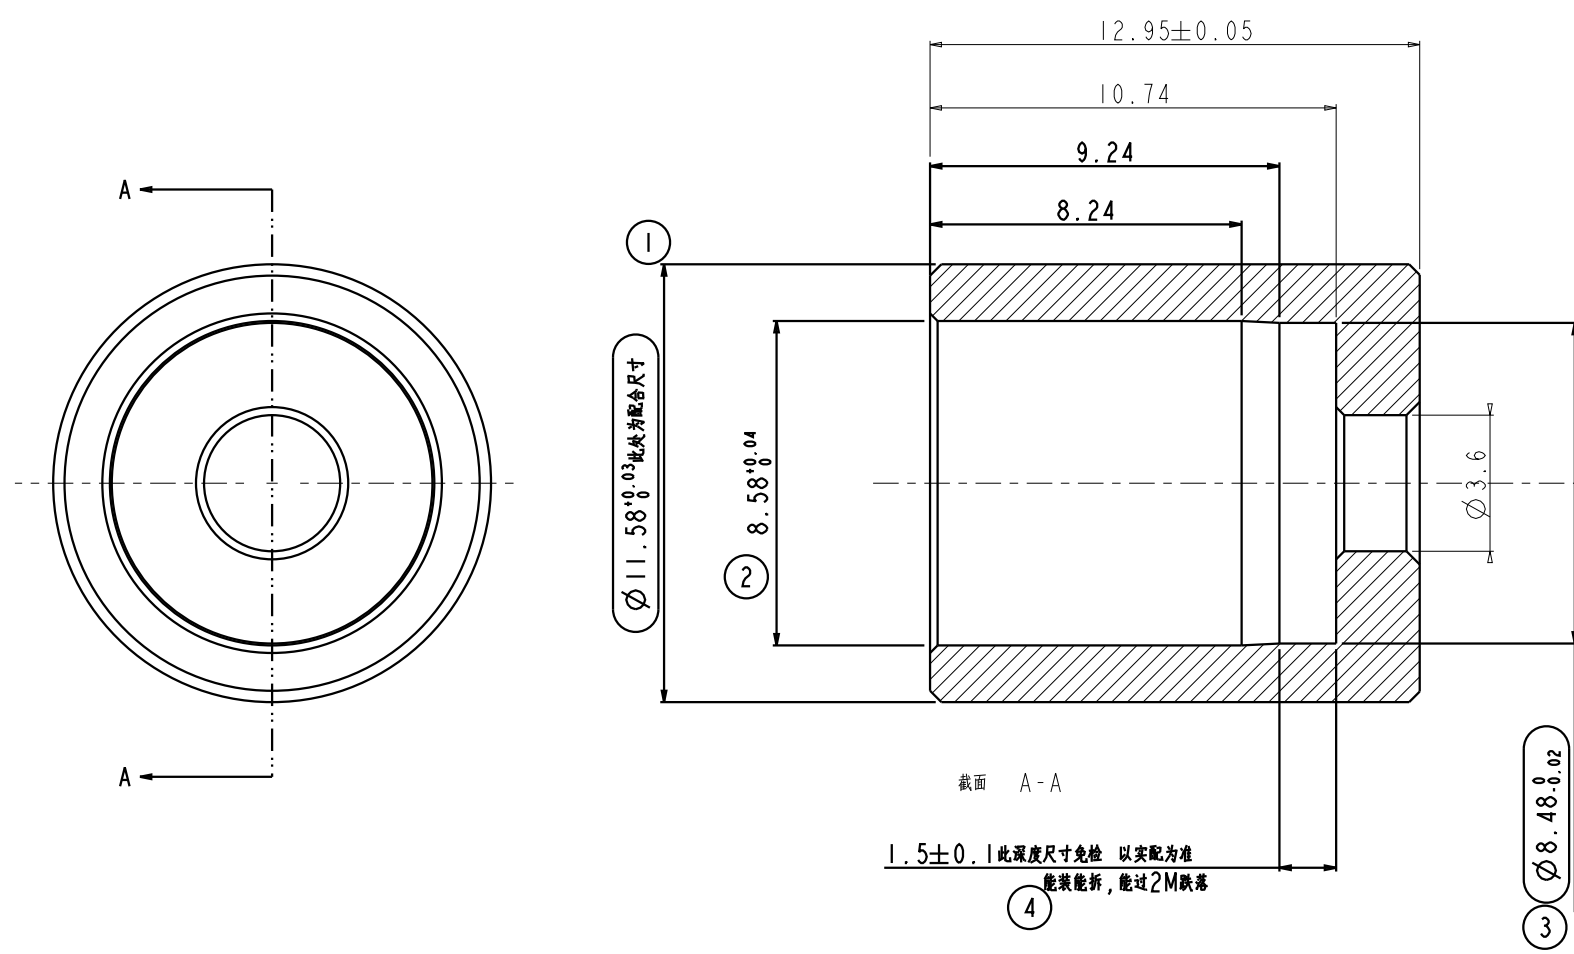

- 注
- 1 材质为黄铜 表面光亮 清洗干净
 - 2 未注尺寸请以电子档为准, 未注倒角C=0.2
 - 3: 带编号尺寸为重点检测尺寸! 但4号尺寸不检 只实配。
 - 4 3、4号尺寸需与散热金属套实配能装能拆 能过2M跌落

机密

审批
2017.07.14
iHealth

LEVEL		GENERAL TOLERANCE			PART NAME (零件名称)		Famidoc			
DTM		A	B	C	散热器压块					
< 5		±0.03	±0.1	±0.15	MATERIAL (材料)					
> 5-15		±0.05	±0.1	±0.15	黄铜					
> 15-50		±0.05	±0.1	±0.2	PRODUCTION NAME		PRODUCTION NO	DRAWING	DATE	
> 50-100		±0.08	±0.2	±0.3	体温计		FDIR-V14	(设计)	(日期)	2017628
> 100		±0.1%	±0.2%	±0.3%	FILE NUMBER					
ANGULAR	±0.1°	±0.5°	±0.5°		文件编号					
SELECT LEVEL					表单编号		QR-12-118	AUDITING	DATE	
B								(审核)	(日期)	
SCALE	UNITS	REV.	SHEET		版次		V1.0	CONFIRM	DATE	
<比例>	<单位>	<版本>	<页次>					(批准)	(日期)	
	MM		1 of 1							