

PRESSURE TEST RECORD

压力试验记录

Exhibit 5-2, Edition 3, Revision 0


☒ Hydrostatic 水压

☐ Pneumatic 气压


Doc No. : PTR-P-2362-1

Item Name 产品名称	Oil/Gas Separator	DWG No. & Rev. 产品图及版号	20980145-083-001 Rev.3	Job No. 工作令号	P-2362
Test Position 试压部位	Right Vessel	Product No 产品编号	P-2362-001 Thru P-2362-015	COL. No. 工艺过程卡编号	P-2362-009 REV. 0
Gauge Precision Grade 压力表精度等级	1.6 级	Gauge Range 压力表量程	0~4.0 MPa	Calibration Date 压力表检定日期	2023-12-20
Gauge No. 压力表编号	202306049575 202306049702	Test Medium 试验介质	Water	Due Date 压力表有效日期	2024-06-19
Content Of Chlorine 氯离子含量	/	Ambient TEP. °C 环境温度	5	Metal TEP. °C 金属壁温	13

Design
Pressure Curve
设计要求
压力试验曲线

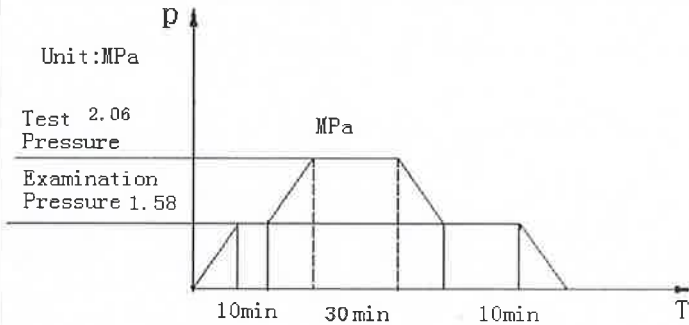


Actual
Pressure Curve
实际压力
试验曲线

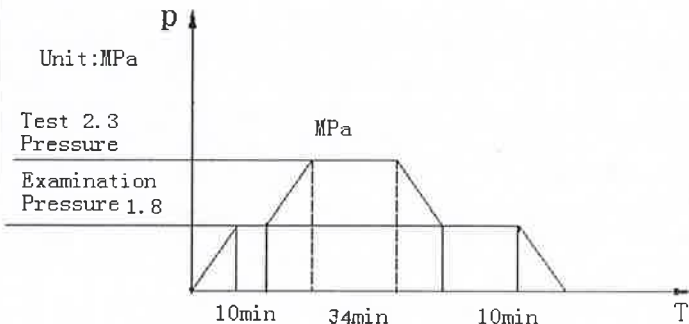

Result 结论:

This product is tested under 2.3 MPa, there is no leakage, no visible abnormal deformation; no abnormal noise, it is acceptable.
本产品经 2.3 MPa 试验, 无渗漏; 无可见的异常变形; 无异常响声; 试验结论合格.

Operator 操作者	李顺荣	Date 日期	2024.1.8
Examiner 检验员	郑如英	Date 日期	2024.1.8
QC Engineer 质检工程师	孙	Date 日期	2024.1.8
AI 授权检验师		Date 日期	



Witnessed for P-2362-001/002/003

PRESSURE TEST RECORD

压力试验记录


Exhibit 5-2, Edition 3, Revision 0

■Hydrostatic 水压 □Pneumatic 气压


Doc No. : PTR-P-2362-2

Item Name 产品名称	Oil/Gas Separator	DWG No. & Rev. 产品图及版号	20980145-083-001 Rev.3	Job No. 工作令号	P-2362
Test Position 试压部位	Left Vessel	Product No 产品编号	P-2362-001 Thru P-2362-015	COL. No. 工艺过程卡编号	P-2362-009 REV. 0
Gauge Precision Grade 压力表精度等级	1.6 级	Gauge Range 压力表量程	0~4.0MPa	Calibration Date 压力表检定日期	2023-12-20
Gauge No. 压力表编号	202306049702 202306049688	Test Medium 试验介质	Water	Due Date 压力表有效日期	2024-06-19
Content Of Chlorine 氯离子含量	/	Ambient TEP. °C 环境温度	5	Metal TEP. °C 金属壁温	13

Design
Pressure Curve
设计要求
压力试验曲线

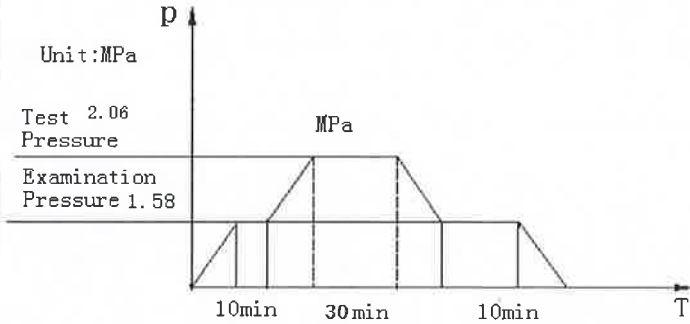

Actual
Pressure Curve
实际压力
试验曲线

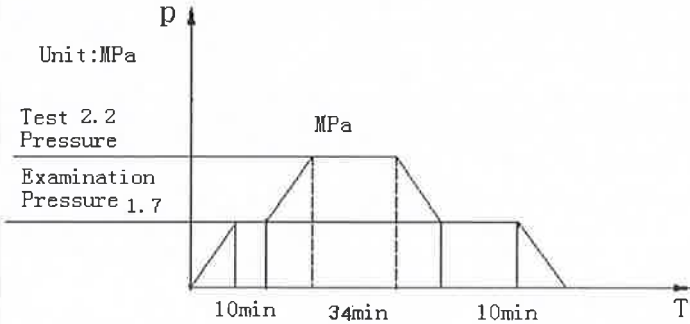

Result 结论:

This product is tested under 2.2 MPa, there is no leakage, no visible abnormal deformation; no abnormal noise, it is acceptable.

本产品经 2.2 MPa 试验, 无渗漏; 无可见的异常变形; 无异常响声; 试验结论合格.

Operator 操作者		Date 日期	
Examiner 检验员		Date 日期	
QC Engineer 质控工程师		Date 日期	2024.1.8
AI 授权检验师		Date 日期	



witnessed for P-2362-011/012/013

PRESSURE TEST RECORD



压力试验记录

Exhibit 5-2, Edition 3, Revision 0

☒ Hydrostatic 水压☐ Pneumatic 气压

Doc No.: PTR-P-2362-3

Item Name 产品名称	Oil/Gas Separator	DWG No. & Rev. 产品图及版号	20980145-083-001 Rev.3	Job No. 工作令号	P-2362
Test Position 试压部位	Right Vessel	Product No 产品编号	P-2362-016 Thru P-2362-025	COL. No. 工艺过程卡编号	P-2362-009 REV. 0
Gauge Precision Grade 压力表精度等级	1.6 级	Gauge Range 压力表量程	0~4.0MPa	Calibration Date 压力表检定日期	2023-12-20
Gauge No. 压力表编号	202306049575 202306049593	Test Medium 试验介质	Water	Due Date 压力表有效日期	2024-06-19
Content Of Chlorine 氯离子含量	/	Ambient TEP. °C 环境温度	5	Metal TEP. °C 金属壁温	13

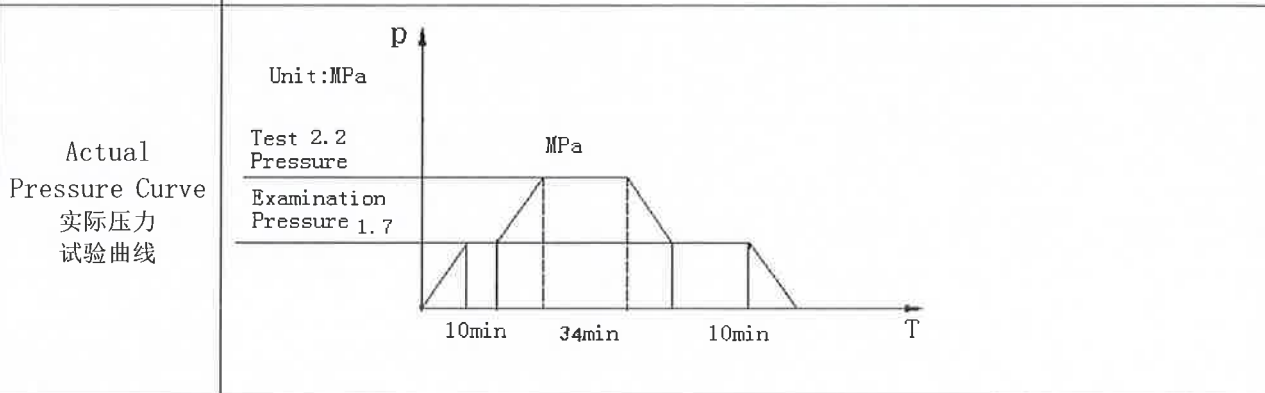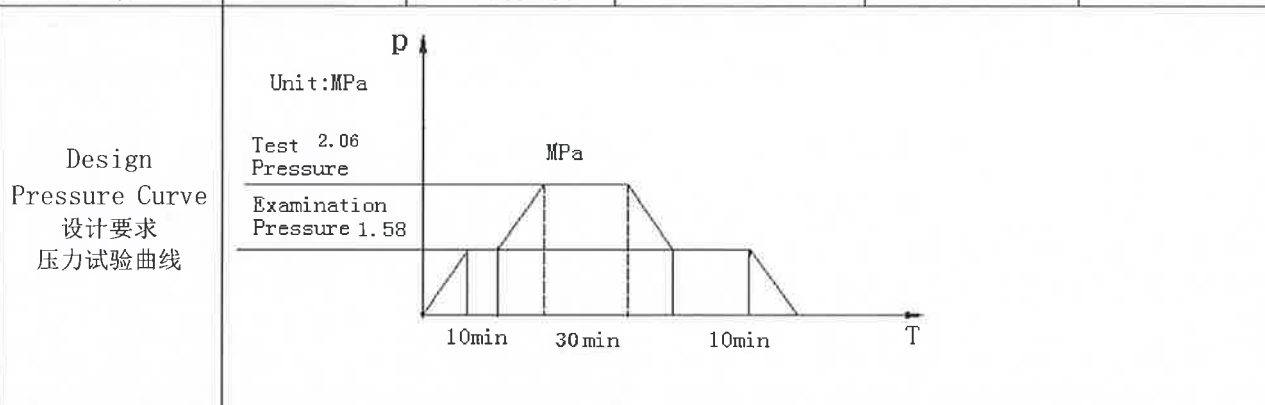

Result 结论:

This product is tested under 2.2 MPa, there is no leakage, no visible abnormal deformation; no abnormal noise, it is acceptable.

本产品经 2.2 MPa 试验, 无渗漏; 无可见的异常变形; 无异常响声; 试验结论合格。

Operator 操作者	李顺荣	Date 日期	2024.1.18
Examiner 检验员	郑如英	Date 日期	2024.1.18
QC Engineer 质检工程师	王	Date 日期	2024.1.18
AI 授权检验师		Date 日期	



Witnessed for P-2362-022/024

PRESSURE TEST RECORD

压力试验记录


Exhibit 5-2, Edition 3, Revision 0

☒Hydrostatic 水压 ☐Pneumatic 气压


Doc No. : PTR-P-2362-4

Item Name 产品名称	Oil/Gas Separator	DWG No. & Rev. 产品图及版号	20980145-083-001 Rev.3	Job No. 工作令号	P-2362
Test Position 试压部位	Left Vessel	Product No 产品编号	P-2362-016 Thru P-2362-025	COL. No. 工艺过程卡编号	P-2362-009 REV. 0
Gauge Precision Grade 压力表精度等级	1.6 级	Gauge Range 压力表量程	0~4.0MPa	Calibration Date 压力表检定日期	2023-12-20
Gauge No. 压力表编号	202306049575 202306049698	Test Medium 试验介质	Water	Due Date 压力表有效日期	2024-06-19
Content Of Chlorine 氯离子含量	/	Ambient TEP. °C 环境温度	5	Metal TEP. °C 金属壁温	13

Design
Pressure Curve
设计要求
压力试验曲线

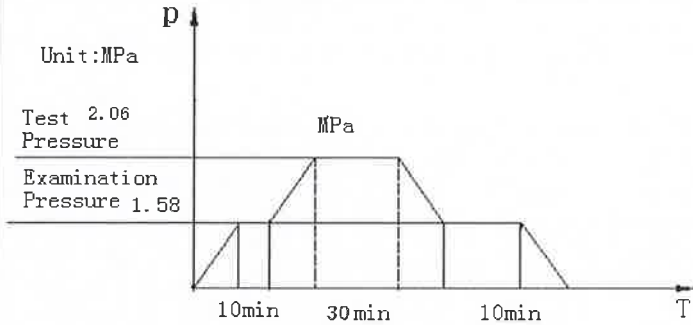

Actual
Pressure Curve
实际压力
试验曲线

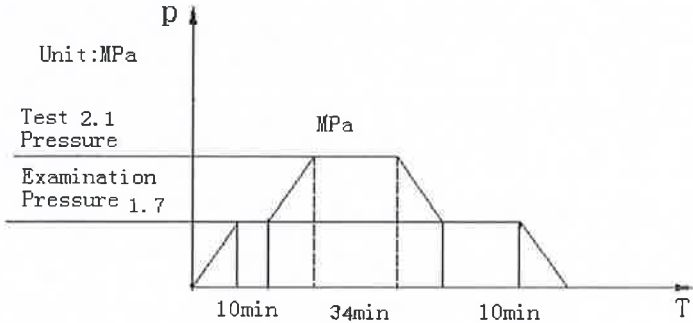



Result 结论:



This product is tested under 2.1 MPa, there is no leakage, no visible abnormal deformation; no abnormal noise, it is acceptable.
本产品经 2.1 MPa 试验, 无渗漏; 无可见的异常变形; 无异常响声; 试验结论合格.

Operator 操作者	李顺荣	Date 日期	2024.1.18
Examiner 检验员	郑如英	Date 日期	2024.1.18
QC Engineer 质控工程师	王	Date 日期	2024.1.18
AI 授权检验师		Date 日期	






Witnessed for P-2362-002/004

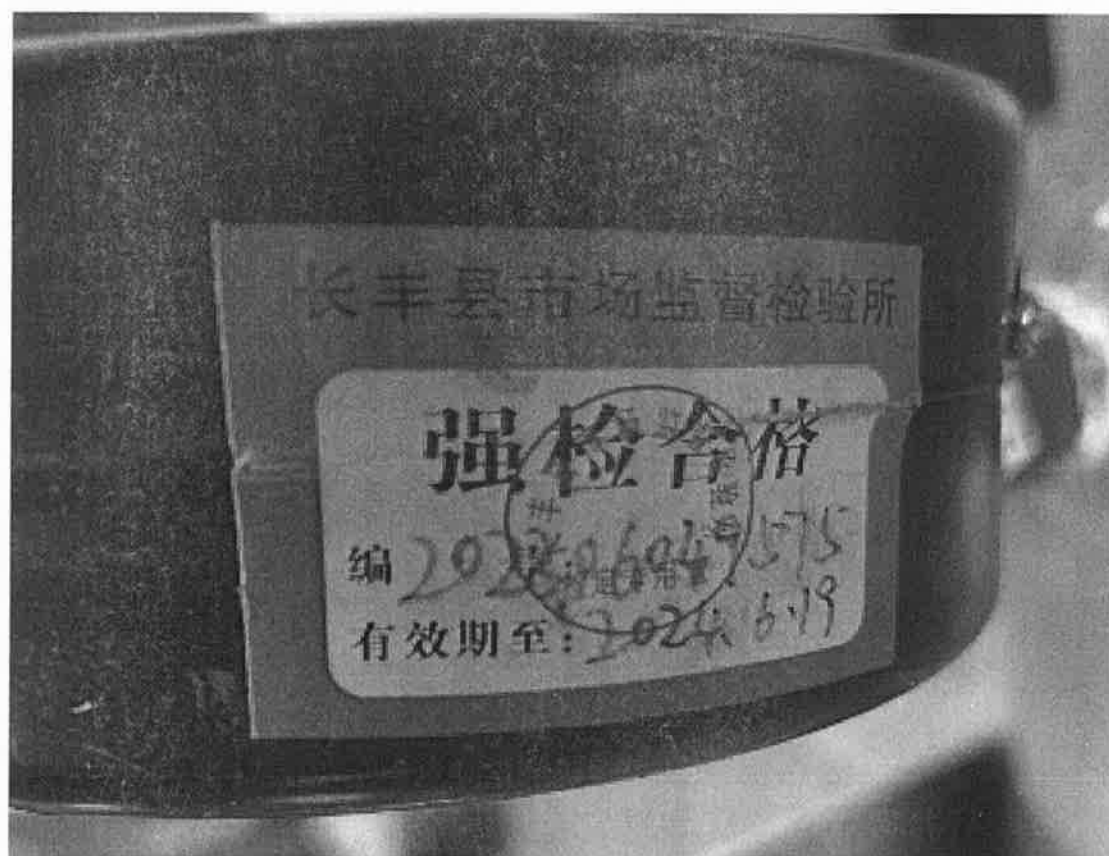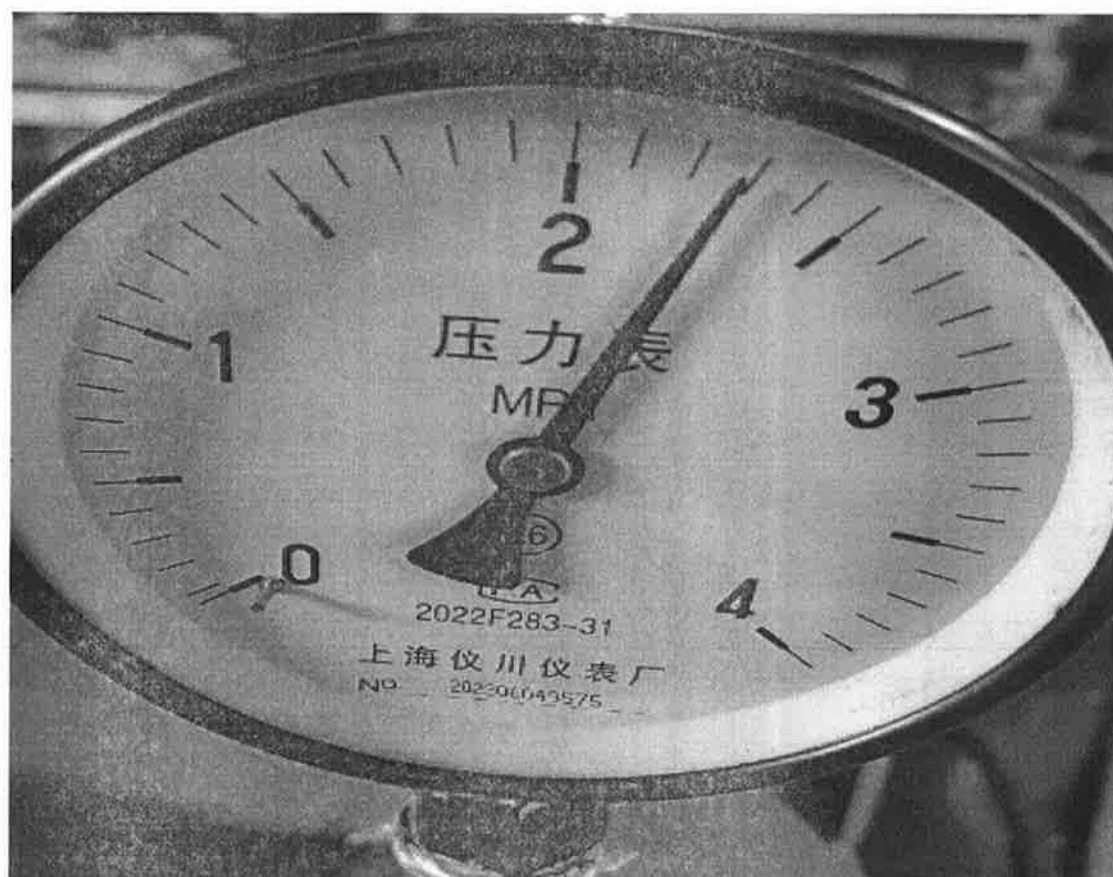


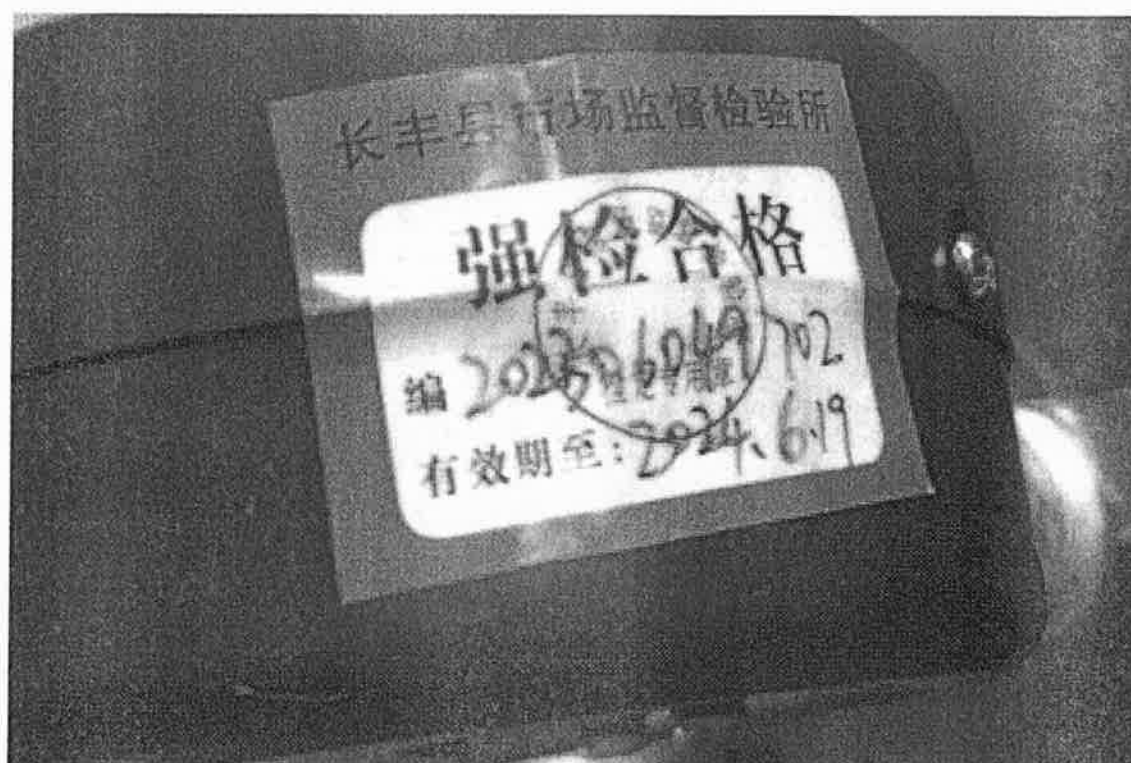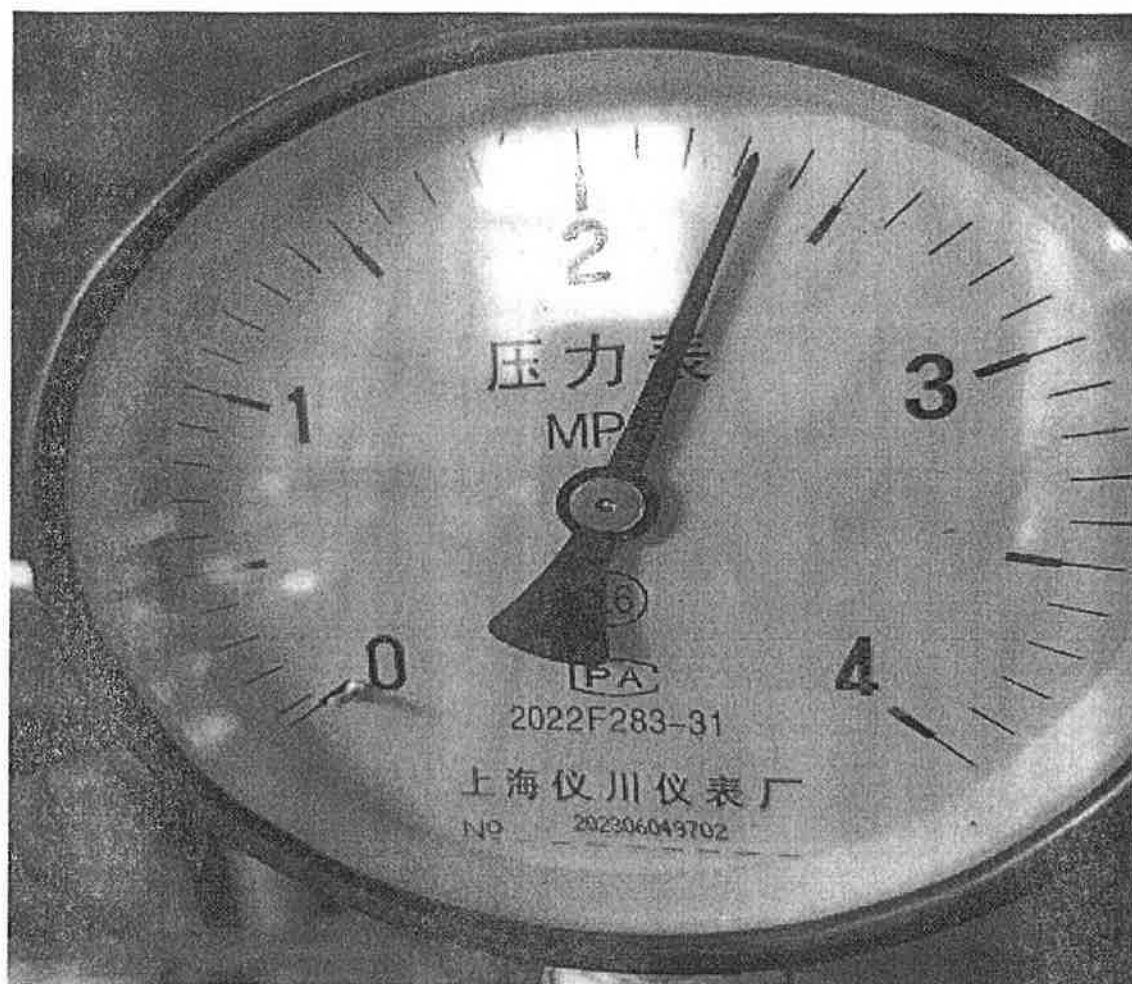






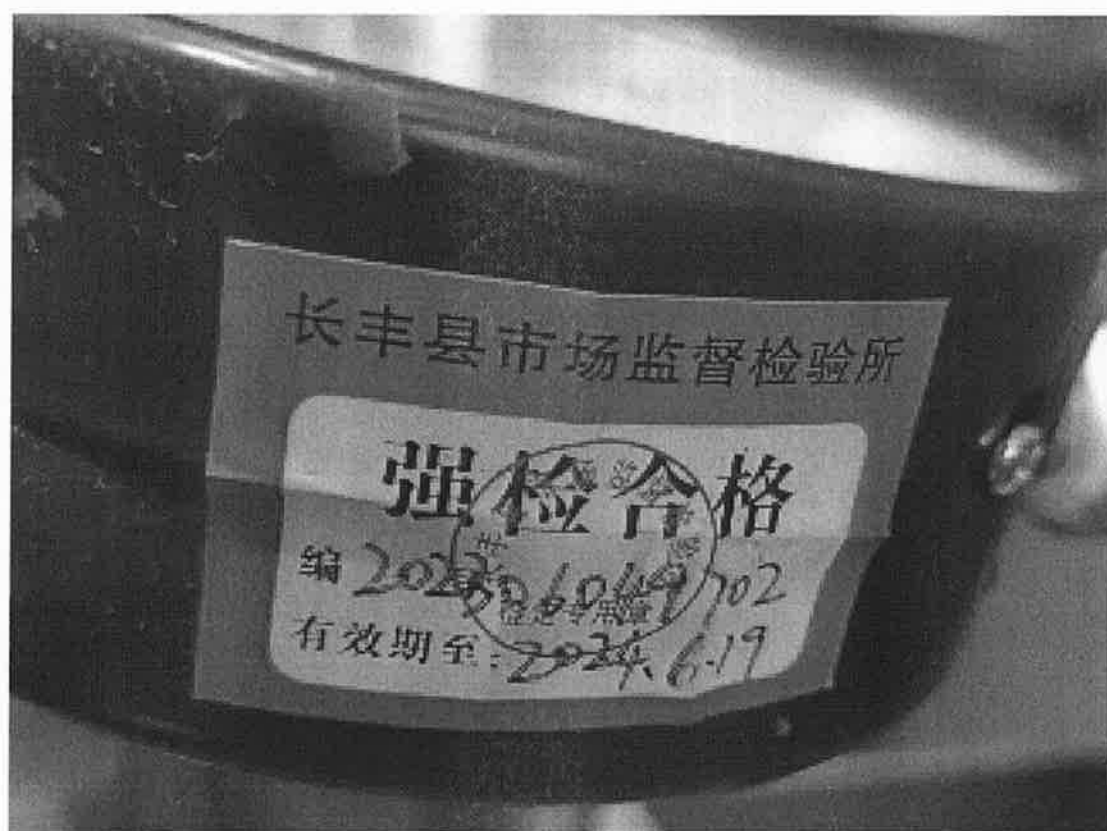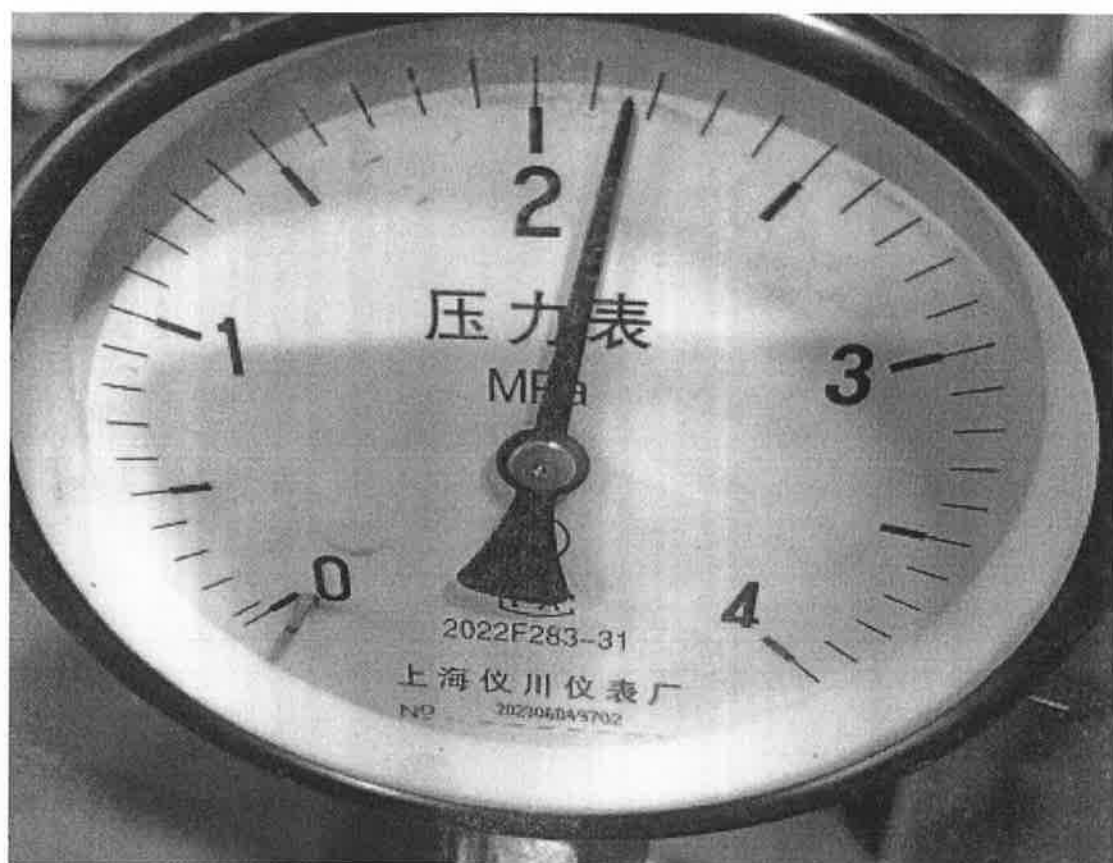

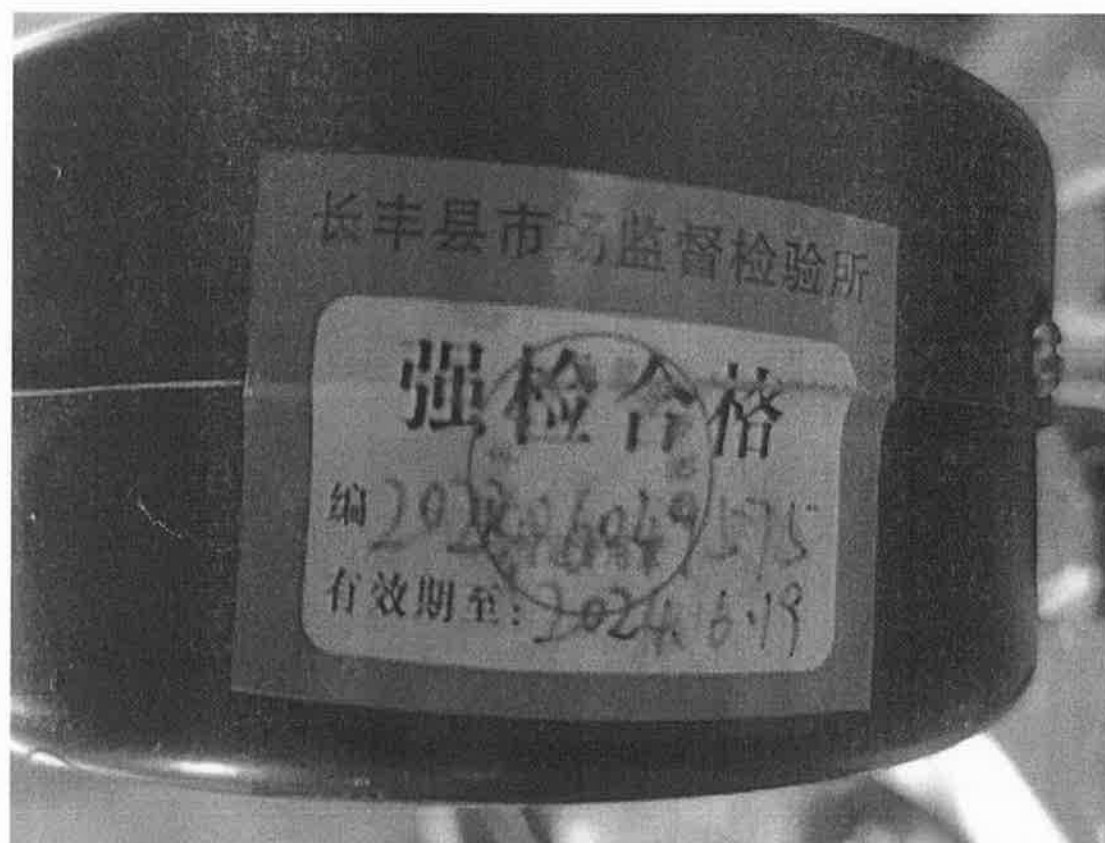

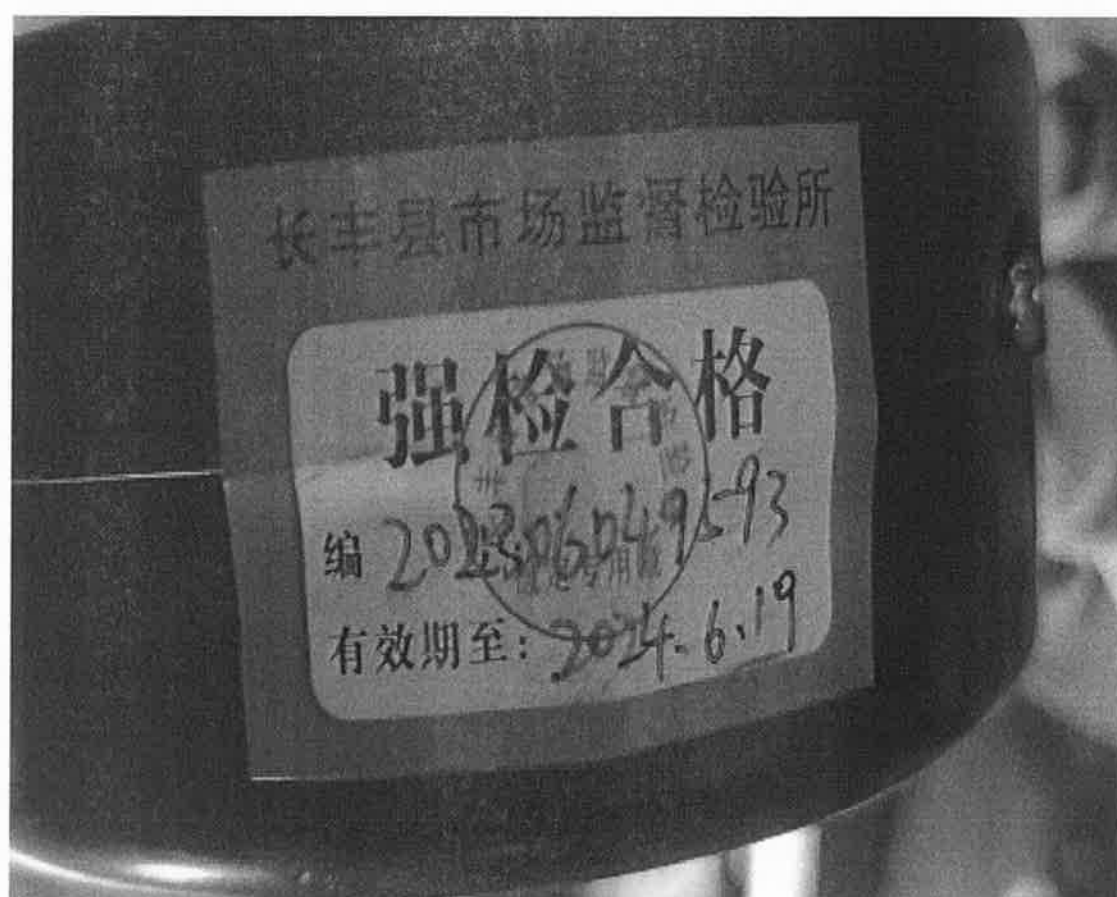

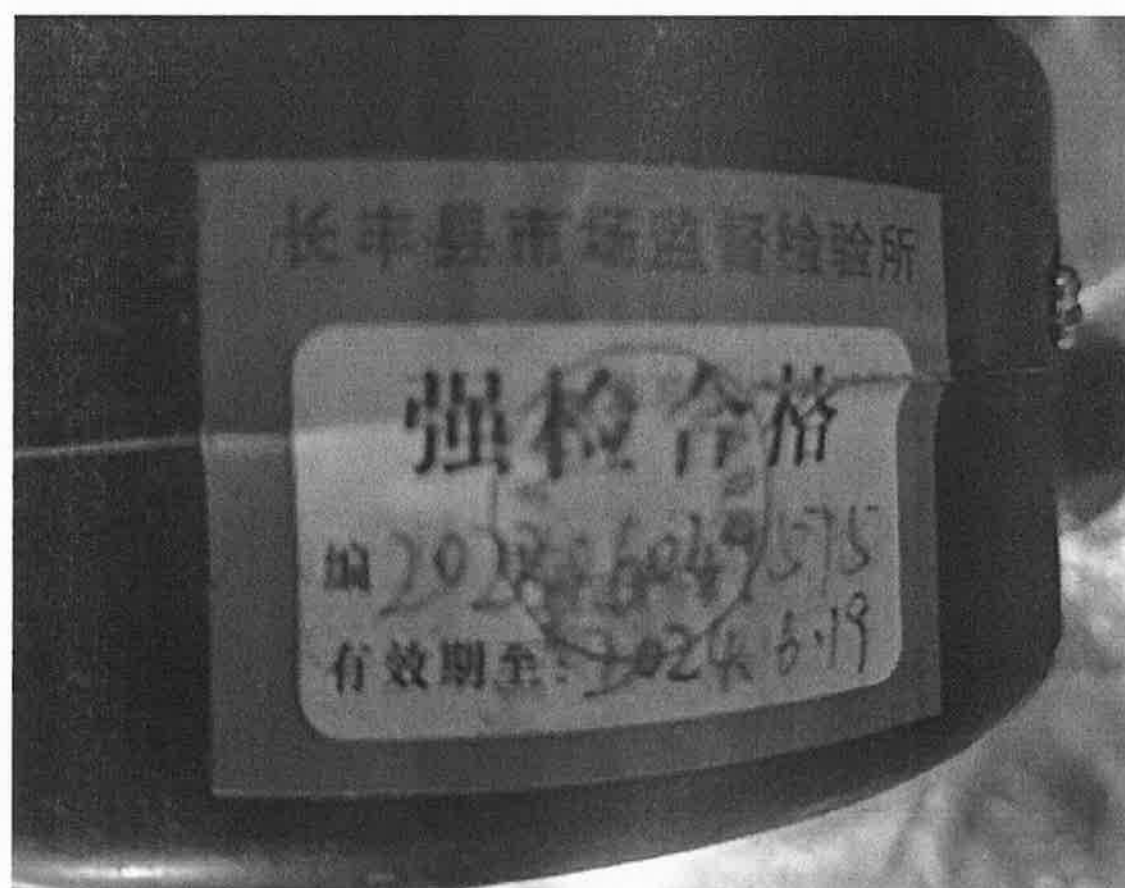

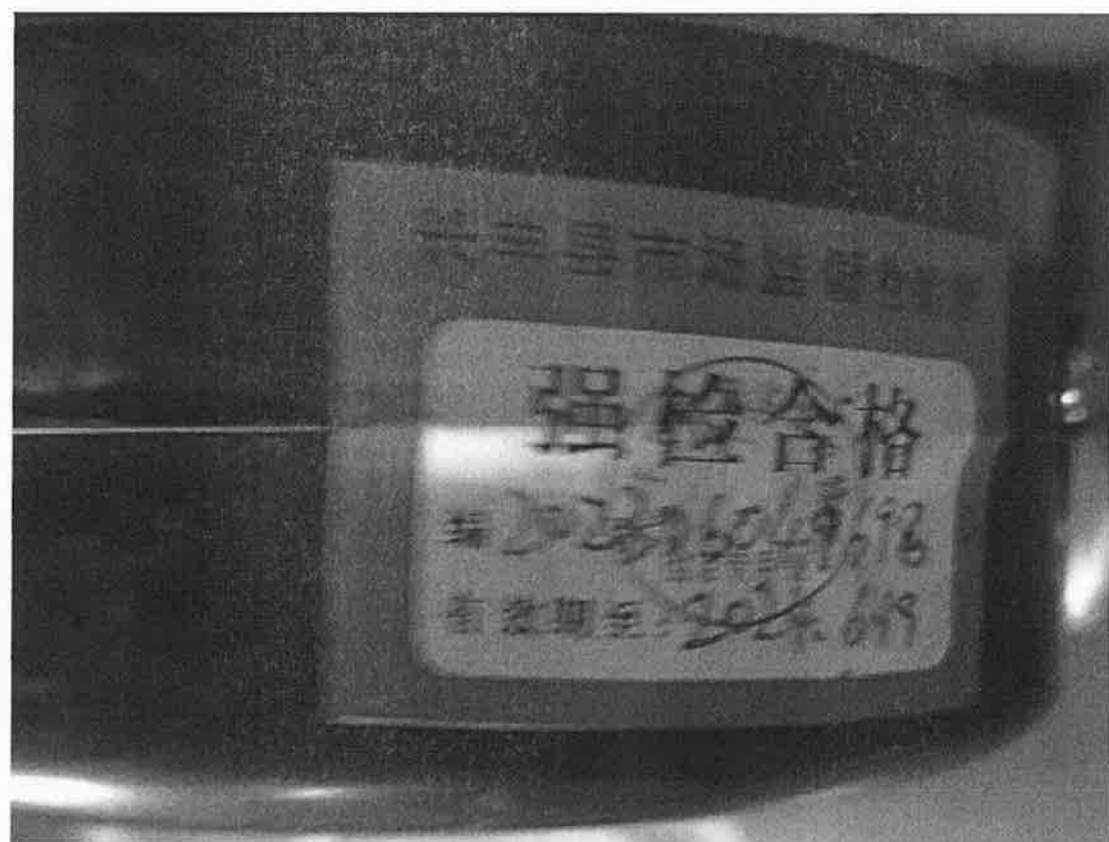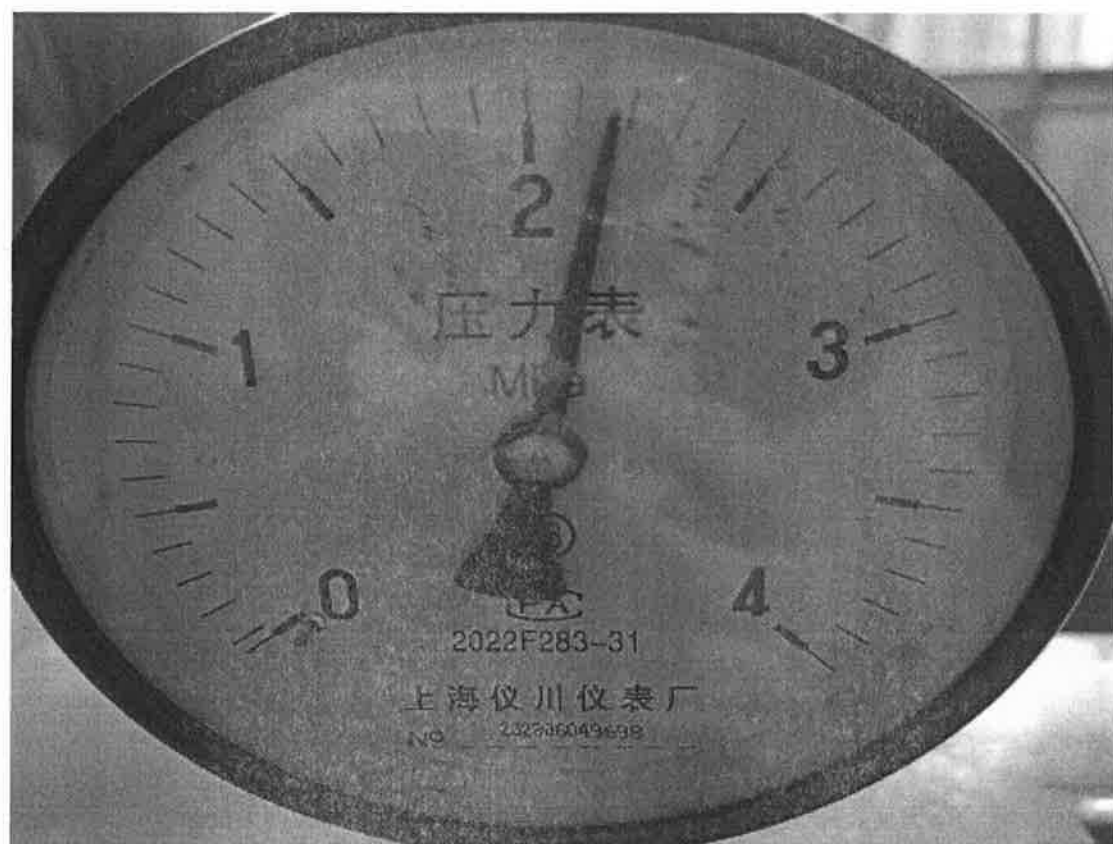

长丰县市场监督管理局

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0191 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant

计量器具名称 压力表
Name of Instrument

型号 / 规格 (0~4)MPa
Type/Specification

出厂编号 202306049575
Serial No.

制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer

检定依据 JJG52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation

检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人
Approved by

李梅

核验员

耿洋

Checked by

检定员

戴绍松

Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日

Date of Verification

有效期至: 2024 年 6 月 19 日

Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号

Authorization Certificate No.

地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧

Address

传真: 0551-62721250

Fax

电话: 0551-62721250

Telephone

邮编: 231131

Post Code

邮箱: Cfjls2013@126.com

Email

证书编号: FP2023-12-0191
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准
Public Standards of Measurement Used for This Verification

社 会 公 用 计 量 标 准 名 称 压力表检定装置
Public Standards of Measurement Used for This Verification
社 会 公 用 计 量 标 准 证 书 编 号 [2020]皖合社量标长证字第008号
Certificate No. for the Public Standards of Measurement
社 会 公 用 计 量 标 准 有 效 期 2024年05月19日
Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具 Main measurement standards used in this Verification					
名称 Name	型号/规格 Type /Specification	编号 Number	有效期至 Due date	证书编号 Certificate No.	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差 Acuracyclass
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级
以上计量标准器具的量值溯源至国家基准 quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.					

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ■ 本实验室 □ 现场

Address

环境温度: 22 °C

Ambient Tempersture

湿度: 56%RH

Relative Humidity

其它: /

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

- 注: 1. 未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。
2. 本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。
3. 请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督管理局

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0197 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant
计量器具名称 压力表
Name of Instrument
型号/规格 (0~4)MPa
Type/Specification
出厂编号 202306049702
Serial No.
制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer
检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation
检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人
Approved by

李梅

核验员

耿洋

Checked by

检定员

戴绍松

Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日
Date of Verification
有效期至: 2024 年 6 月 19 日
Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号
Authorization Certificate No.
地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧
Address
传真: 0551-62721250
Fax

电话: 0551-62721250
Telephone
邮编: 231131
Post Code
邮箱: Cfjls2013@126.com
Email

证书编号: FP2023-12-0197
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准名称 压力表检定装置

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准证书编号 [2020]皖合社量标长证字第008号

Certificate No. for the Public Standards of Measurement

社会公用计量标准有效期 2024年05月19日

Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具

Main measurement standards used in this Verification

名称	型号/规格	编号	有效期至	证书编号	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差
Name	Type /Specification	Number	Due date	Certificate No.	Aceuracyclass
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准

quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ☒ 本实验室 ☐ 现场

Address

环境温度: 22 °C

湿度: 56%RH

其它: /

Ambient Tempersture

Relative Humidity

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。

2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。

3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督管理局

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0197 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant
计量器具名称 压力表
Name of Instrument
型号/规格 (0~4)MPa
Type/Specification
出厂编号 202306049702
Serial No.
制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer
检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation
检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人
Approved by

李梅

核验员

耿洋

Checked by

检定员

戴绍松

Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日

Date of Verification

有效期至: 2024 年 6 月 19 日

Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号

Authorization Certificate No.

地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧

Address

传真: 0551-62721250

Fax

电话: 0551-62721250

Telephone

邮编: 231131

Post Code

邮箱: Cfjls2013@126.com

Email

证书编号: FP2023-12-0197
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准名称 压力表检定装置

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准证书编号 [2020]皖合社量标长证字第008号

Certificate No. for the Public Standards of Measurement

社会公用计量标准有效期 2024年05月19日

Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具

Main measurement standards used in this Verification

名称	型号/规格	编号	有效期至	证书编号	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差
Name	Type /Specification	Number	Due date	Certificate No.	Aceuracyclass
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准

quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ■ 本实验室 □ 现场

Address

环境温度: 22 °C

湿度: 56%RH

其它: /

Ambient Tempersture

Relative Humidity

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

- 注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。
2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。
3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督管理局

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0193 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant

计量器具名称 压力表
Name of Instrument

型号/规格 (0~4)MPa
Type/Specification

出厂编号 202306049688
Serial No.

制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer

检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation

检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人
Approved by

李梅

核验员

耿洋

Checked by

检定员

戴纪松

Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日

Date of Verification

有效期至: 2024 年 6 月 19 日

Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号

Authorization Certificate No.

地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧

Address

传真: 0551-62721250

Fax

电话: 0551-62721250

Telephone

邮编: 231131

Post Code

邮箱: Cfjls2013@126.com

Email

证书编号: FP2023-12-0193
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准名称 压力表检定装置

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准证书编号 [2020]皖合社量标长证字第008号

Certificate No. for the Public Standards of Measurement

社会公用计量标准有效期 2024年05月19日

Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具

Main measurement standards used in this Verification

名称	型号/规格	编号	有效期至	证书编号	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差
Name	Type /Specification	Number	Due date	Certificate No.	Aceuracycluss
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准

quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards in the P.R.

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ☒ 本实验室 ☐ 现场

Address

环境温度: 22 °C

湿度: 56%RH

其它: /

Ambient Tempersture

Relative Humidity

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

- 注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。
2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。
3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督管理局
ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书
Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0191 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant
计量器具名称 压力表
Name of Instrument
型号/规格 (0~4)MPa
Type/Specification
出厂编号 202306049575
Serial No.
制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer
检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation
检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人 李梅
Approved by
核验员 耿洋
Checked by
检定员 戴绍松
Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日
Date of Verification
有效期至: 2024 年 6 月 19 日
Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号
Authorization Certificate No.
地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧
Address
传真: 0551-62721250
Fax

电话: 0551-62721250
Telephone
邮编: 231131
Post Code
邮箱: Cfjls2013@126.com
Email

证书编号: FP2023-12-0191
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准名称 压力表检定装置

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准证书编号 [2020]皖合社量标长证字第008号

Certificate No. for the Public Standards of Measurement

社会公用计量标准有效期 2024年05月19日

Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具

Main measurement standards used in this Verification

名称	型号/规格	编号	有效期至	证书编号	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差
Name	Type /Specification	Number	Due date	Certificate No.	Aceuracycluss
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准

quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ☒ 本实验室 ☐ 现场

Address

环境温度: 22 °C

湿度: 56%RH

其它: /

Ambient Tempersture

Relative Humidity

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。

2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。

3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督检验所

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0195 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant
计量器具名称 压力表
Name of Instrument
型号 / 规格 (0~4)MPa
Type/Specification
出厂编号 202306049593
Serial No.
制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer
检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation
检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人
Approved by

李梅

核验员

耿洋

Checked by

检定员

戴绍松

Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日

Date of Verification

有效期至: 2024 年 6 月 19 日

Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号

Authorization Certificate No.

地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧

Address

传真: 0551-62721250

Fax

电话: 0551-62721250

Telephone

邮编: 231131

Post Code

邮箱: Cfjls2013@126.com

Email

证书编号: FP2023-12-0195
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准
Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准名称 压力表检定装置
Public Standards of Measurement Used for This Verification
社会公用计量标准证书编号 [2020]皖合社量标长证字第008号
Certificate No. for the Public Standards of Measurement
社会公用计量标准有效期 2024年05月19日
Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具 Main measurement standards used in this Verification					
名称 Name	型号/规格 Type /Specification	编号 Number	有效期至 Due date	证书编号 Certificate No.	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差 Accuracyclass
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级
以上计量标准器具的量值溯源至国家基准 quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.					

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ☒ 本实验室 ☐ 现场

Address

环境温度: 22 °C

Ambient Tempersture

湿度: 56%RH

Relative Humidity

其它: /

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

- 注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。
2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。
3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督管理局

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0191 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant

计量器具名称 压力表
Name of Instrument

型号/规格 (0~4)MPa
Type/Specification

出厂编号 202306049575
Serial No.

制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer

检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation

检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人 李梅
Approved by
核验员 耿洋
Checked by
检定员 戴经松
Verified by



检定日期: 2023 年 12 月 20 日
Date of Verification
有效期至: 2024 年 6 月 19 日
Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号
Authorization Certificate No.
地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧
Address
传真: 0551-62721250
Fax

电话: 0551-62721250
Telephone
邮编: 231131
Post Code
邮箱: Cfjls2013@126.com
Email

证书编号: FP2023-12-0191
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准
Public Standards of Measurement Used for This Verification

社 会 公 用 计 量 标 准 名 称 压力表检定装置
Public Standards of Measurement Used for This Verification
社 会 公 用 计 量 标 准 证 书 编 号 [2020]皖合社量标长证字第008号
Certificate No. for the Public Standards of Measurement
社 会 公 用 计 量 标 准 有 效 期 2024年05月19日
Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具 Main measurement standards used in this Verification					
名称 Name	型号/规格 Type /Specification	编号 Number	有效期至 Due date	证书编号 Certificate No.	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差 Accuracyclass
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级
以上计量标准器具的量值溯源至国家基准 quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.					

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ☒ 本实验室 ☐ 现场

Address

环境温度: 22 °C

Ambient Tempersture

湿度: 56%RH

Relative Humidity

其它: /

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

- 注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。
2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。
3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件

长丰县市场监督检验所

ChangFeng County Market Supervision and Inspection Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP2023-12-0198 号
Certificate No.

送检单位 安徽威尔泰克机电设备有限公司
Applicant
计量器具名称 压力表
Name of Instrument
型号/规格 (0~4)MPa
Type/Specification
出厂编号 202306049698
Serial No.
制造单位 上海仪川仪表厂
Manufacturer
检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
Verification Regulation
检定结论 1.6 级合格
Conclusion



批准人
Approved by

李梅

核验员

耿洋

Checked by

检定员

戴经松

Verified by

检定日期: 2023 年 12 月 20 日
Date of Verification
有效期至: 2024 年 6 月 19 日
Valid until

计量检定机构授权证书号: (国)法计(皖2020)101号
Authorization Certificate No.
地址: 长丰县双凤经济开发区淮南北路东侧
Address
传真: 0551-62721250
Fax

电话: 0551-62721250
Telephone
邮编: 231131
Post Code
邮箱: Cfjls2013@126.com
Email

证书编号: FP2023-12-0198
Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准名称 压力表检定装置

Public Standards of Measurement Used for This Verification

社会公用计量标准证书编号 [2020]皖合社量标长证字第008号

Certificate No. for the Public Standards of Measurement

社会公用计量标准有效期 2024年05月19日

Due Date of Certificate of Public Standards of

本次检定所使用的主要计量标准器具

Main measurement standards used in this Verification

名称	型号/规格	编号	有效期至	证书编号	准确度等级/ 不确定度/最 大允许误差
Name	Type /Specification	Number	Due date	Certificate No.	Aceuracyclass
精密压力表	(0~4) MPa	HC64592701513	2024/1/18	RG2023B-000501	0.4级

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准

quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the nationnal primary standards in the P.R.

检定地点及环境条件

Location and Environmental Conditions for Verification

地点: ■ 本实验室 □ 现场

Address

环境温度: 22 °C

湿度: 56%RH

其它: /

Ambient Tempersture

Relative Humidity

Others

检定结果 / 说明:

Results of verification and additional explanation

外观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

检定结论: 符合1.6级。

注: 1.未经本所批准, 部分采用本证书的内容无效。

2.本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。

3.请妥善保管此证书。

下次送检请带此证书的复印件