보다 나은 정부

청렴한 세상

산소공급기

02

식품의약품안전처
Ministry of Food and Drug Safety

식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

청렴한 세상

[공직자 부조리 및 공익신고안내] 신고자 및 신고내용은 보호됩니다.
▶ 부조리 신고 : 식약처 홈페이지 "국민신문고 > 공직자 부조리 신고" 코너
▶ 공익 신고 : 식약처 홈페이지 "국민소통 > 신고센터 > 부패 · 공익신고 상담" 코너

■ 산소공급기

◉ 산소통(실린더), 산소투여용튜브 • 카테터 등과 결합하여 환자의 호흡을 위해 사용하는 기구

* 외출시(쇼핑이나 통원 등)에는 산소공급기를 사용합니다.
* 정전시나 화재시, 의료용산소발생기의 고장에 대비한 보조장치 역할도 합니다.

◉ 산소공급기는 '유량조정기 일체형'과 '유량조정기 분리형'이 있습니다.

● 유량조정기 일체형 산소공급기 ●

■ 조작방법 1 (유량조정기 일체형)

☞ 자세한 내용은 제품마다 다르므로, 제조원의 사용설명서를 확인하여 사용합니다.

01 산소투여용튜브·카테터를 커플러 소켓에 연결하고, 커플러 소켓을 산소출구 노즐에 연결합니다.

02 조정 핸들을 돌려 지시판 화살표를 의사에게 지시받은 유량에 맞춥니다.

03 산소투여용튜브·카테터를 이용해 흡입합니다.

● 유량조정기 분리형 산소공급기 ●

■ 조작방법 2 (유량조정기 분리형)

☞ 자세한 내용은 제품마다 다르므로, 제조원의 사용설명서를 확인하여 사용합니다.

01
유량조정기에 패킹(O-ring)이 있는지와 파손 여부를 확인합니다.

02

방향은 유량조정기의 안내 핀과 산소통(실린더)의
구멍 방향을 같게 핀을 구멍에 넣습니다.

03
설치 핸들을 오른쪽으로 돌려 단단히 닫습니다.

04

유량설정 다이얼의 눈금 "0"을 확인합니다.

05
밸브를 왼쪽(열림 방향) 방향으로 반바퀴 돌립니다.

06
압력계의 바늘이 "녹색" 위치까지 오른 것을 확인합니다.

07
유량 설정 다이얼을 의사에게 지시받은 유량에 맞춥니다.

08
산소투여용튜브 • 카테터를 이용해 흡입합니다.

■ 산소통(실린더) 교체 방법 (유량조정기 분리형)

☞ 압력계의 바늘이 "적색" 범위에 오면 산소통(실린더)을 교체

☞ 자세한 내용은 제품마다 다르므로, 제조원의 사용설명서를 확인하여 사용합니다.

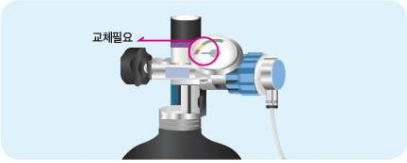

01 밸브를 오른쪽으로 돌려 닫습니다.

02 유량 설정 다이얼의 눈금을 "0"로 되돌립니다.

03 설치 핸들을 오른쪽으로 돌려 유량조정기를 산소통(실린더)과 분리합니다.

04 새로운 산소통(실린더)에 분리한 유량조정기를 설치합니다.
* 산소투여용튜브 • 카테터를 연결한 상태에서 해도 상관 없습니다.

대문접지1217.indd 1
2018-12-17 오후 2:06:16