■ 산소투여용튜브 • 카테터의 사용방법

01 산소투여용튜브 • 카테터의 방향을 확인해 콧구멍에 장착합니다.

02 좌/우 귀에 산소투여용튜브 • 카테터를 겁니다.

03 스토퍼를 위로 올립니다.

04 * 산소투여용튜브 • 카테터를 후방에 장착하는 방법도 있습니다. (취침시 머리로 튜브를 압박하지 않도록 주의 필요)

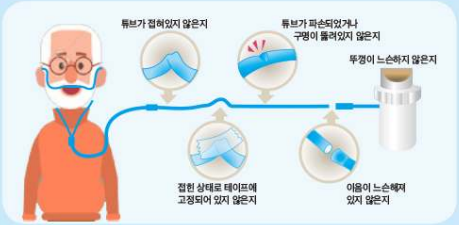

산소공급기 사용할 때 이것만은 꼭 지키세요!

☞ 자가호흡이 없는 환자, 마취환자 및 고압산소치료중인 환자에게 사용하지 마세요
☞ 산소의 과다 공급시 산소중독 현상이 발생할 수 있으므로 장시간 사용하지 마세요
☞ 산소용기 및 밸브는 고압가스안전관리법에 의거, 반드시 검사 기한 내에 재검사를 받은 후 사용하세요
☞ 산소 충전은 반드시 의료용 산소 제조업허가를 득한 업체에서 하세요
☞ 제품 혹은 산소실린더에 오일, 그리스 등의 유지류가 묻어있을 경우 산소 용기의 폭발 위험이 있으니 반드시 이들을 제거 후 사용하세요
☞ 의사의 처방전에 따라 산소량을 조절하여 사용하세요
☞ 산소실린더 밸브와 압력에 맞는 산소공급기를 사용하세요
☞ 제품은 불꽃이나 담뱃불 등 화기 근처에서 사용할 경우 산소 용기가 폭발할 위험이 있으니 이러한 환경에서는 사용하지 마세요.
☞ 제품을 임의로 변경 또는 개조하지 마시고, 고장 발생시 판매점 또는 제조회사의 A/S 부서에 연락해 주세요
☞ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요
☞ 안전사고가 발생 할 위험이 있으니 산소실린더를 넘어뜨리거나 충격을 가하지 마세요

의료용산소발생기

■ 의료용산소발생기

◉ 공기의 대부분을 차지하는 질소를 제거해, 산소를 높은 농도(약90%)로 농축하는 기구

* (휴대형) 호흡용 산소 배출 농도는 80% 이상

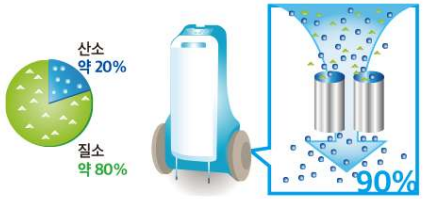

◉ 의료용산소발생기는 촉매를 이용한 산소발생, 전기분해를 이용한 산소발생, PSA(Pressure Swing Adsorption)방식을 이용한 산소발생, 기체분리방식을 이용한 산소발생 등이 있고,

- 가정에서는 흡입된 공기를 압축하여 산소와 질소를 분리하는 PSA방식 제품이 주로 사용됩니다.

* PSA(Pressure Swing Adsorption) : 압력전환흡착

■ 의료용산소발생기 사용방법

◉ 공기의 대부분을 차지하는 질소를 제거해, 산소를 높은 농도(약90%)로 농축하는 기구

* (휴대형) 호흡용 산소 배출 농도는 80% 이상

☞ 자세한 내용은 제품마다 다르므로, 제조원의 사용설명서를 확인하여 사용합니다.

01 전원플러그를 콘센트에 꽂습니다.
* 하나의 콘센트에 여러 기기를 연결하면 안 됩니다.

02 운전스위치를 누릅니다.

03 유량 설정 버튼으로 지시된 유량을 정확히 세팅합니다.
* 반드시 의사의 처방지도에 따라 유량을 설정합니다.

04 산소투여용튜브 • 카테터를 장착하고, 산소 흡입을 시작합니다.
* 산소가 나오지 않는다고 생각되면 산소투여용튜브 • 카테터의 끝부분을 컵의 물에 넣고 기포가 나오면 정상입니다.

05 사용하지 않을 때는 운전스위치를 눌러 전원을 끕니다.
* 의사의 처방에 의한 소정의 시간을 지켜 사용합니다.

■ 의료용산소발생기 청소방법

☞ 일반적인 사항으로 구체적인 내용은 제품마다 다를 수 있으므로, 제조원의 사용설명서를 확인하여 사용합니다.

01 **필터**
▷ 필터 청소(매일)
▷ 필터 세정(주1회)
* 주1회 세척하고 잘 건조한 후 사용합니다.



02 **가습물통**
▷ 가습물통에는 정제수를 사용합니다.
▷ 가습물통의 정제수는 1주일에 2~3회 교체합니다.
▷ 정제수는 가습물통의 지시된 수위보다 적기 전에 보충합니다.
※ 알콜이나 소독액으로 착각하지 않도록 주의합니다.

의료용산소발생기 사용할 때 이것만은 꼭 지키세요!

☞ 의사의 처방전에 따라 산소량을 조절하여 사용하세요
☞ 제품은 불꽃이나 담뱃불 등 화기 근처에서 사용할 경우 폭발할 위험이 있으니 이러한 환경에서는 사용하지 마세요.
☞ 제품을 임의로 변경 또는 개조하지 마시고, 고장 발생시 판매점 또는 제조회사의 A/S 부서에 연락해 주세요
☞ 필터, 흡착탑의 교체 및 청소는 제조(수입)사가 제시하는 주기를 지켜주세요
☞ 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 벽면으로부터 지정된 간격 이상을 유지해 주세요
☞ 함께 사용하도록 지정되지 않은 구성품(예: 가습물통 등)의 사용은 제품의 성능에 영향을 줄 수 있으므로 지정된 구성품을 사용할 것