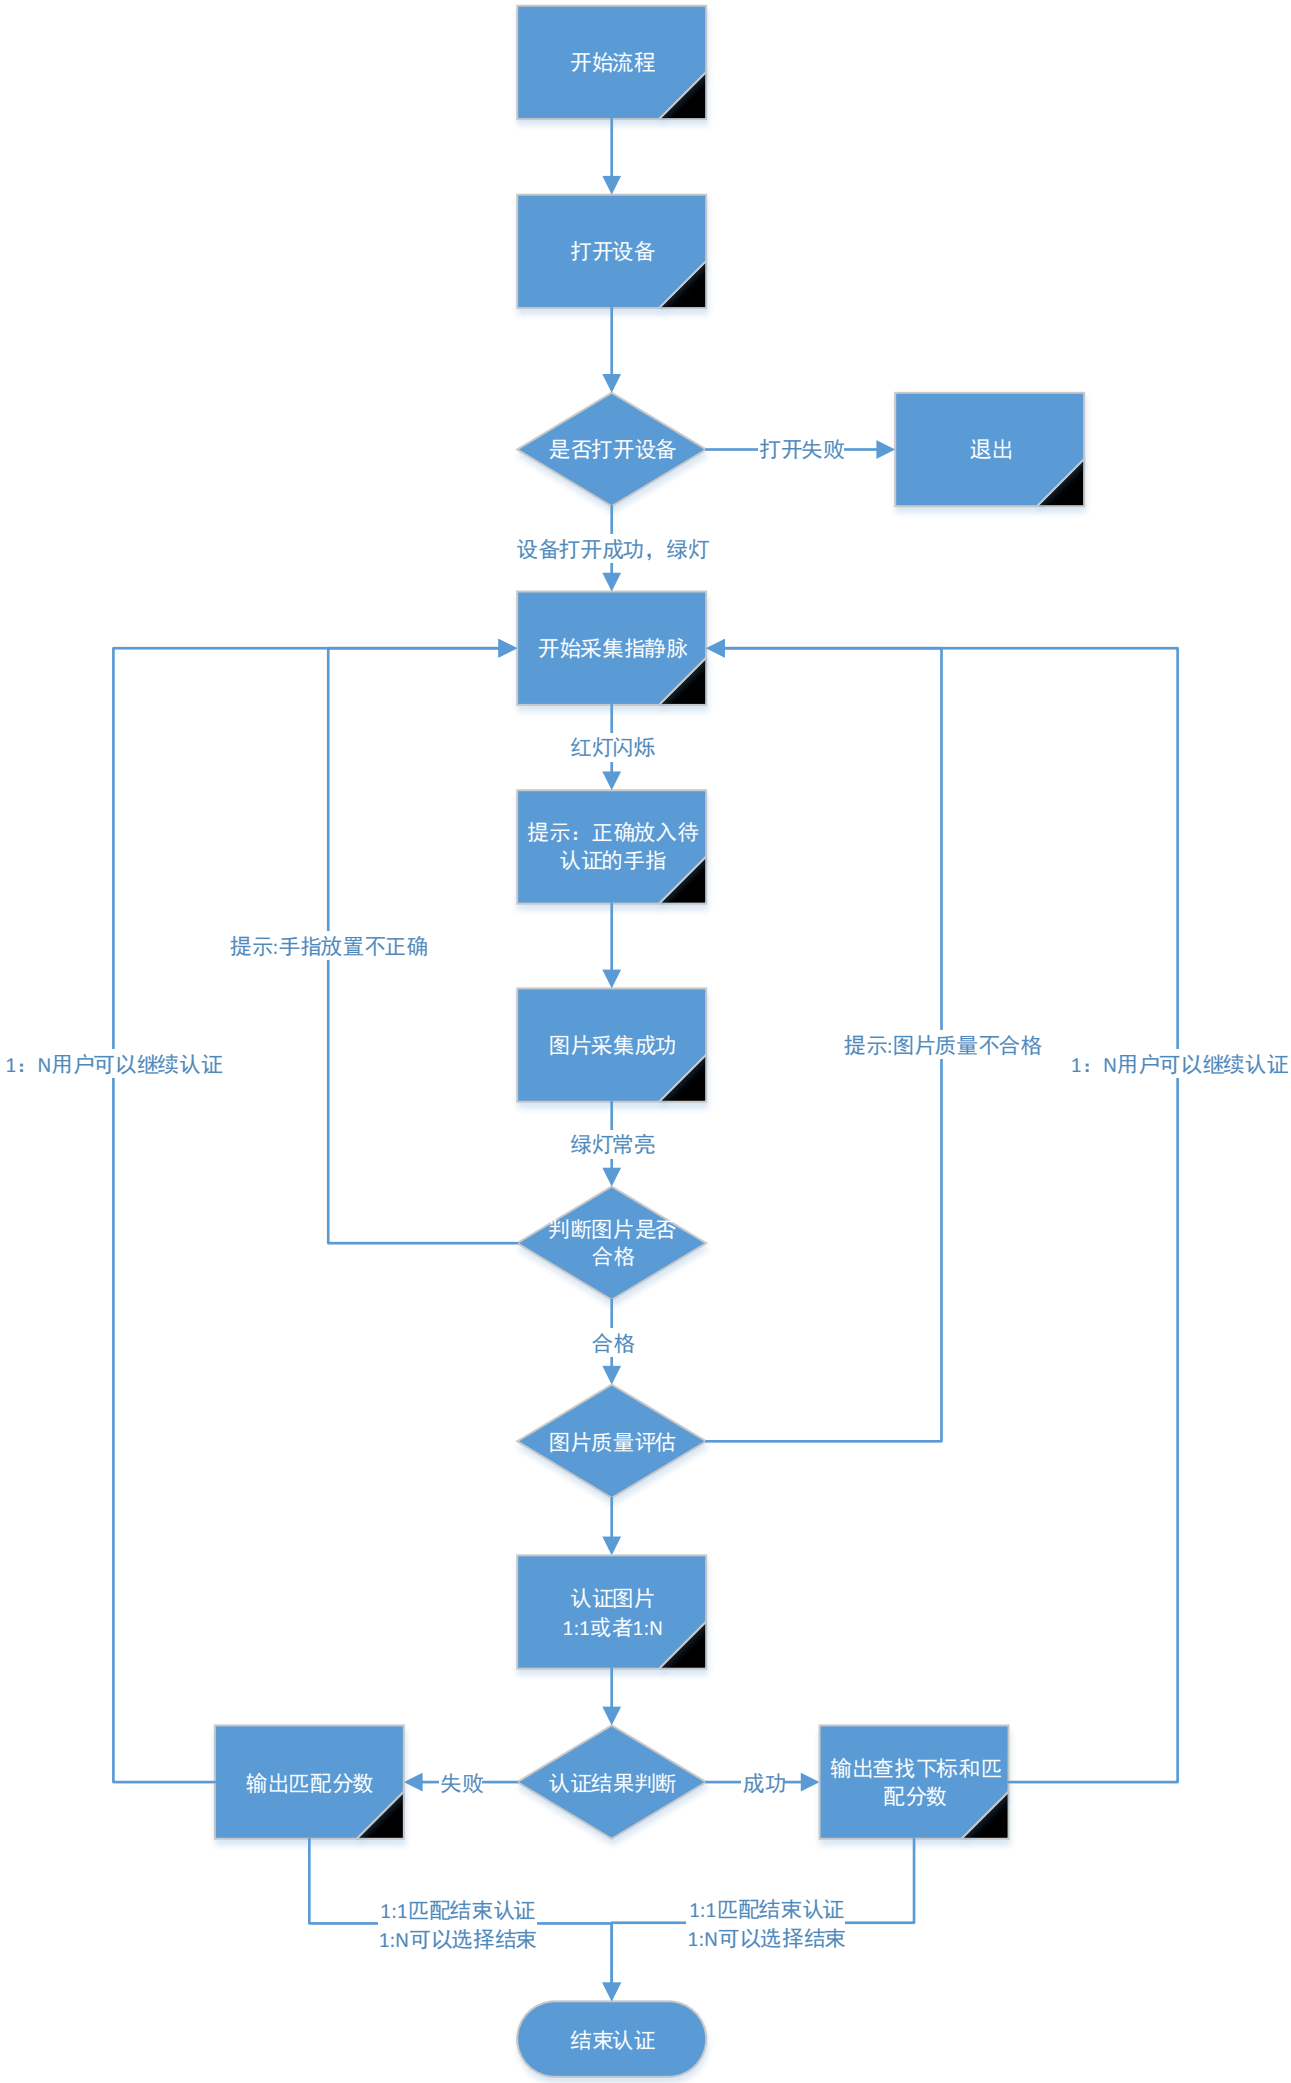

开始流程
打开设备
是否打开设备
打开失败
退出
设备打开成功，绿灯
开始采集指静脉
红灯闪烁
提示：正确放入待认证的手指
提示:手指放置不正确
图片采集成功
提示:图片质量不合格
1：N用户可以继续认证
1：N用户可以继续认证
绿灯常亮
判断图片是否合格
合格
图片质量评估
认证图片
1:1或者1:N
输出匹配分数
失败
认证结果判断
成功
输出查找下标和匹配分数
1:1匹配结束认证
1:N可以选择结束
1:1匹配结束认证
1:N可以选择结束
结束认证