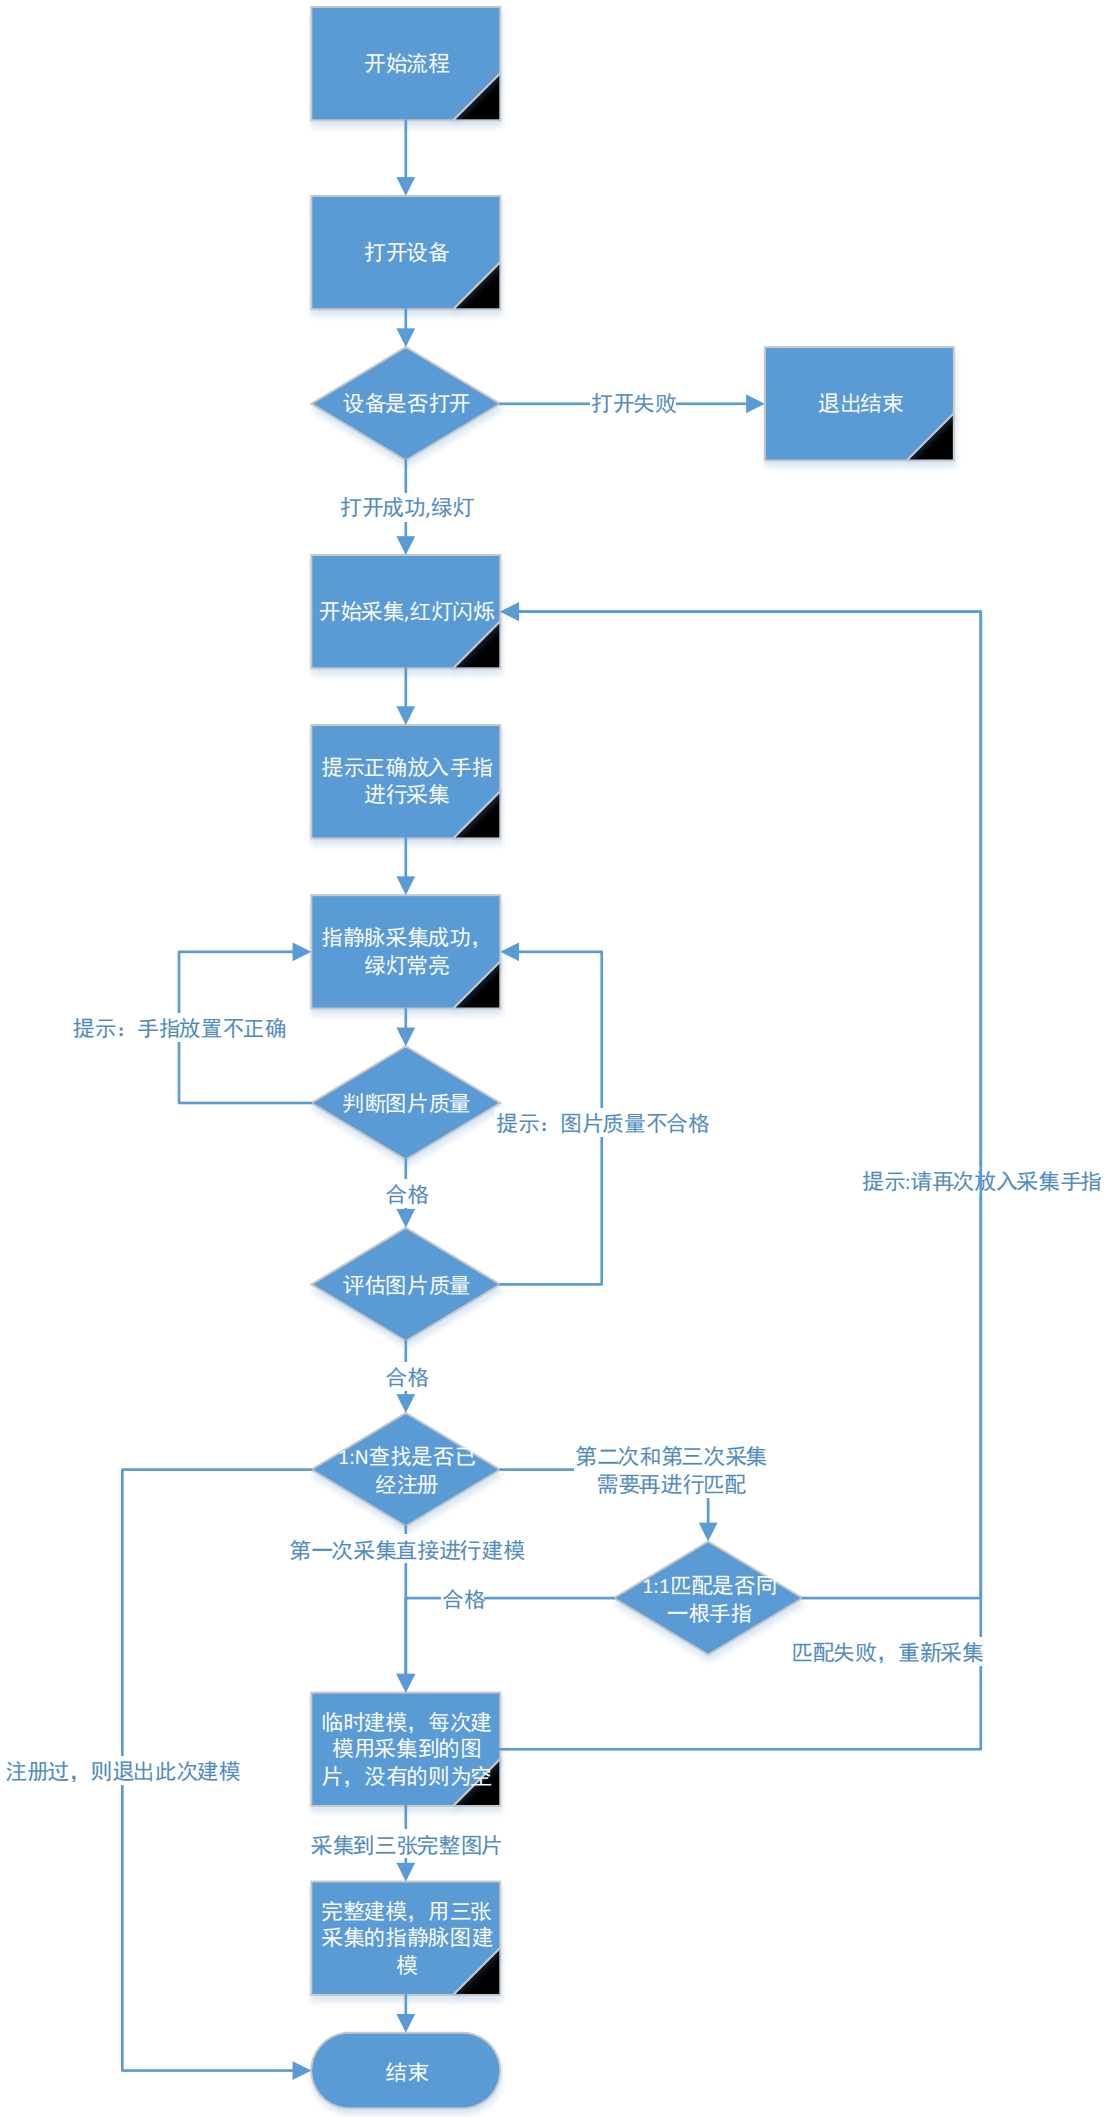

开始流程
打开设备
设备是否打开
打开失败
退出结束
打开成功,绿灯
开始采集,红灯闪烁
提示正确放入手指进行采集
指静脉采集成功,绿灯常亮
提示：手指放置不正确
判断图片质量
提示：图片质量不合格
合格
评估图片质量
合格
1:N查找是否已经注册
第二次和第三次采集需要再进行匹配
第一次采集直接进行建模
1:1匹配是否同一根手指
合格
匹配失败，重新采集
提示:请再次放入采集手指
临时建模，每次建模用采集到的图片，没有的则为空
注册过，则退出此次建模
采集到三张完整图片
完整建模，用三张采集的指静脉图建模
结束