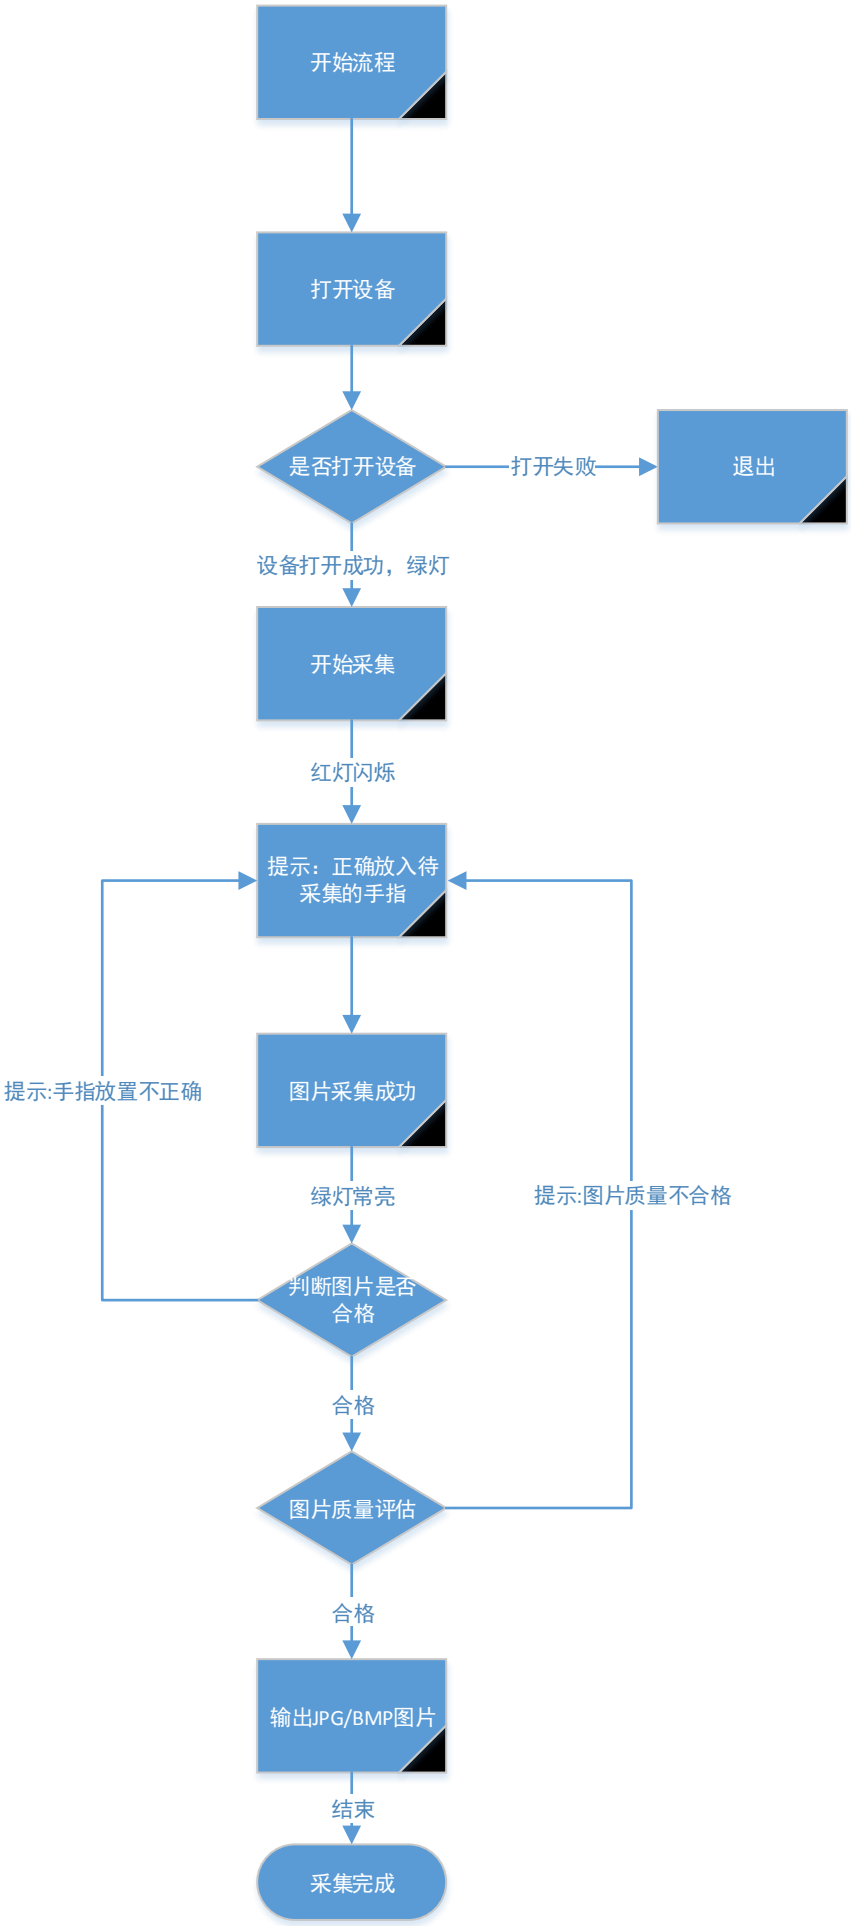

开始流程
打开设备
是否打开设备
打开失败
退出
设备打开成功，绿灯
开始采集
红灯闪烁
提示：正确放入待采集的手指
图片采集成功
提示:手指放置不正确
绿灯常亮
提示:图片质量不合格
判断图片是否合格
合格
图片质量评估
合格
输出JPG/BMP图片
结束
采集完成