Essai Zygo 2A / Nouvelle interface / Affichage des résultats

Julien Villemejane

Prise d’images avec Zygo (version 1A)

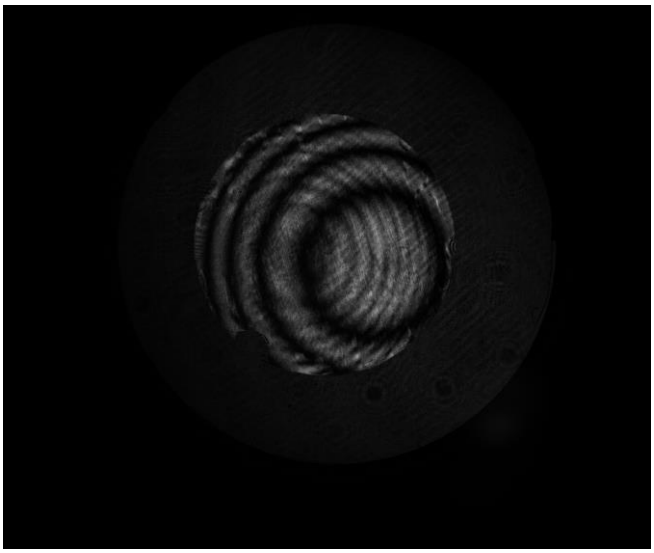

5 images et somme des 4 premières (vérification « shift » correct)

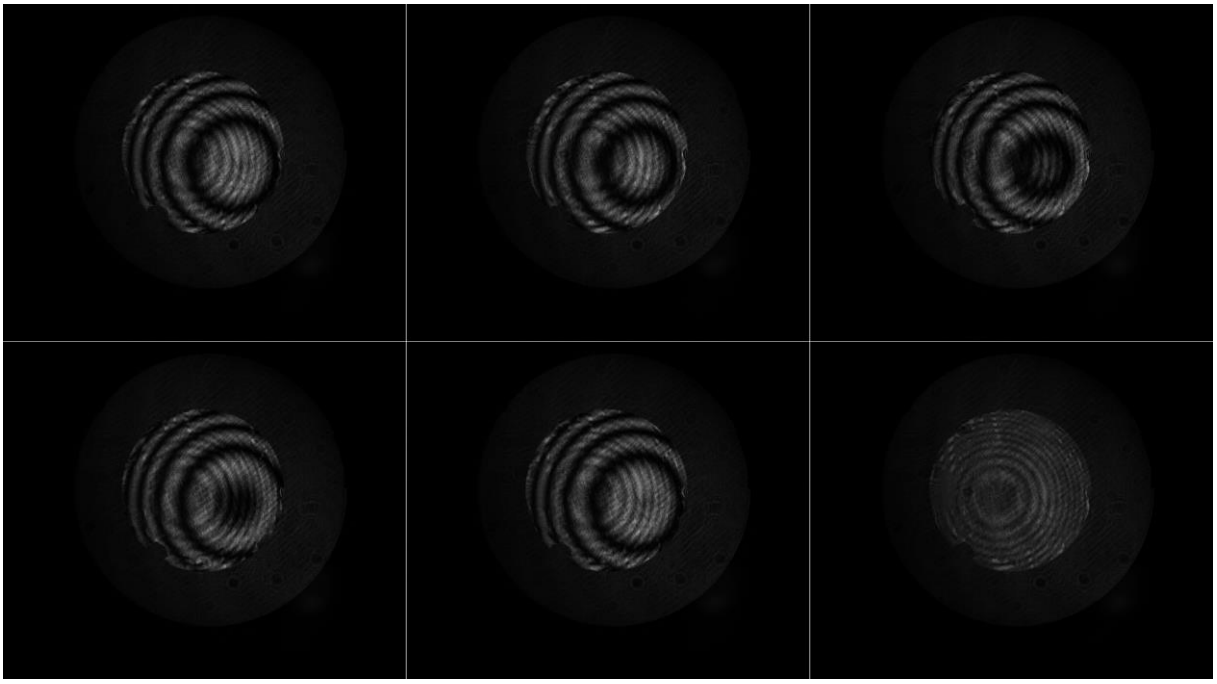

Phase shift pour retrouver la phase (graduation en pixels / à ramener en distance - mm)
Front d'onde en lambda (à voir pour ramener dans une autre unité si besoin)

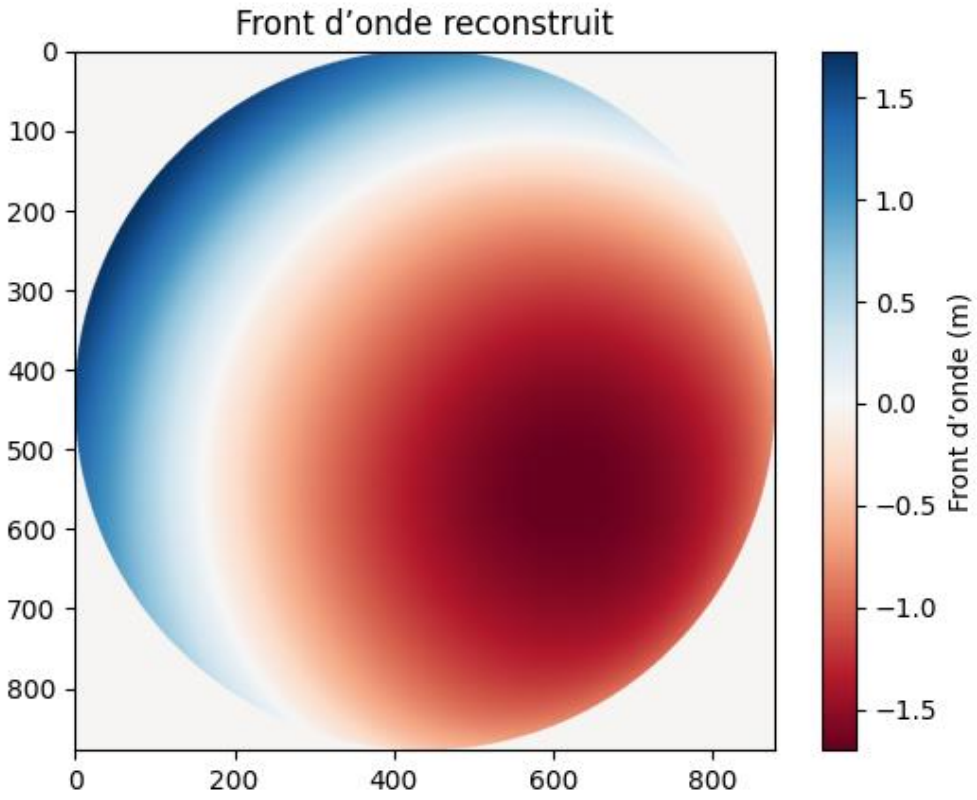

Coefficient de Zernike (indice Noll)

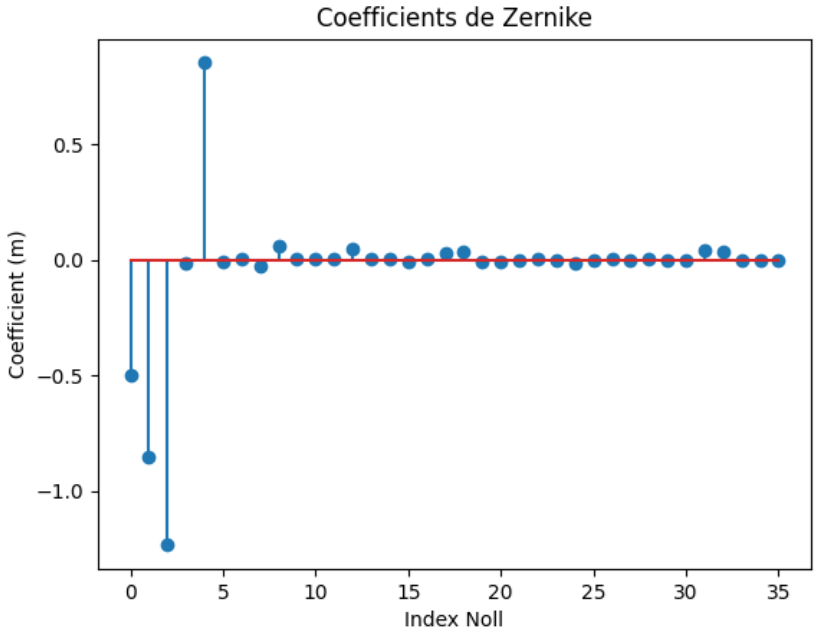

PSF (correction gamma 0.1) – 2D (graduation en m-1)

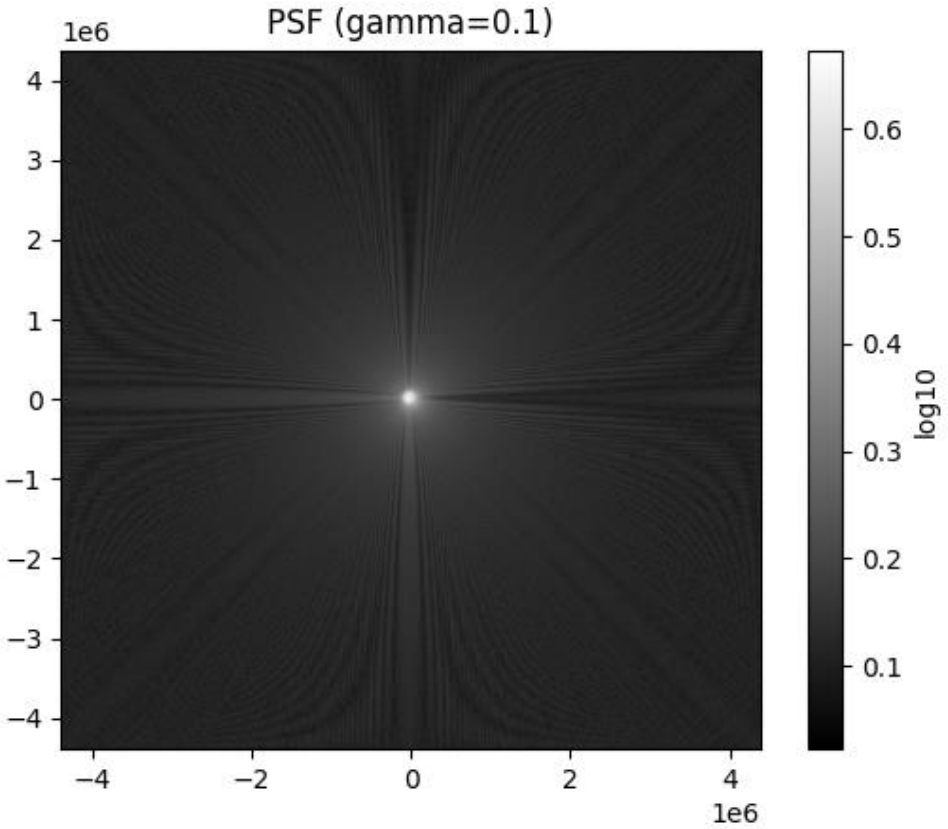

Comparaison PSF et limite diffraction

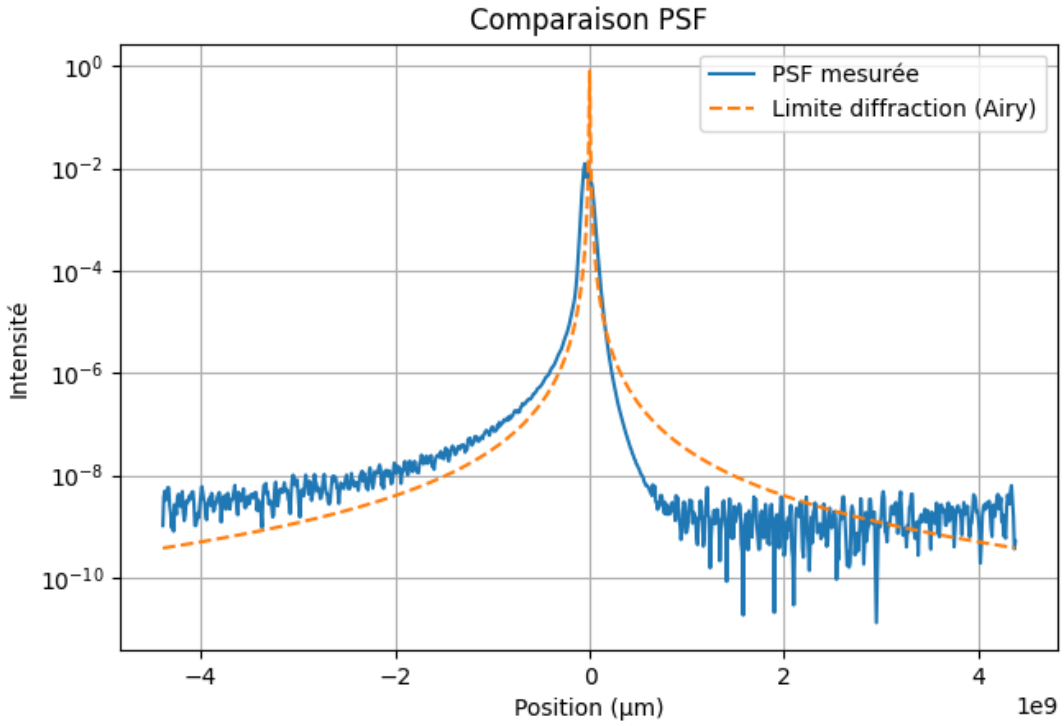

MTF (FTM ? – Axe fréquence à revoir)

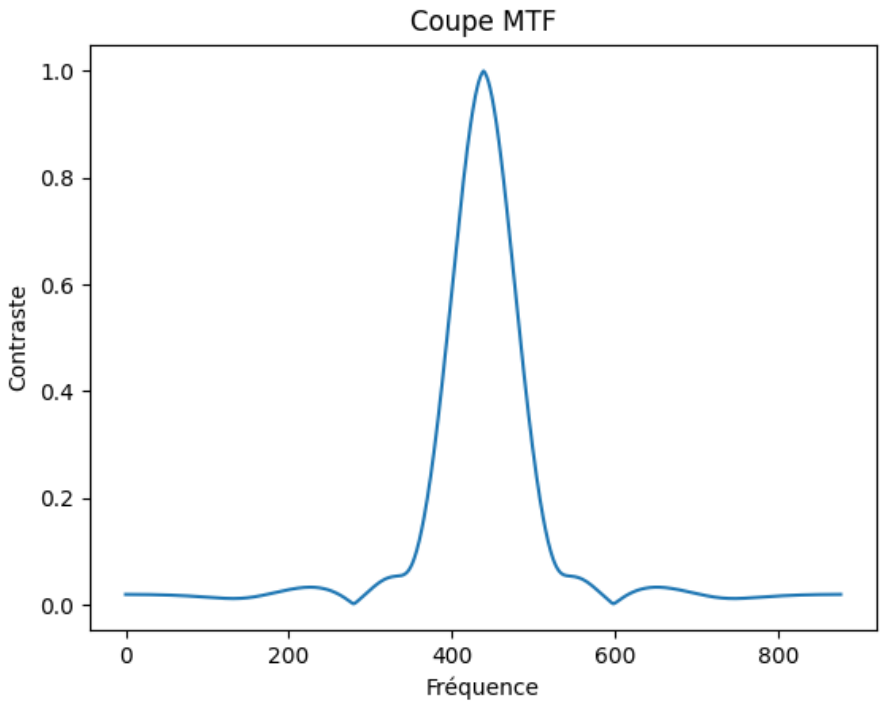
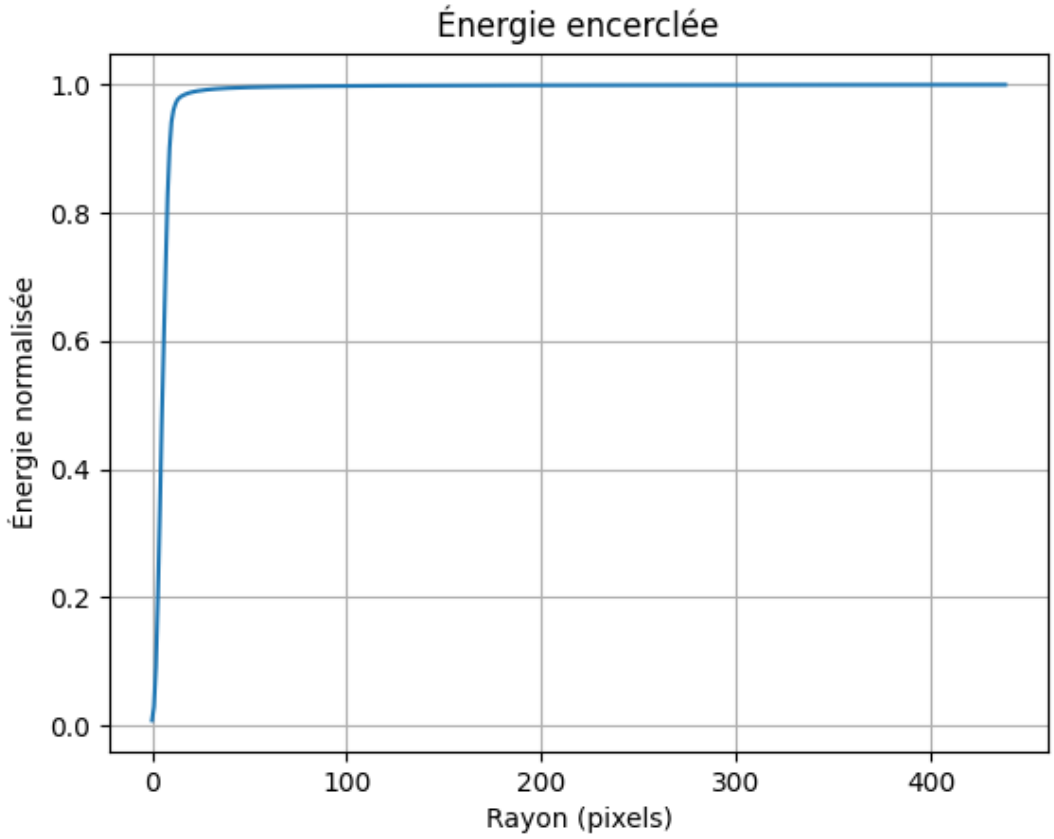
Energie encerclée (graduation rayon à revoir)