


Film-to-Dose Report

Film infos:

Author: MR
Unit: 1
Film lot: C9
Scanner ID: Epson 12000XL
Date exposed: 2019/12/21
Date scanned: 2019/12/22
Wait time: 14 hr

Conversion options:

Film file: 122717_ThLSD_1A_005.tif
LUT file: DemoCalibrationTransmissionNoLatCorr_0-28Gy.pkl
Film filter kernel: 0
LUT filter kernel: 35
LUT fit: rational

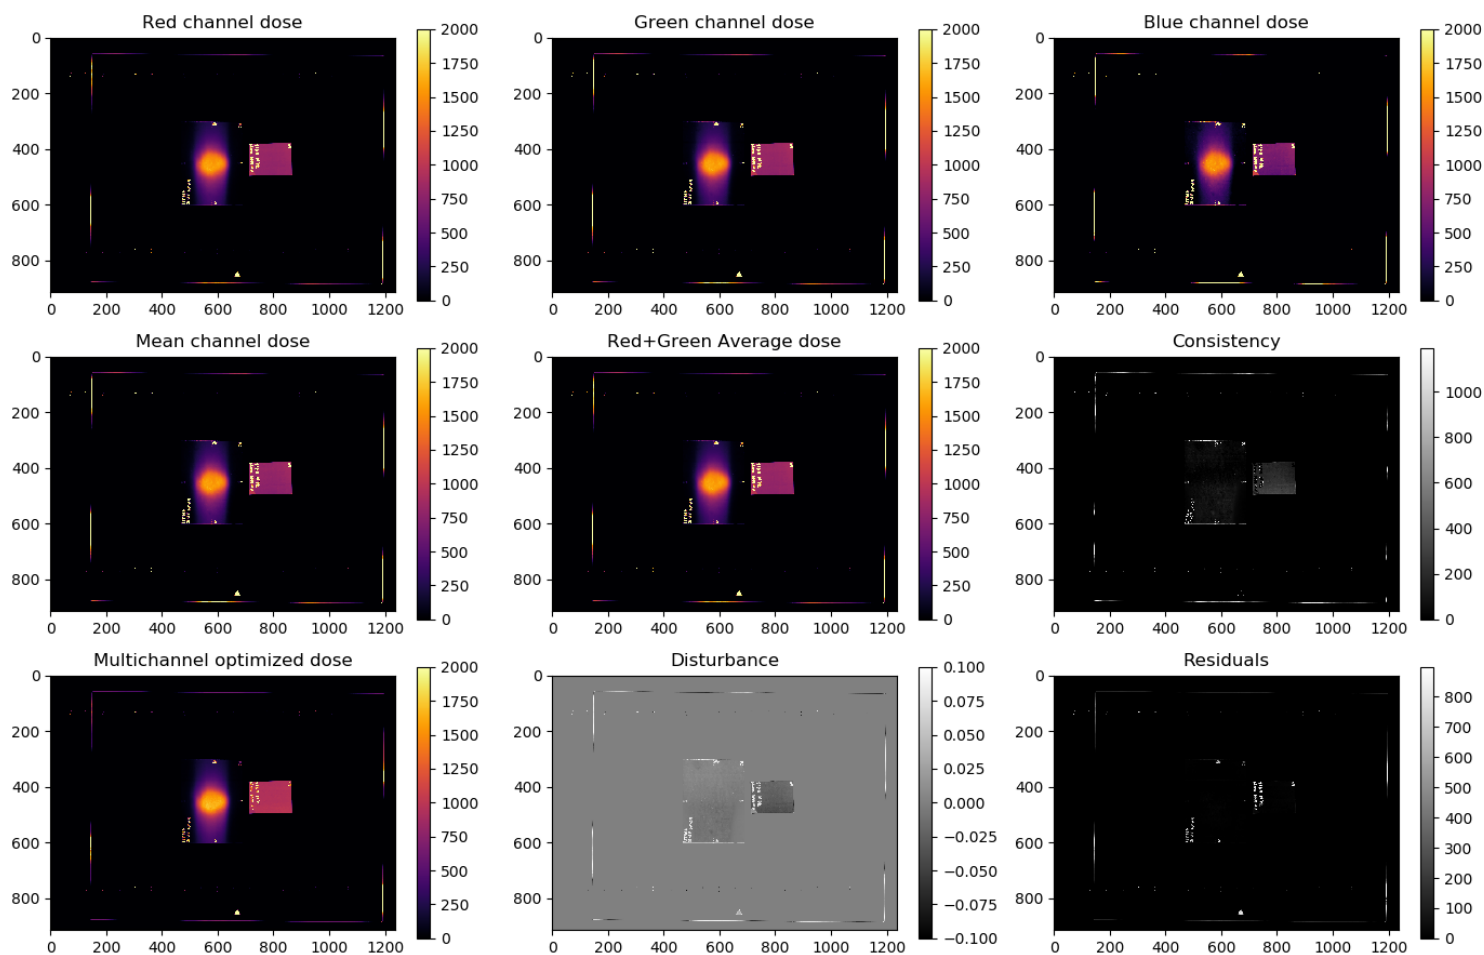

Notes:

Scan en transmission avec la vitre.