
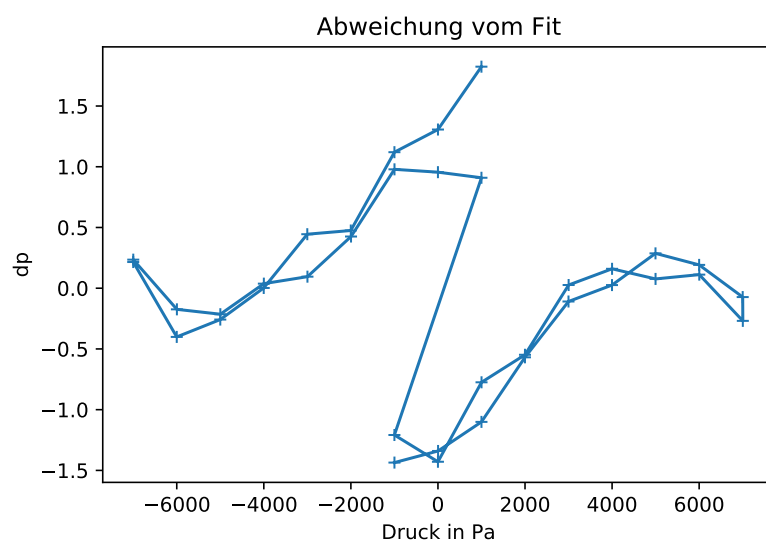


# Kalibration G18\_p 2

Kalibration durchgeführt von	B. Kraus
Datum	July 2, 2020
Sensortyp	Druck
Sensorbezeichnung	G18_p 2
Aufbau:	Kalibrator Kalt, Ref Block
Fitfunktion:	$A0 + A1 * D + A2 * D^{**2} + A3 * D^{**3}$
A0	-8973.54383621541
A1	17124.453013108938
A2	-299.5064619893555
A3	38.21173621483988
R²:	0.9999999644406555
2sigma	1.4927080252680587

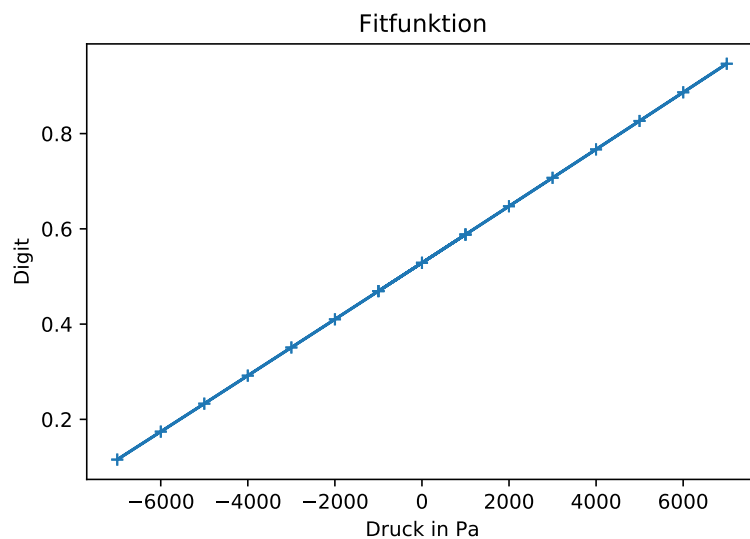

## Gemittelte Rohdaten aus Kalibration

Pressure [bar]	øDigit	std Digit
-999.409	30748.61	3.76
2.838	34646.08	3.12
999.43	38528.65	2.35
1998.586	42428.73	1.31
2998.654	46338.35	0.96
3998.274	50251.02	1.48
4997.014	54166.65	2.78
5999.858	58102.76	1.56
7000.314	62034.41	3.39
7003.224	62045.08	2.01
6002.967	58114.65	5.01
4998.317	54170.94	1.71
3999.583	50256.67	1.83
3001.827	46351.29	3.73
1999.103	42430.84	1.61
1000.958	38535.88	2.86
-0.219	34633.84	1.78
-1000.162	30746.57	3.7
999.164	38535.45	1.62
-0.338	34642.65	1.6
-998.63	30761.02	2.37
-1996.801	26884.31	2.53
-2998.016	23003.51	1.9
-3999.289	19130.57	1.84
-4998.871	15270.57	1.51
-5996.636	11425.98	3.58
-6998.914	7572.86	2.06
-7000.031	7568.49	1.9
-6000.082	11411.84	1.84
-5000.118	15265.59	1.98
-4002.226	19119.08	2.52
-3001.402	22991.76	2.35
-2002.428	26862.67	4.09
-999.764	30757.16	1.67
0.386	34646.84	1.45
998.815	38537.65	1.45