
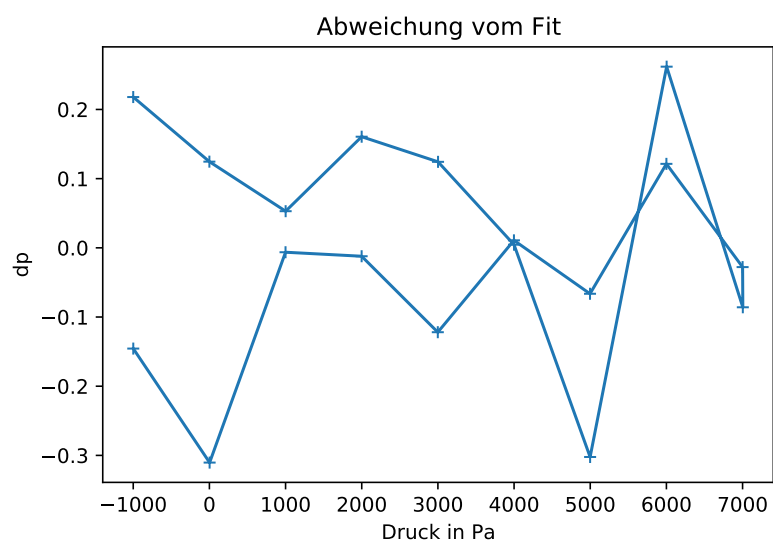


Kalibration K1_G18_p 1

Kalibration durchgeführt von	B.Kraus
Datum	July 2, 2020
Sensortyp	Druck
Sensorbezeichnung	K1_G18_p 1
Aufbau:	Kalibrator Kalt, Ref Block
Fitfunktion:	$A0 + A1 * D + A2 * D^{**2} + A3 * D^{**3}$
A0	-8978.432772358
A1	17179.414277959695
A2	-382.99963792330783
A3	82.89602845539265
R²:	0.9999999964415729
2sigma	0.30805250477910895

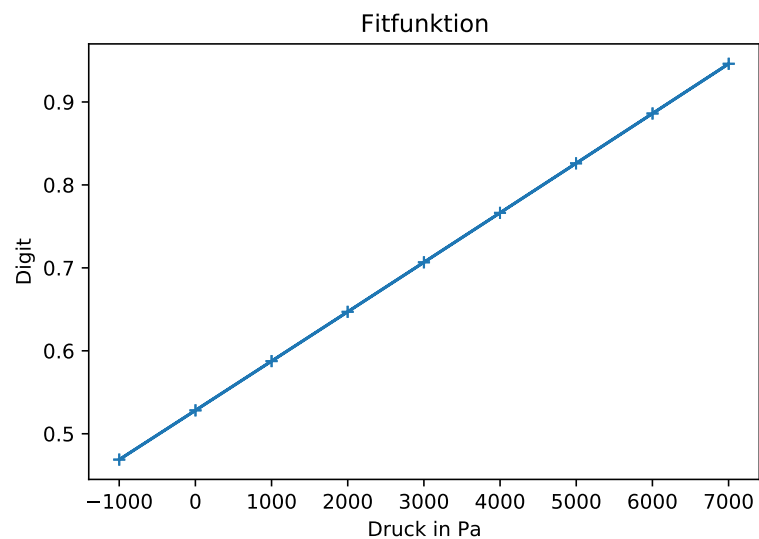

Gemittelte Rohdaten aus Kalibration

Pressure [bar]	øDigit	std Digit
-999.409	30725.92	2.53
2.838	34621.16	3.22
999.43	38503.12	1.9
1998.586	42400.37	1.34
2998.654	46306.92	1.48
3998.274	50218.43	1.07
4997.014	54131.04	2.6
5999.858	58065.78	1.05
7000.314	61994.41	3.4
7003.224	62005.61	2.47
6002.967	58078.53	5.35
4998.317	54135.22	2.38
3999.583	50223.53	1.72
3001.827	46320.29	3.27
1999.103	42403.06	2.1
1000.958	38509.31	2.36
-0.219	34610.96	1.59
-1000.162	30724.41	3.64