

Quantification en tomographie d'émission

Obstacles
Solutions
Fiabilité

Irène Buvat
U678 INSERM
Paris


<http://www.guillemet.org/irene>
buvat@imed.jussieu.fr

Frévrier 2006

Plan du cours

Objectifs pédagogiques :

- comprendre les possibilités et limites de l'interprétation quantitative des images SPECT et PET
- connaître les conditions à observer pour prétendre à des mesures quantitatives fiables à partir des images

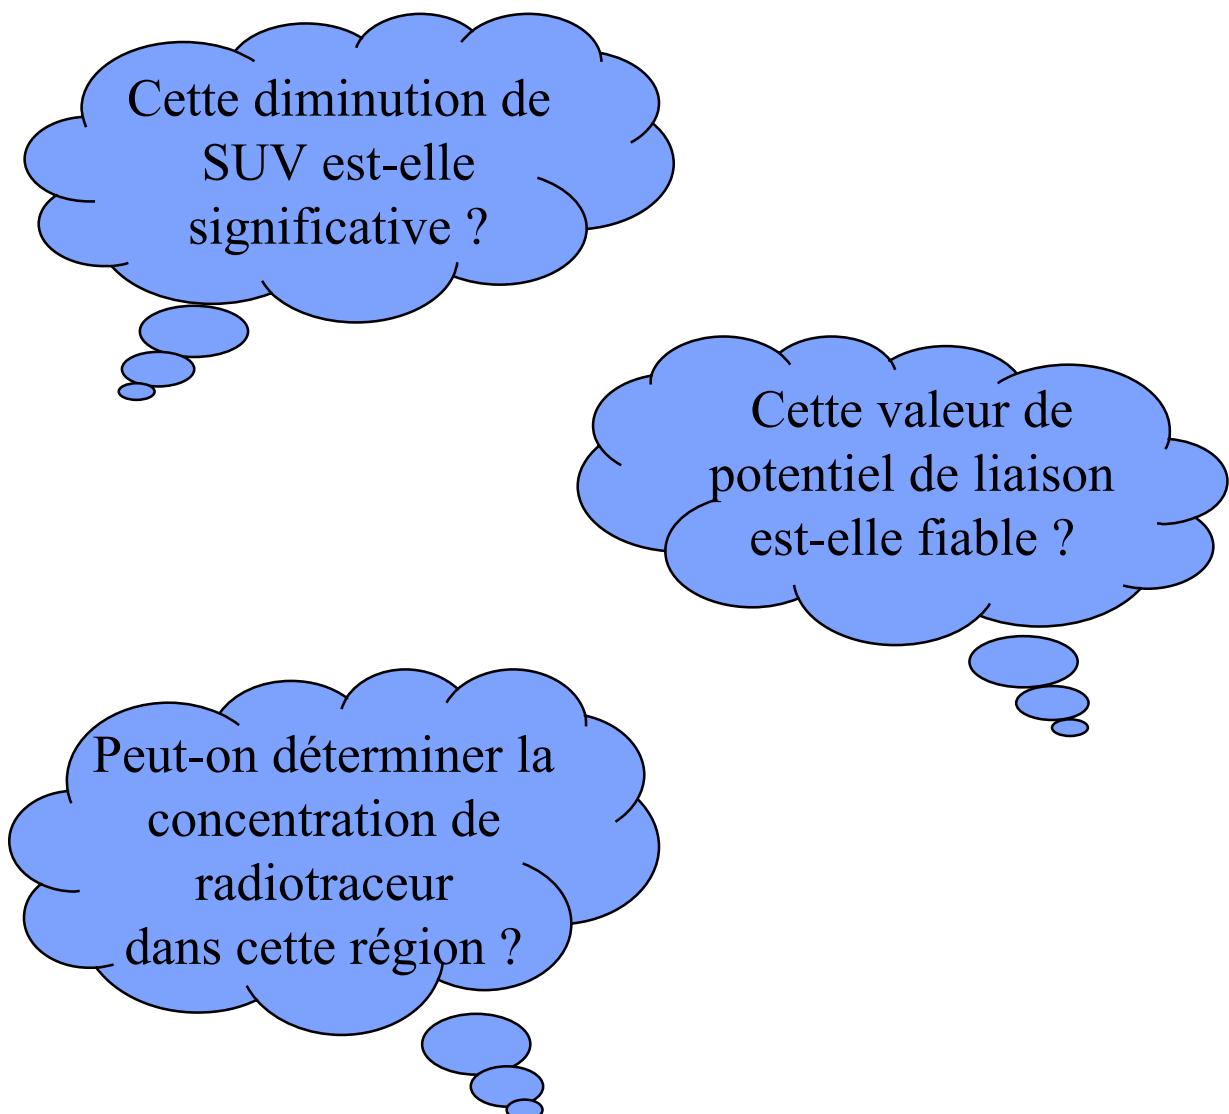


Plan du cours

- Introduction
 - Quantification en tomographie d'émission : définition et enjeux
 - Phénomènes biaisant la quantification
- Les grands problèmes affectant la quantification en PET et SPECT : problème, conséquences, méthodes de correction, résultats
 - Atténuation
 - Diffusion
 - Effet de volume partiel
 - Mouvement
 - Résolution spatiale non stationnaire en SPECT
 - Coïncidences fortuites en PET
 - Normalisation en PET
- Synthèse
 - Performances accessibles
 - Comment faire ?
 - Précautions
 - Au delà de la mesure d'activité


Introduction : qu'est-ce que la quantification ?

- Quantification ~ mesure

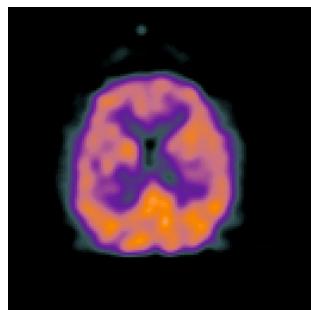

⇒ grandeur numérique extraite d'une image

En Médecine Nucléaire :

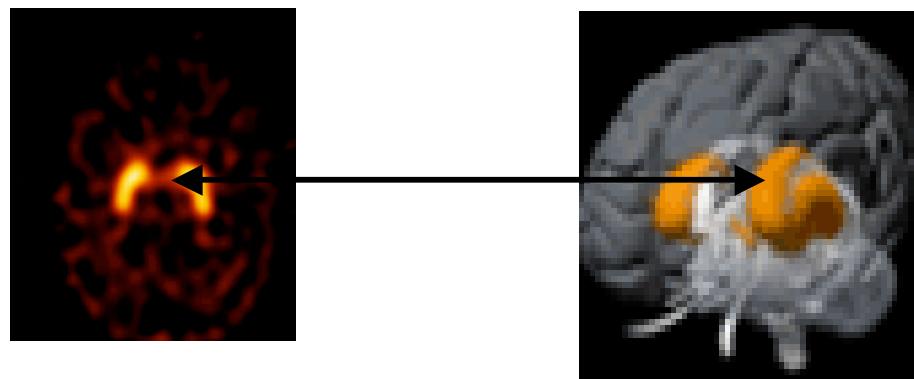

intensité du signal dans
une région
(valeur des pixels)

concentration de radiotraceur (kBq/ml) dans la région

... puis estimation de paramètres physiologiques

Deux types de quantification


La quantification absolue

- mesure de la concentration de radiotraceur au sein d'un organe (kBq/ml) ou d'un paramètre dérivé de cette concentration
- mesure d'un volume



La quantité mesurée a une unité

métabolisme du glucose (cerveau de souris) ($\mu\text{mol}/100 \text{ g}/\text{min}$)

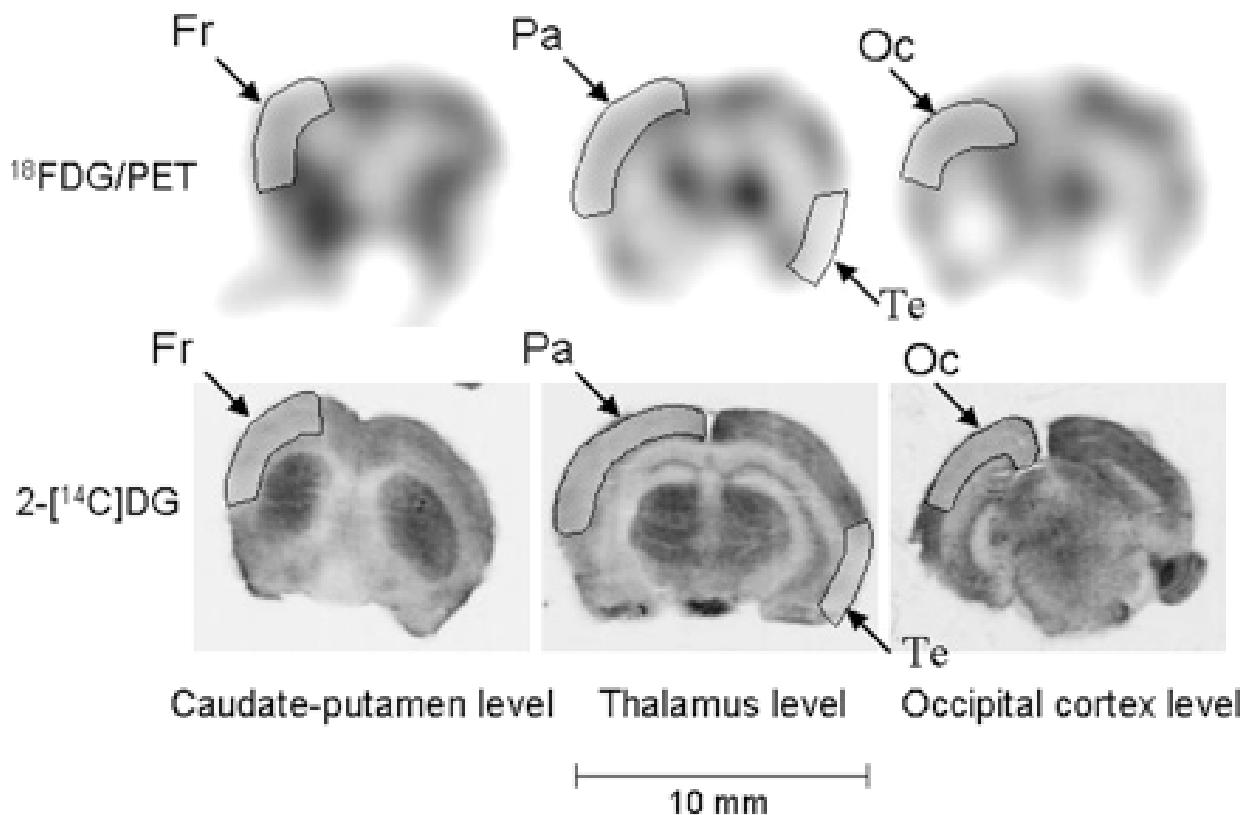


Toyama et al, J Nucl Med 2004


Quantification absolue



Requiert une calibration du système d'imagerie*

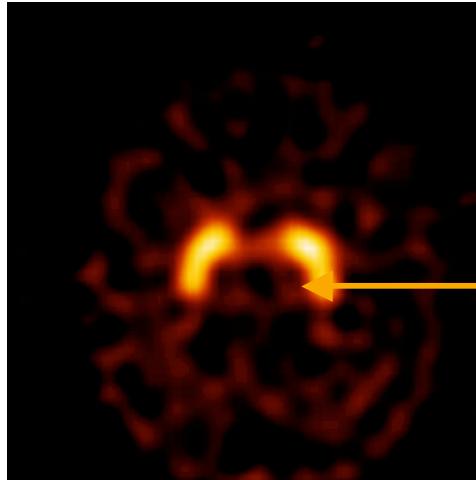

intensité N du signal dans
une région
(valeur des pixels)

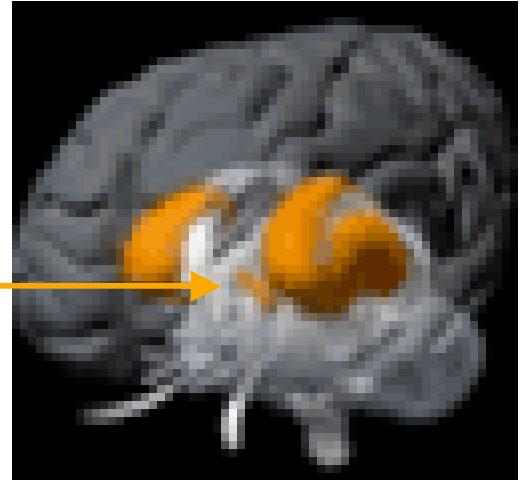

concentration C de radiotraceur
(kBq/ml) dans la région

1. S'assurer que $N = k C$

2. Déterminer k


*Non obligatoire dans le cas de l'estimation d'un volume

Quantification relative



- La quantification relative
 - rapport de concentration entre 2 régions (tumeur et tissus sains) ou entre deux instants


La quantité mesurée est sans dimension

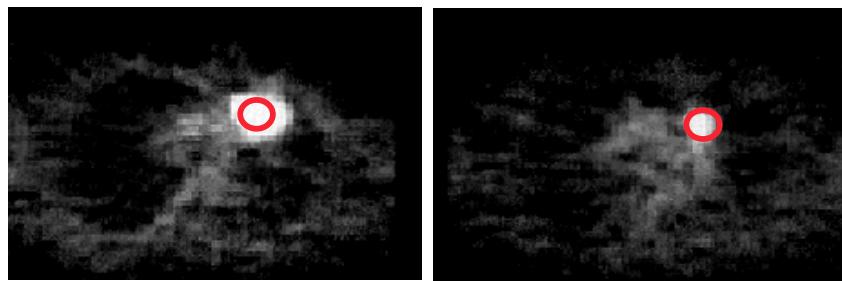

Jour J

Jour J + 3 mois

évolution de la fixation du traceur

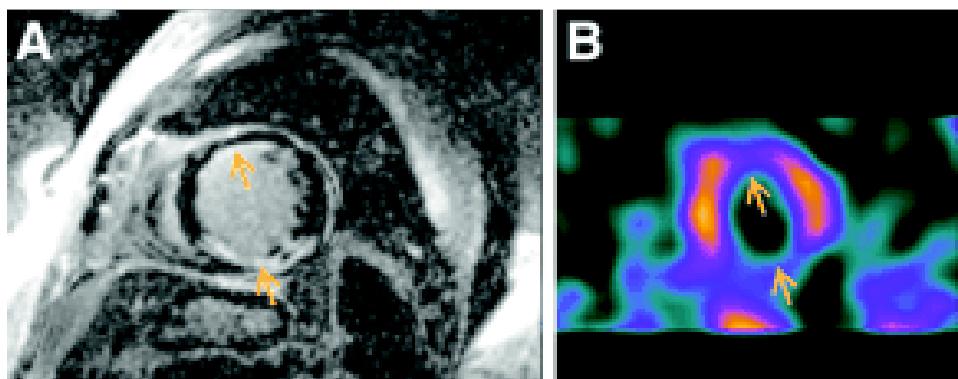


pourcentage du myocarde avec défaut

Slomka et al, J Nucl Med 2005

Quantification relative



Calibration du système d'imagerie plus simple

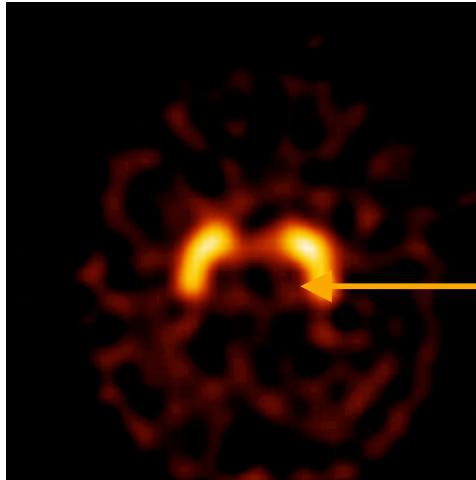

intensité N du signal dans
une région
(valeur des pixels)




concentration C de radiotraceur
(kBq/ml) dans la région

1. S'assurer que $N = k C$

2. Inutile de connaître k (mais s'assurer que k est constant dans le temps pour du suivi thérapeutique)


Introduction : pourquoi la quantification ?

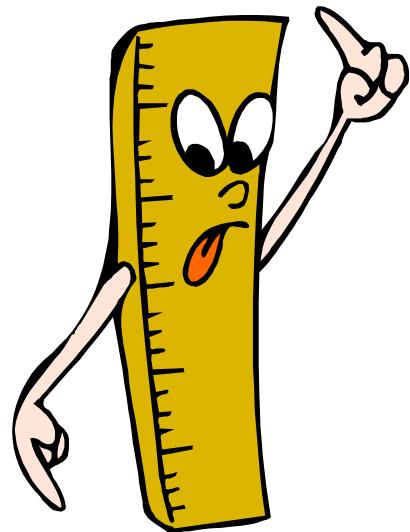

Caractérisation objective des observations, susceptible d'améliorer :


- Le diagnostic différentiel
- Le pronostic
- La prise en charge thérapeutique
- La radiothérapie
- Le suivi thérapeutique

Quantification et diagnostic différentiel

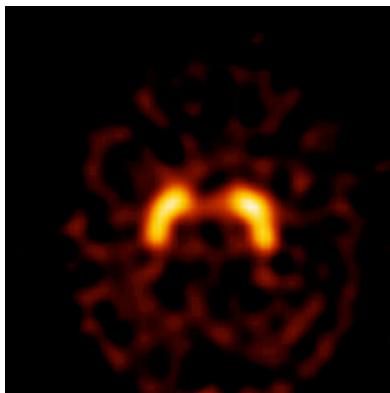


densité de transporteurs dopaminergiques
→ type de démence

e.g., Walker et al, Eur J Nucl Med 1997



Healthy volunteer

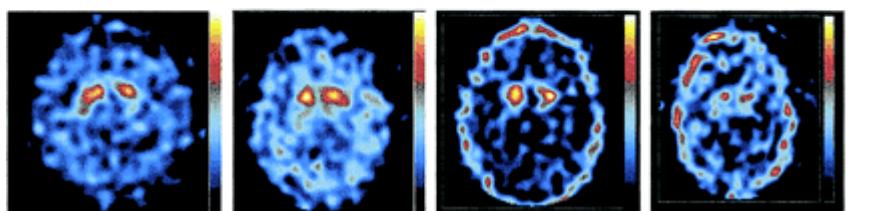


Hoehn and Yahr = 1

Hoehn and Yahr = 1.5

Hoehn and Yahr = 2

Hoehn and Yahr = 2.5

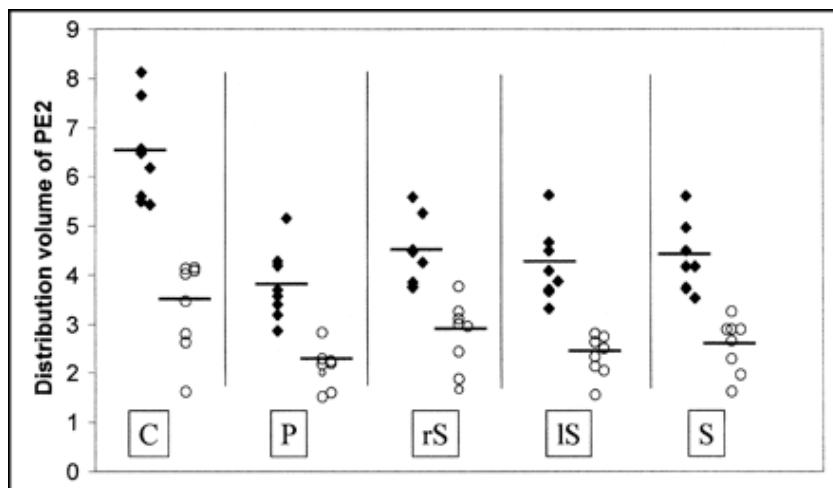

C : noyau caudé, P : pitamen, rS : striatum droit, IS : striatum gauche,
S : striatum


◆ volontaires sains, o patients atteints de la maladie de Parkinson

Prunier et al, J Nucl Med 2003


DESMN : Quantification en tomographie d'émission - Irène Buvat - février 2006 - 10

Quantification et diagnostic différentiel

Différenciation de lésions bénignes et malignes

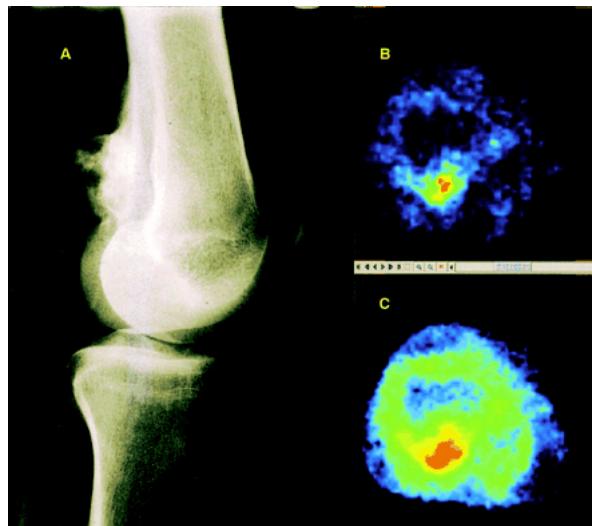

(A) Radiographic image of left knee (lateral view) shows irregular osteoblastic mass dorsal of femur. (B) Transversal PET image (SUV image) of distal femur shows enhanced 18F-FDG uptake confined to femoral part of mass. (C) Parametric image of fractal dimension of image in B. Increased fractal dimension (red area) is indicative of chaotic 18F-FDG metabolism. Note that area of chaotic metabolism is larger than 18F-FDG uptake region on SUV image (B). Histologic examination revealed osteosarcoma.


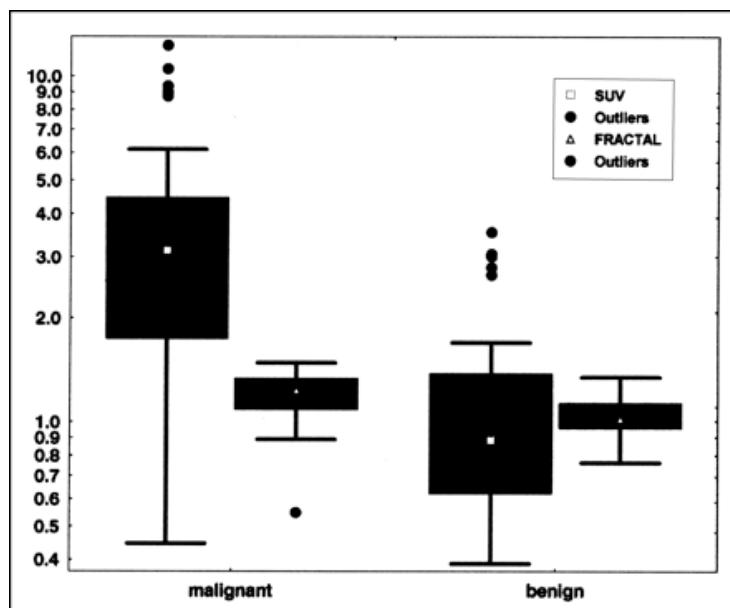


Box—whiskers plots of average 18F-FDG uptake (SUV) at 55–60 min and average of fractal dimension for all malignant ($n=37$) and all benign ($n=46$) lesions.

Dimitrakopoulou-Strauss et al J Nucl Med 2002


DESMN : Quantification en tomographie d'émission - Irène Buvat - février 2006 - 11

Quantification et pronostic

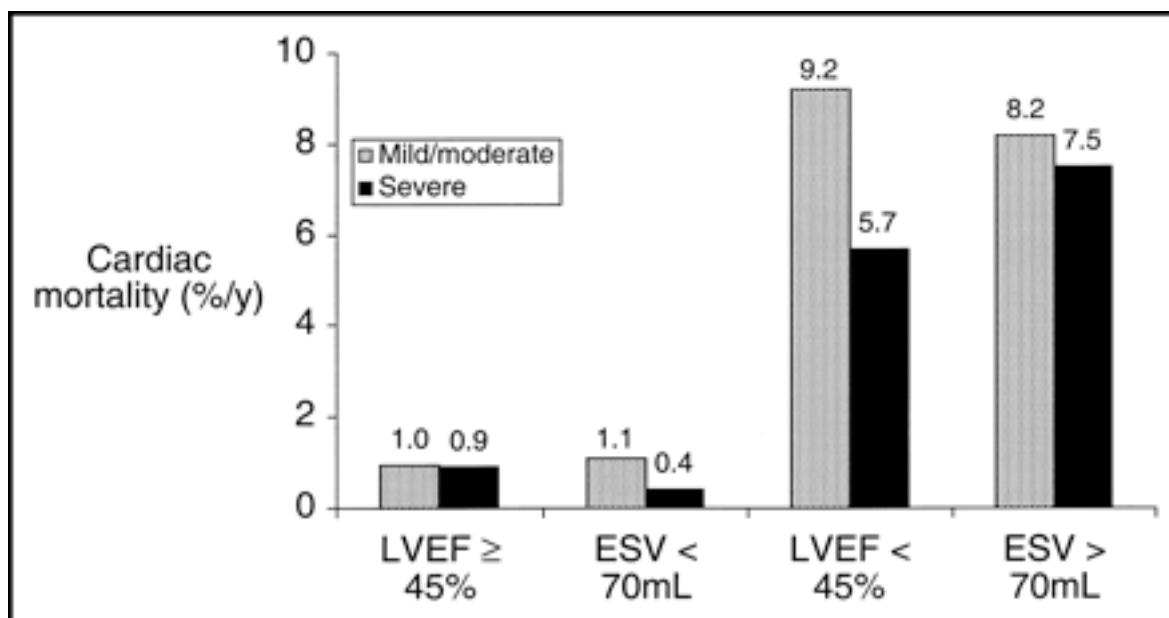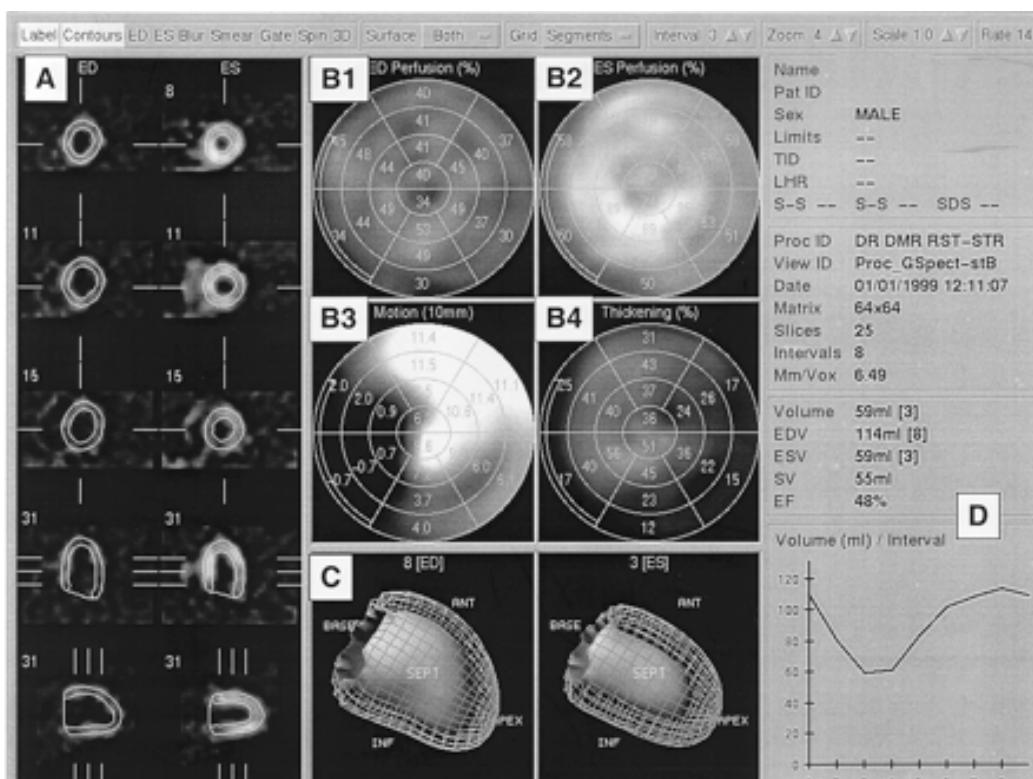


Annual cardiac death rates stratified by LV volume and EF. Patients with LVEF of 45% or end-systolic volume (ESV) of <70 mL have low mortality rate regardless of severity of perfusion defects. Similar findings are noted for patients with low EF ($<45\%$).

Quantification et pronostic

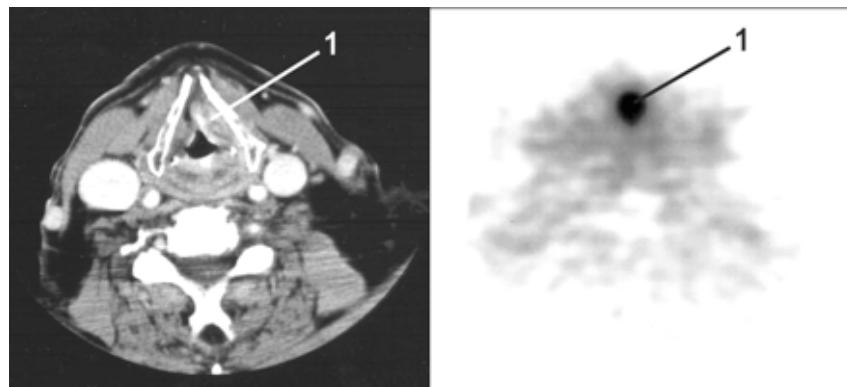

carboxyl-labeled amino acid L-[1-11C]-tyrosine (TYR)
Supraglottic squamous cell carcinoma

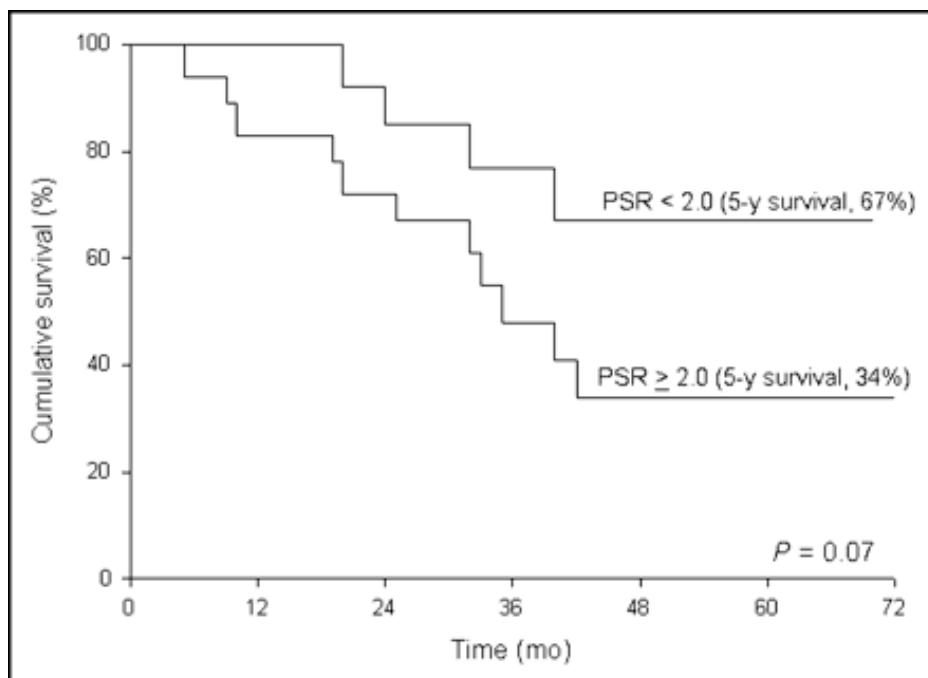


PSR: protein synthesis rate


Cumulative survival of patients with T1–T4 laryngeal carcinomas ($n = 34$). Differences between patients with tumor PSR equal to or higher than the median (2.0 nmol/mL/min) and patients with tumor PSR lower than the median are demonstrated ($P = 0.07$).

de Boer et al, JNM 2004

Quantification et prise en charge thérapeutique

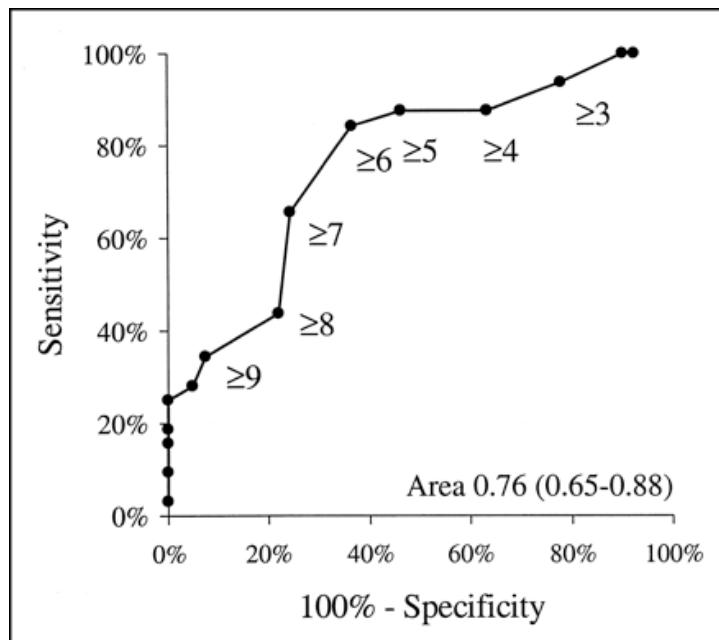



ROC curve analysis of **201Tl data** shows that cutoff value of 6 dysfunctional but viable segments yielded highest **sensitivity and specificity for predicting improved LVEF after revascularization.**

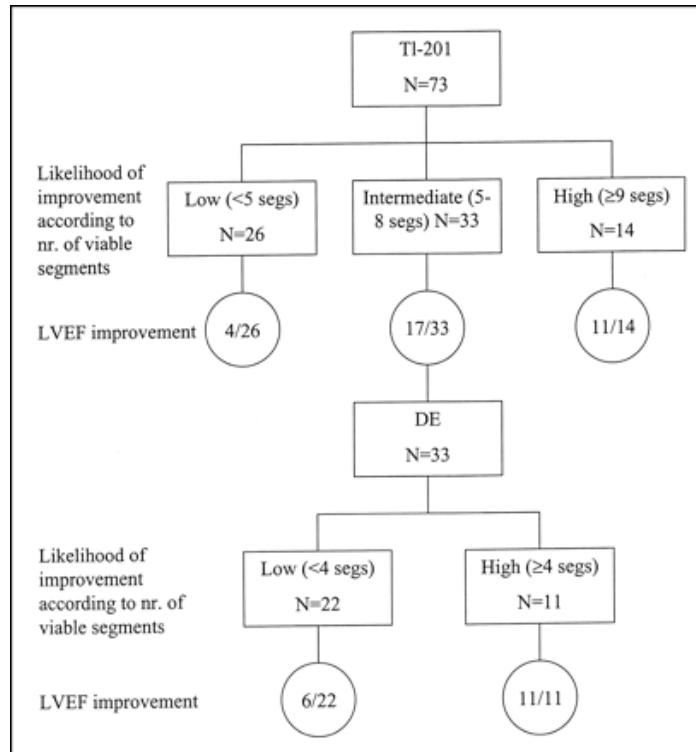

Bax et al, J
Nucl Med 2002

Flow chart of characterization (and outcome) of patients according to strategy 1 (201Tl was performed as initial test, and DE was performed as additional test on patients with intermediate likelihood of viability on 201Tl). nr. = number; segs = segments.

Quantification et suivi thérapeutique

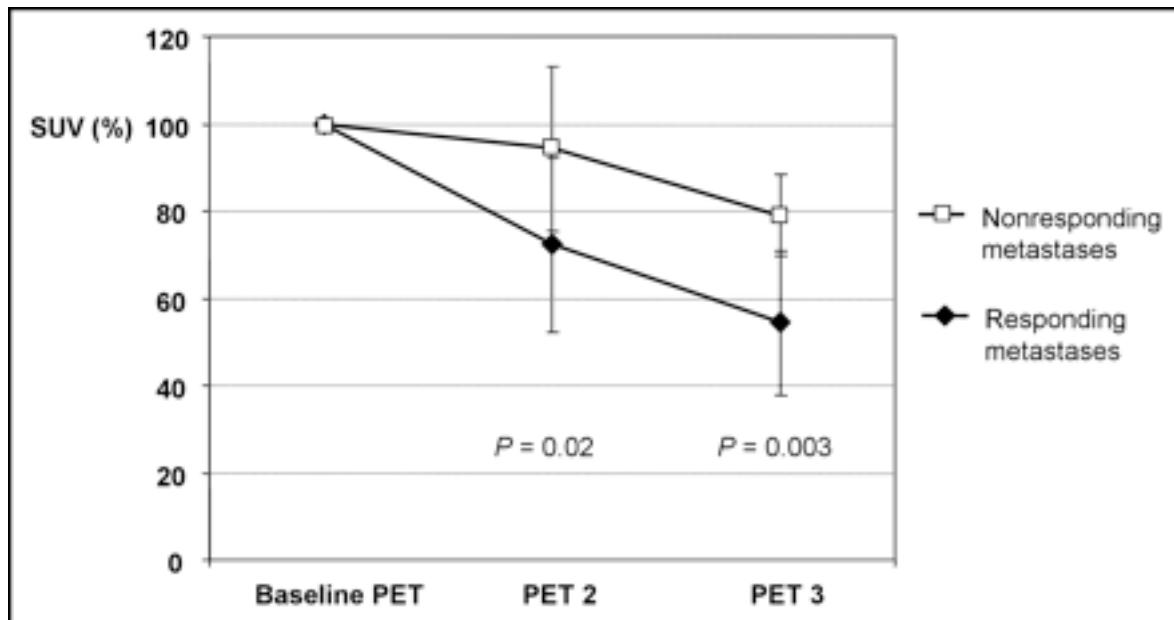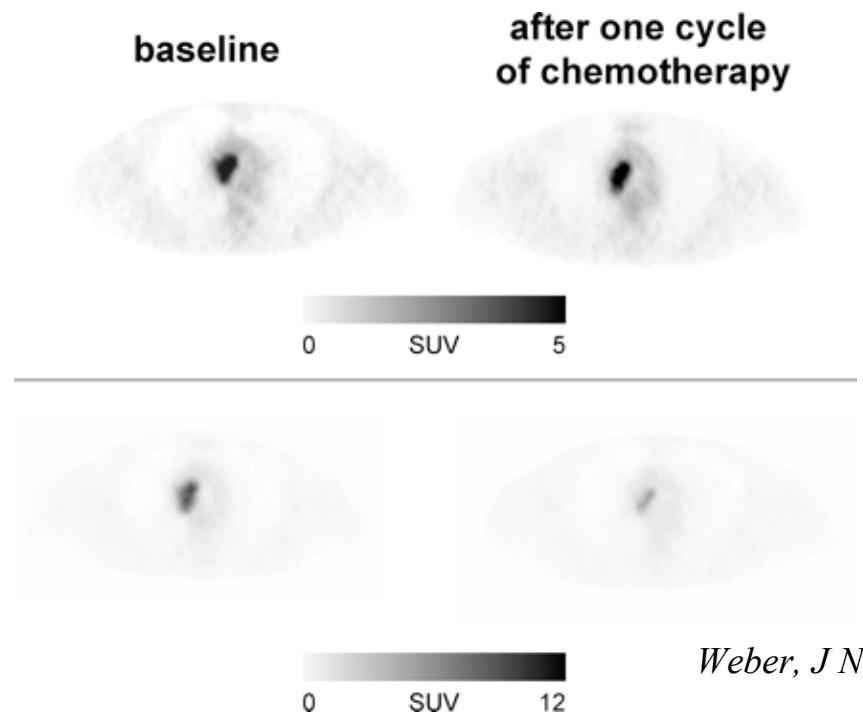


Schwartz et al J Nucl Med 2005

Quantification et radiothérapie

- Définition du GTV

Actuellement, uniquement à partir des images CT : volume « anatomique »

Le futur : irradiation à partir d'un volume « fonctionnel » ?

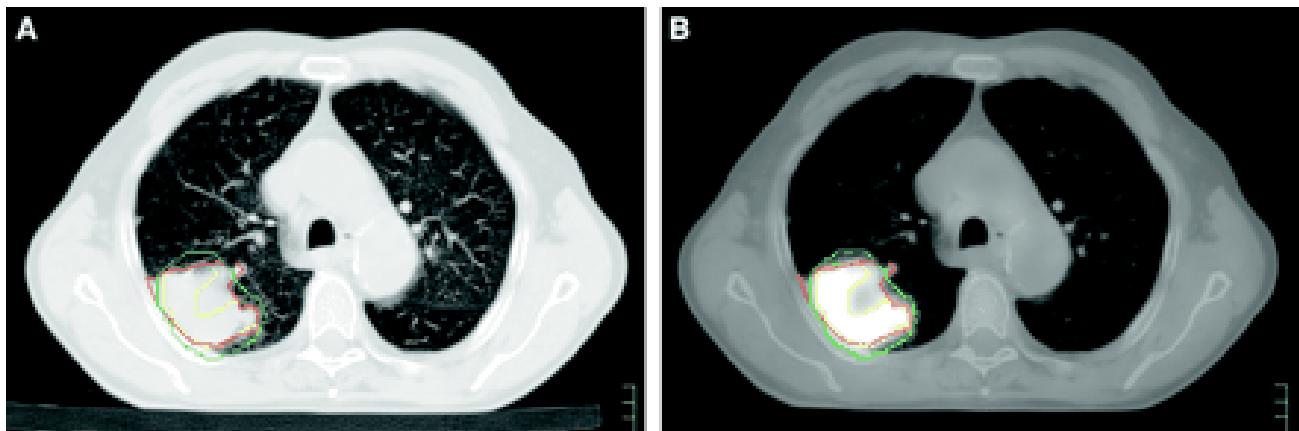

Jaune : volume défini à partir du PET en considérant tous les pixels de valeurs $> 40\% \text{ SUV}_{\text{max}}$


Vert : volume défini à partir du PET avec une approche empirique dérivée d'expériences sur fantômes maximisant la corrélation entre volume PET et volume CT

Rouge : volume défini à partir du CT seulement

e.g., Nestle et al, J Nucl Med 2005


DESMN : Quantification en tomographie d'émission - Irène Buvat - février 2006 - 16

Bilan

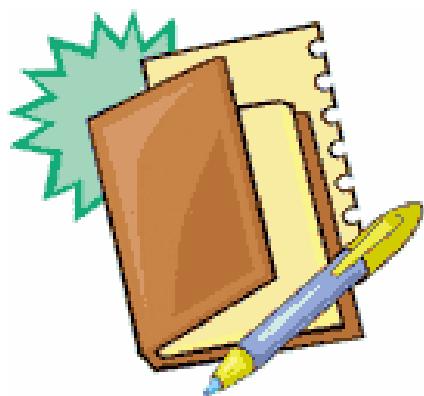

1. La quantification offre un fort potentiel pour une interprétation plus riche des images scintigraphique. Son intérêt est évident pour nombre d'applications
2. Une grande variété d'outils sont utilisés pour réaliser des études de quantification :
 - Boîtes à moustaches
 - Analyse ROC
 - etc

Le problème de la quantification

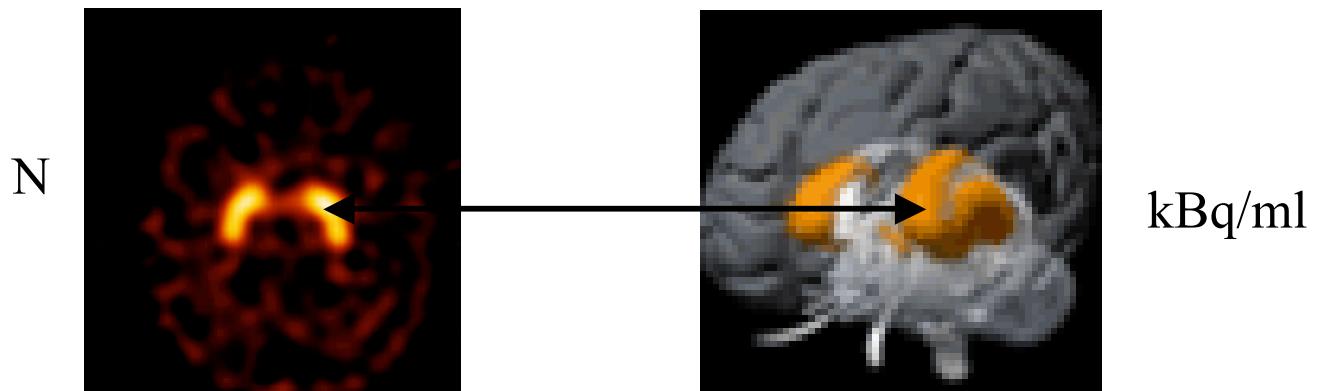

Etablir la relation entre la valeur d'un pixel et la concentration de radiotraceur dans la région correspondante :


$$N = k C$$

Sans de multiples précautions, N n'est pas proportionnel à C, et il n'y a pas de relation simple entre les 2 quantités



Pourquoi : multiples sources de biais

- ✓ mouvement
- ✓ émission aléatoire des photons
- ✓ diffusion Compton des photons
- ✓ atténuation des photons
- ✓ résolution spatiale limitée
- ✓ coïncidences aléatoires
- ✓ temps mort

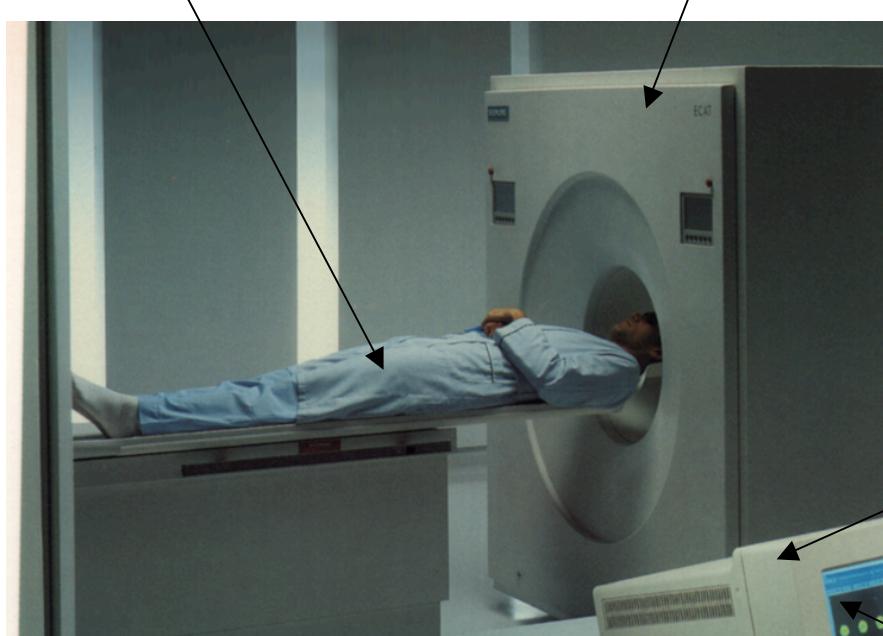

- ✓ reconstruction tomographique
- ✓ méthode de mesures



Obstacles à la quantification

- Obstacles intrinsèques

- interactions rayonnement matière en SPECT et PET
 - ⇒ atténuation
 - ⇒ diffusion Compton
- limites du dispositif d'imagerie
 - ⇒ résolution spatiale limitée et non stationnaire
 - ⇒ coïncidences fortuites en PET
 - ⇒ bruit de mesure
 - ⇒ reconstruction tomographique

- Obstacles potentiels


- mouvements du patient
 - ⇒ physiologiques : battements cardiaques, respiration
 - ⇒ fortuits car examens relativement longs
- défauts du détecteur
 - ⇒ uniformité
 - ⇒ temps mort
 - ⇒ stabilité mécanique

Pour chaque problème




- Comment il se pose en SPECT et en PET
- Les conséquences
- Les remèdes
- La qualité des méthodes de correction
- Synthèse

L'atténuation

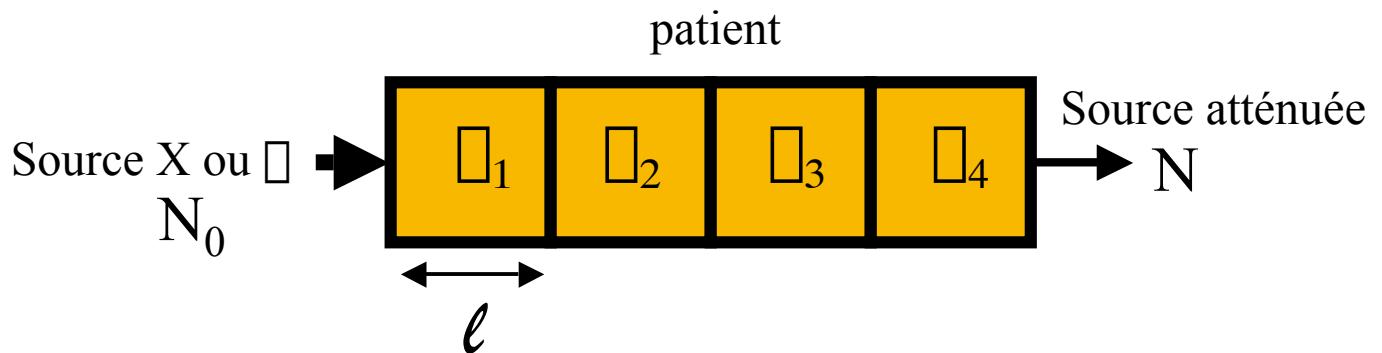

$$N = N_0 \exp[-(\square_1 + \square_2 + \square_3 + \square_4)] \ell$$


De même :

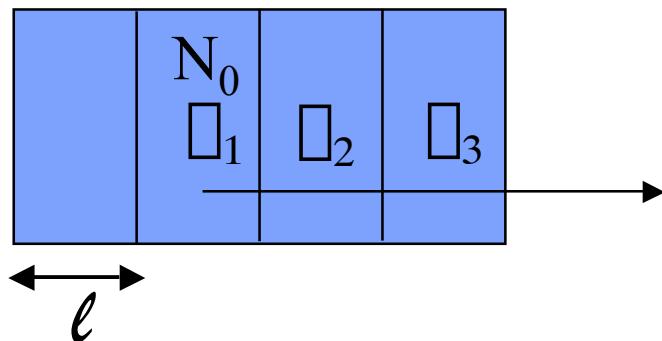

$$N = N_0 \exp[-(\square_1/2 + \square_2 + \square_3)] \ell$$

Conséquences de l'atténuation en TE

Coupe reconstruite à travers un cylindre uniforme

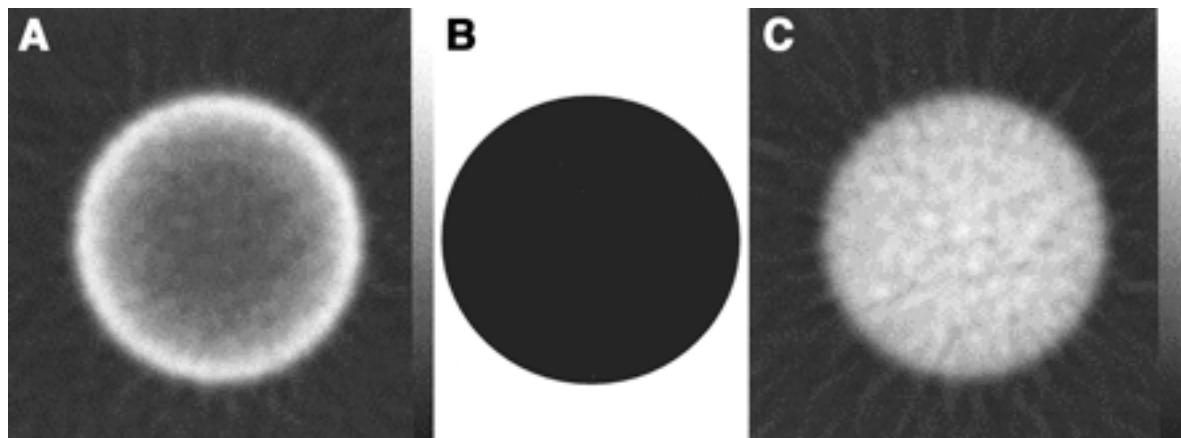

A : image affectée par l'atténuation

B : carte d'atténuation

C : image après correction de l'atténuation


Zaidi and Hasegawa J Nucl Med 2003

La valeur dans l'image n'est donc pas
proportionnelle à la concentration de
radiotraceur



Atténuation en SPECT

$$N = N_0 \exp \int_0^d \mu(l) dl$$

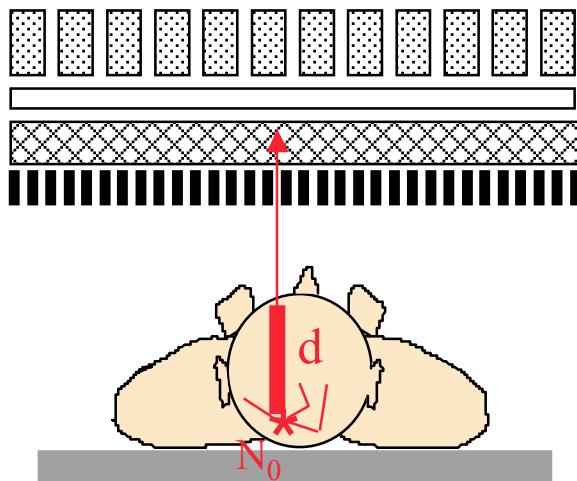


- Dépend du lieu d'émission sur la ligne de projection

Quand on détecte un événement, on ne sait pas de quelle profondeur il provient : on ne sait donc pas en quelle proportion il a été atténué

Atténuation en PET

$$N_1 = N_{\text{in}} \exp \int_0^{d_1} -\mu(l) dl \quad N_2 = N_{\text{in}} \exp \int_0^{d_2} -\mu(l) dl$$

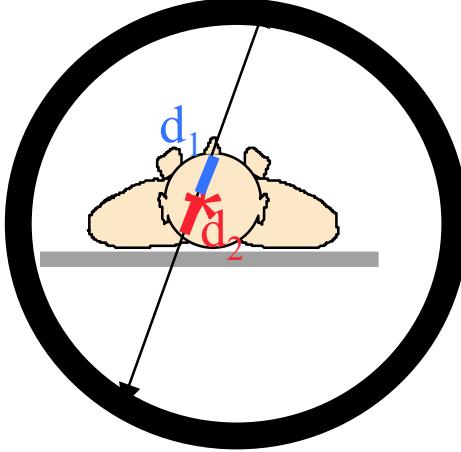

$$N_1 N_2 = N_{\text{in}}^2 \exp \int_{d_1}^{d_2} -\mu(l) dl = N_{\text{in}}^2 \exp \int_0^D -\mu(l) dl$$

- Ne dépend pas du lieu d'émission sur la ligne de projection
- Dépend uniquement de l'atténuation intégrale sur $d_1+d_2=D$

Quand on détecte un événement sur une ligne de réponse, on sait quelle atténuation il a subi. On pourra donc plus facilement compenser de l'atténuation qu'en SPECT



Autres facteurs affectant l'atténuation

- L'atténuation dépend de la densité du milieu atténuant




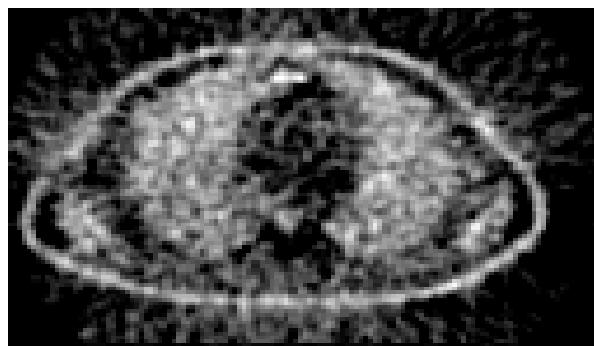


Image PET FDG non corrigée de l'atténuation : il semble y avoir plus d'activité dans les poumons que dans les tissus mous car les poumons n'atténuent quasiment pas par opposition aux tissus mous.

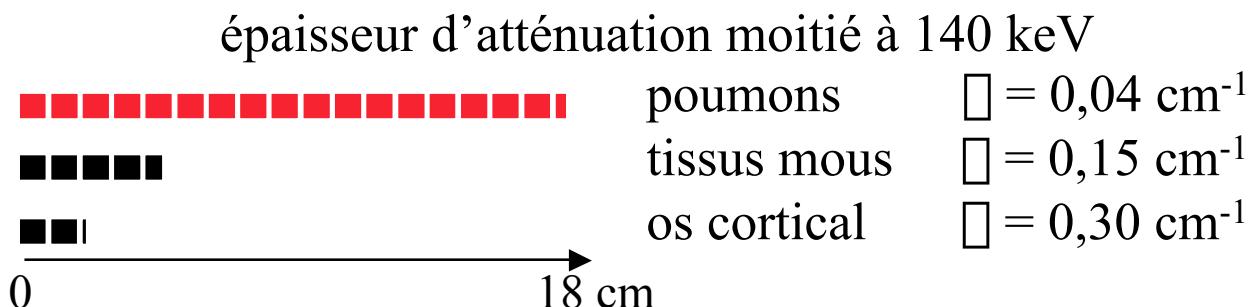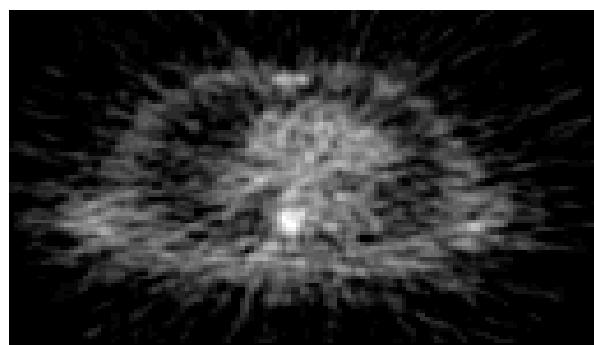

Autres facteurs affectant l'atténuation

- L'atténuation dépend de l'énergie des photons ☐

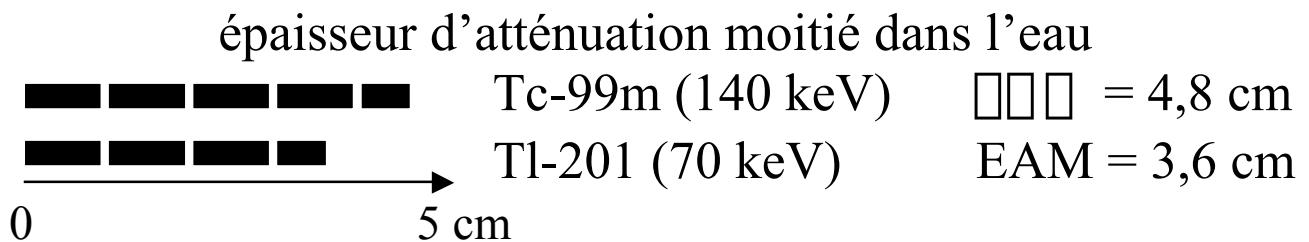

Pour des traceurs présentant à peu près la même sensibilité et spécificité de fixation à la cible, le traceur marqué au Tl-201 donnera des images de moins bonnes qualités car elles seront plus atténuées

- Identique pour tous les émetteurs de positons puisque tous donnent lieu à des photons ☐ de 511 keV

A 511 keV, $\square = 0,096 \text{ cm}^{-1}$ dans les tissus mous
(rappel : $\square = 0,15 \text{ cm}^{-1}$ à 140 keV)

Quel que soit le marqueur PET (F18, C11, O15, etc), les images seront affectées de façon identique par l'atténuation



Conséquences de l'atténuation (1)


- Perte d'un grand nombre de photons
⇒ diminution du rapport signal-sur-bruit



e.g. :

- en SPECT thoracique, ~10% des photons émis au niveau du cœur sortent du patient
- en PET cérébral, nombre d'événements détectés divisé par ~5
- en PET cardiaque, nombre d'événements détectés divisé par ~10 à 20


La qualité des images est considérablement diminuée du fait de l'atténuation : les images obtenues chez les patients minces sont de meilleures qualités que les images obtenues chez les patients obèses

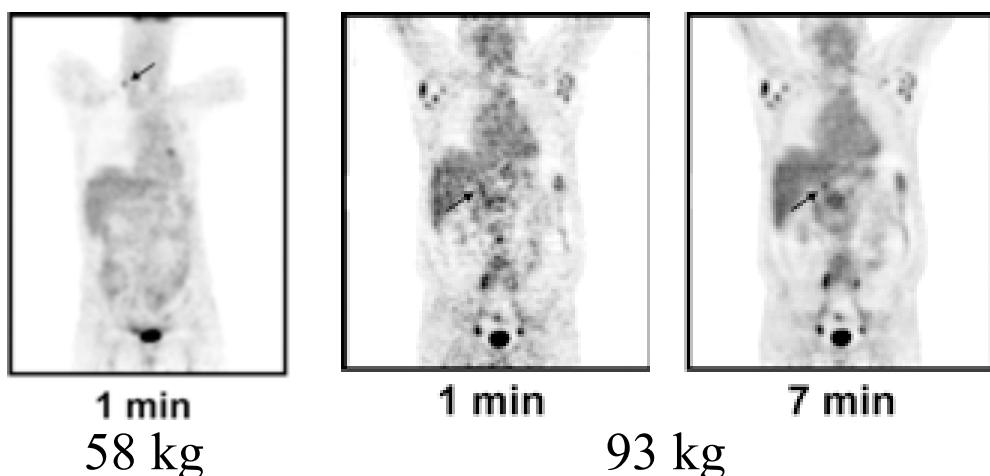

Halpern et al J Nucl Med 2004
Halpern et al J Nucl Med 2005

Conséquences de l'atténuation (2)

- Quantification erronée

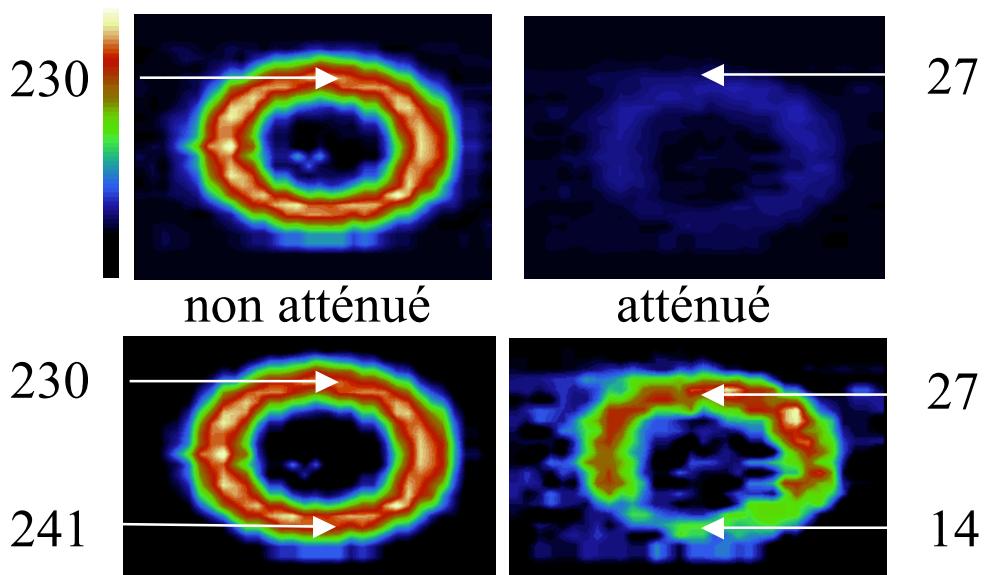


En PET comme en SPECT, l'atténuation entraîne des sous-estimations d'activités généralement supérieures à 70%




Conséquences de l'atténuation (3)

- L'atténuation étant inégale selon la profondeur, elle modifie également considérablement la qualité des images
 - ⇒ nuisible à la détection de lésions profondes
 - ⇒ artefacts de la paroi inférieure en imagerie cardiaque

PET FDG

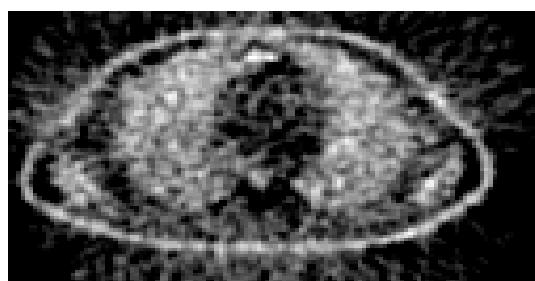


sans correction
d'atténuation

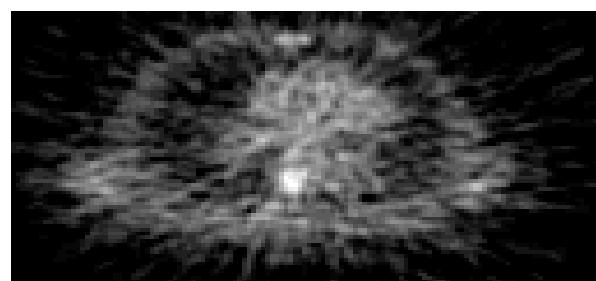


avec correction
d'atténuation

Tl-201 SPECT

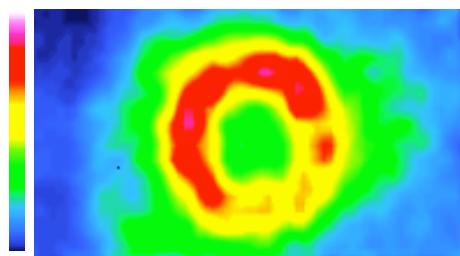


sans correction
d'atténuation

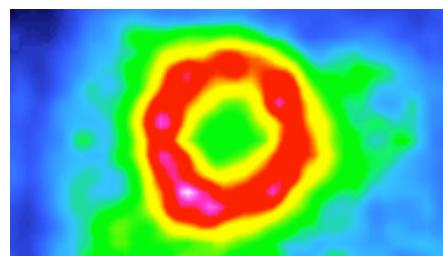


avec correction
d'atténuation

Correction d'atténuation : stratégie - étape 1

- L'atténuation dépend de la densité du milieu atténuant
- Préalable à toute correction d'atténuation : disposer d'une cartographie de la densité du milieu atténuant (valeurs de μ)
- 2 possibilités :
 - utiliser un dispositif de transmission équipant la gamma caméra ou le tomographe PET

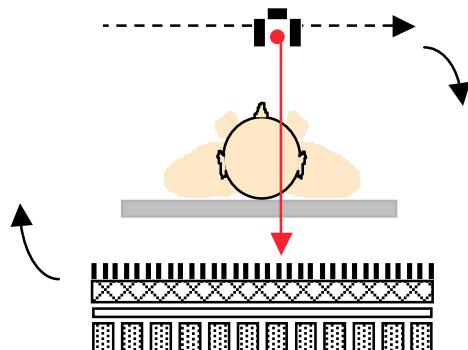


- utiliser la tomodensitométrie sur les systèmes SPECT/CT ou PET/CT

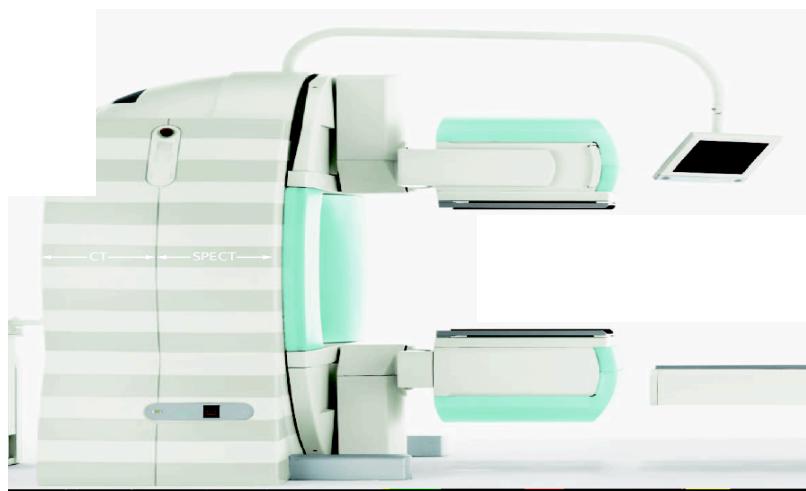

Dispositifs d'acquisition en transmission


- SPECT

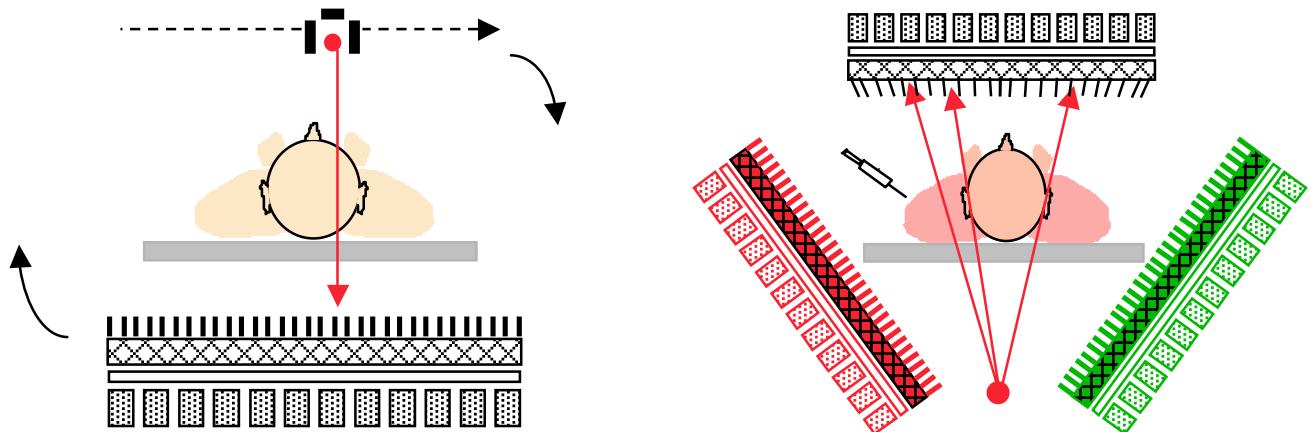

Sources utilisées :

- Tc-99m (140 keV, T = 6h, source remplissable)
- Gd-153 (100 keV, T=242 jours)

- PET

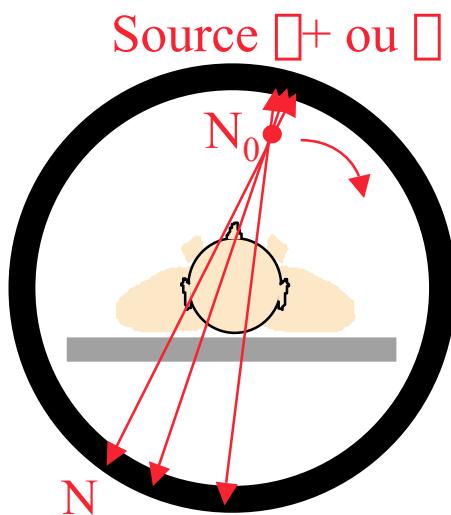

Sources utilisées :


- Ge-68 (511 keV, T = 271 jours)
- Cs-137 (662 keV, T=30,2 ans)

Machines hybrides

- SPECT/CT




- PET/CT

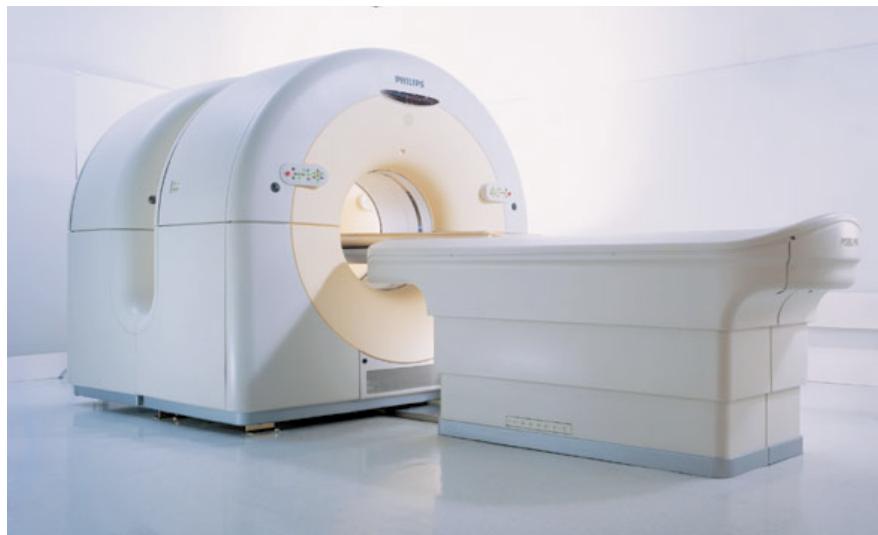

cartographie des coefficients d'atténuation μ dérivée du CT
 $HU = 1000 * (\mu_{tissue} - \mu_{eau}) / \mu_{eau}$

Avantages

- Acquisition en transmission très rapide : ne rallonge pas substantiellement la durée des examens
- Données anatomiques utiles pour la localisation des anomalies fonctionnelle
- Haute résolution spatiale
- Données très peu bruitées
- Examens en émission et en transmission en quasi-correspondance spatiale

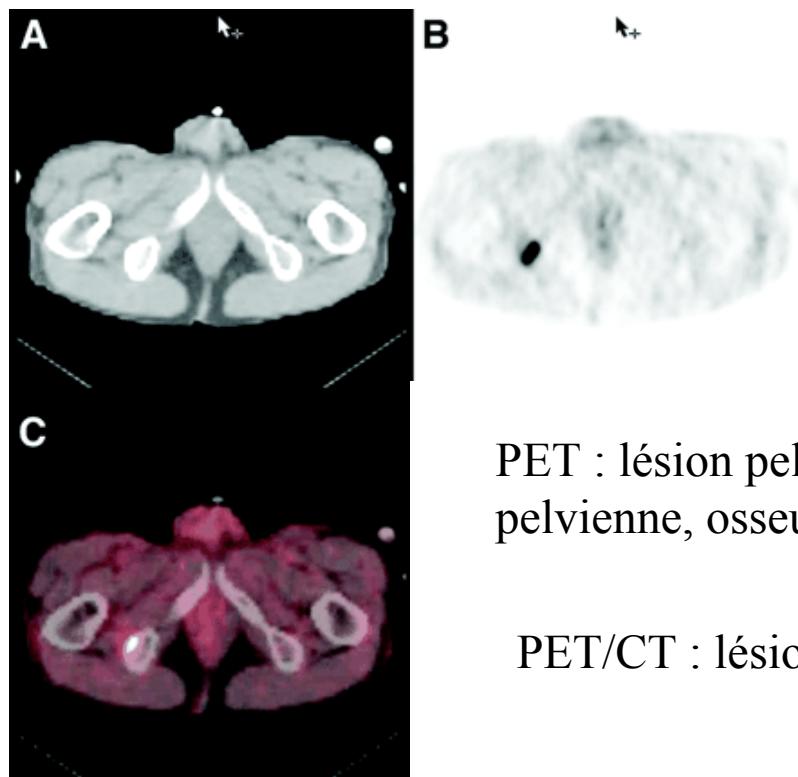


PET : lésion pelvienne, extra pelvienne, osseuse, ganglion ?

PET/CT : lésion os pelvien

Walh J Nucl Med 2004


Inconvénients

- Problème du flou respiratoire :

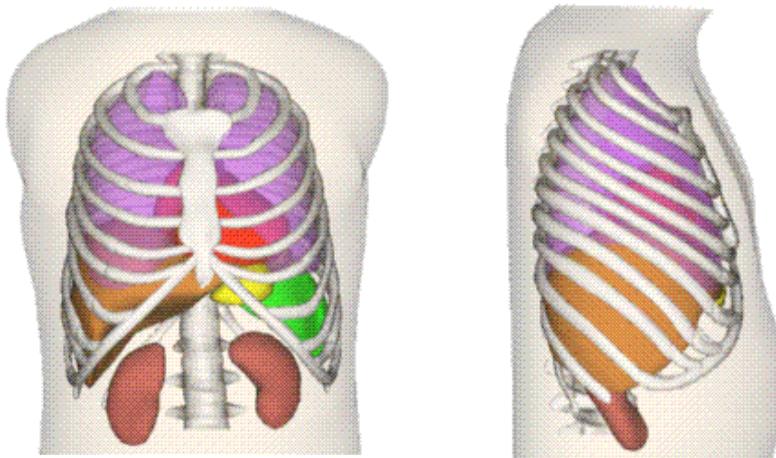

- CT acquis « instantanément » : pas de flou respiratoire : les images correspondent à une position fixe des organes (notamment les poumons) pendant le cycle respiratoire (ou inspiration forcée ou expiration forcée)
 - SPECT ou PET acquis sur une longue durée : les images correspondent à la position moyenne des organes pendant le cycle respiratoire
 - Les frontières des organes ne sont pas superposables : artefacts potentiels aux interfaces entre milieux de densités très différentes (poumons / tissus mous par exemple).
-
- Problème de la dose reçue par le patient

Exemple

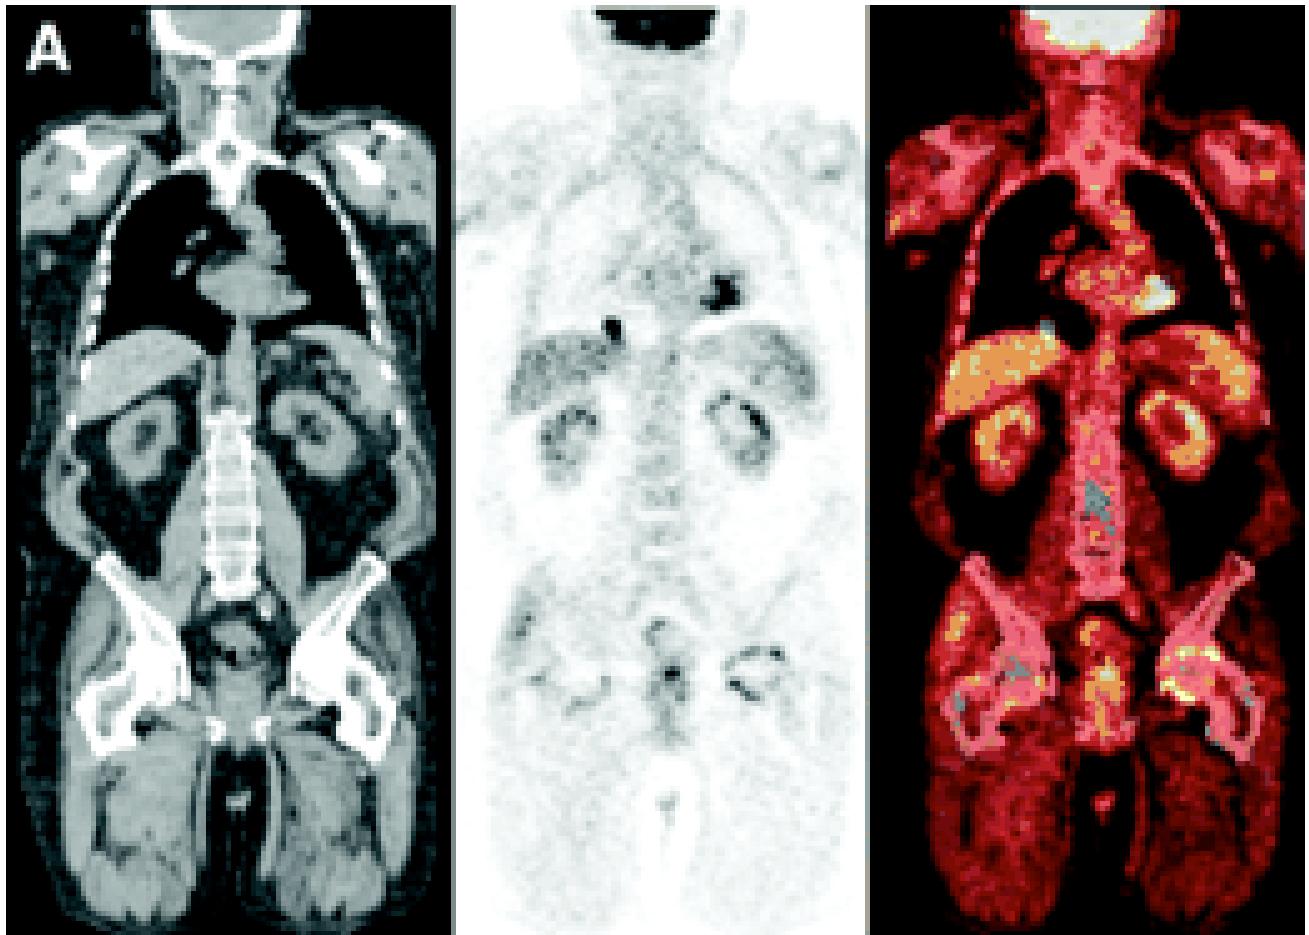

Expiration profonde pendant le CT

PET : lésion dans le poumon droit, alors que la lésion était une lésion hépatique (confirmée par l'IRM)

Walk J Nucl Med 2004

Correction d'atténuation : stratégie - étape 2

- Mettre à l'échelle les cartographies des μ


Les cartographies de transmission sont généralement mesurées à une énergie différente de l'énergie du radiotraceur utilisé

e.g., mesure au Tc-99m pour des examens cardiaques au Tl-201

mesure CT (~ 70 keV) pour des examens PET

$$\mu_{E2}(\text{milieu } i) = \mu_{E1}(\text{milieu } i) \cdot [\mu_{E2}(\text{eau}) / \mu_{E1}(\text{eau})]$$


SPECT

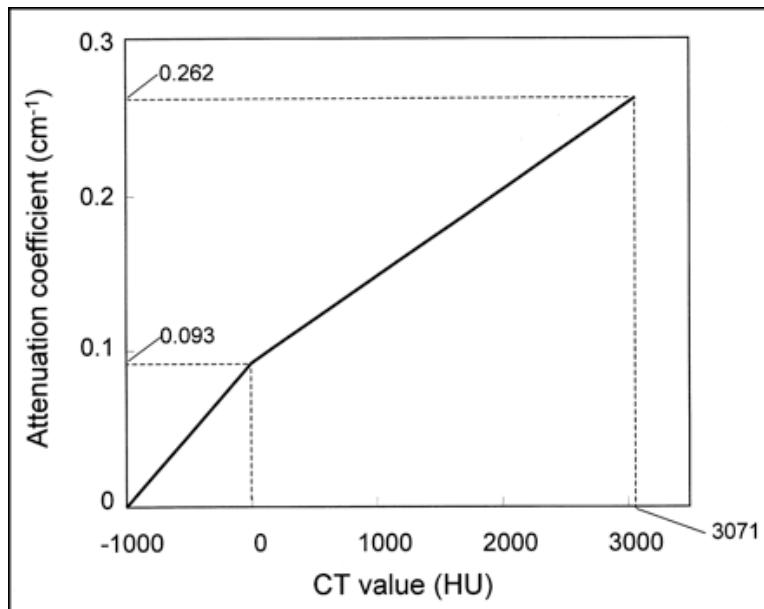

PET

Correction d'atténuation : stratégie - étape 2

Attention, l'interpolation bilinéaire n'est pas valable en présence de produit de contraste oraux en CT :
Nécessité de distinguer d'abord les zones contenant le produit de contraste iodé des régions osseuses, pour leur affecter le coefficient d'atténuation de l'eau

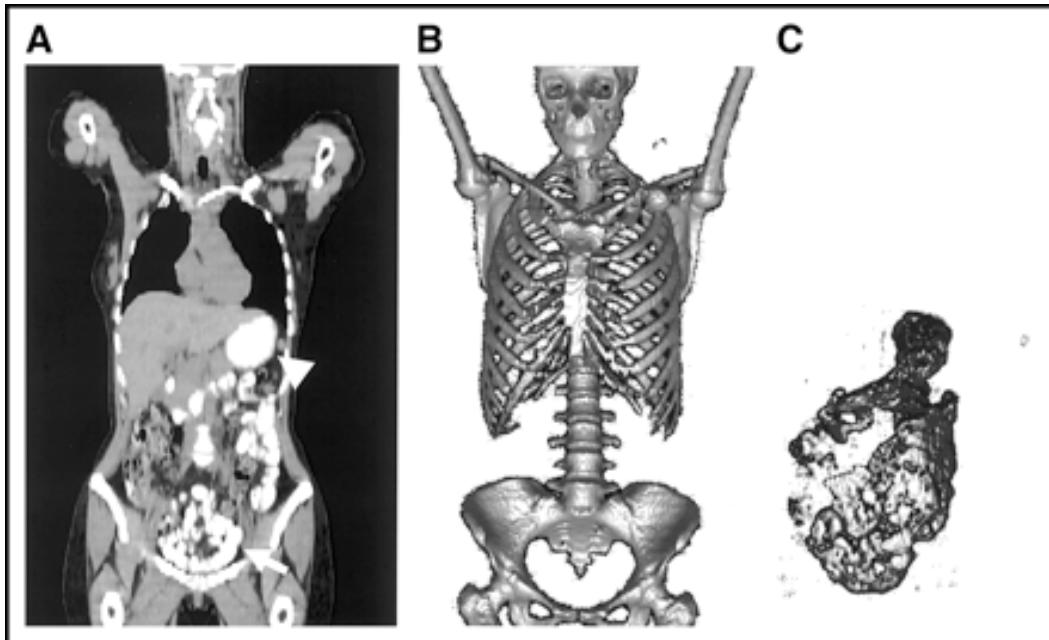

Townsend et al J Nucl Med 2004



Correction d'atténuation : stratégie - étape 3




- Corriger de l'atténuation, étant données les données mesurées et la cartographie des valeurs de μ

4 approches possibles :


- Avant la reconstruction tomographique (pré-correction)
- Après la reconstruction tomographique (post-correction)
- Itération d'une pré ou post-correction
- Pendant la reconstruction tomographique

Correction avant reconstruction en SPECT

- Multiplication des valeurs dans les projections (ou sinogrammes) acquises par des facteurs de correction approximatifs $C(i,\theta)$

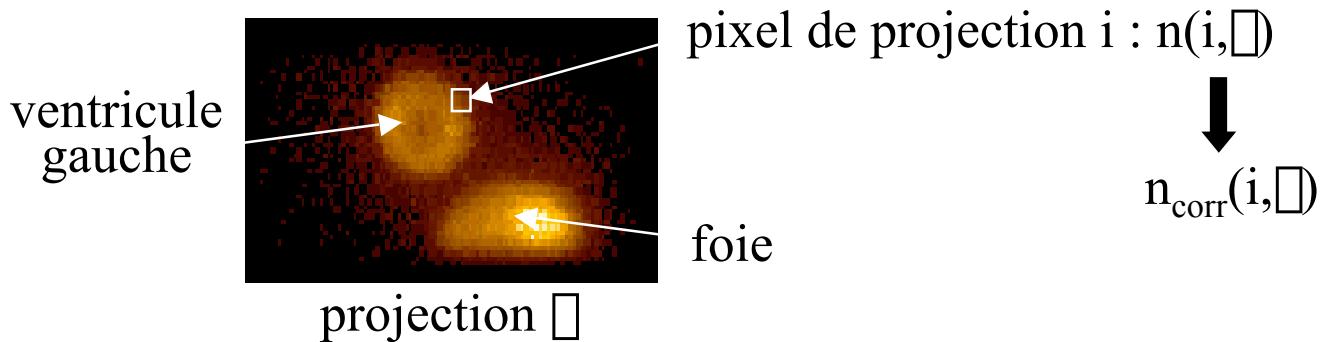

- Exemple : moyenne géométrique
 - Hypothèse d'atténuation uniforme

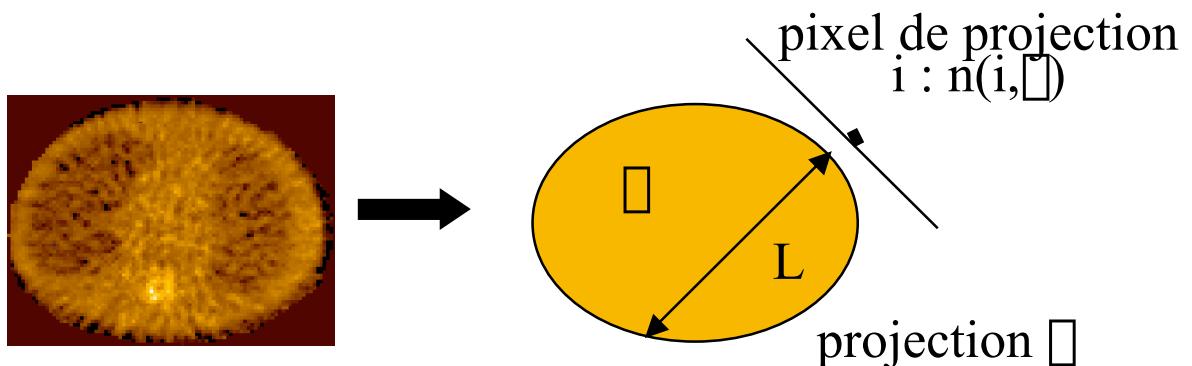


- Moyenne géométrique des projections opposées
$$n_{corr}(i,\theta) = [n(i,\theta) \cdot n(i,\theta + 180^\circ)]^{1/2} \cdot C(i,\theta)$$
avec $C(i,\theta) = \exp(\theta L / 2)$

- Exact pour une source ponctuelle dans un milieu uniforme
- Approximatif seulement dans le cas général

Correction avant reconstruction en PET


- Calcul des coefficients de correction d'atténuation à partir des mesures en transmission

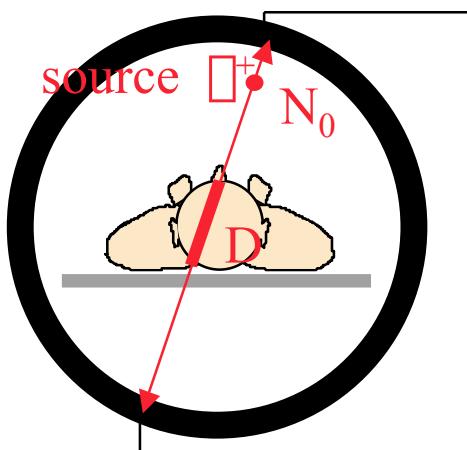

N coïncidences détectées pour cette raie de projection

$$\frac{N_0}{N} = \exp \int_0^D \mu(l) dl$$

Mesure affectée par l'atténuation :

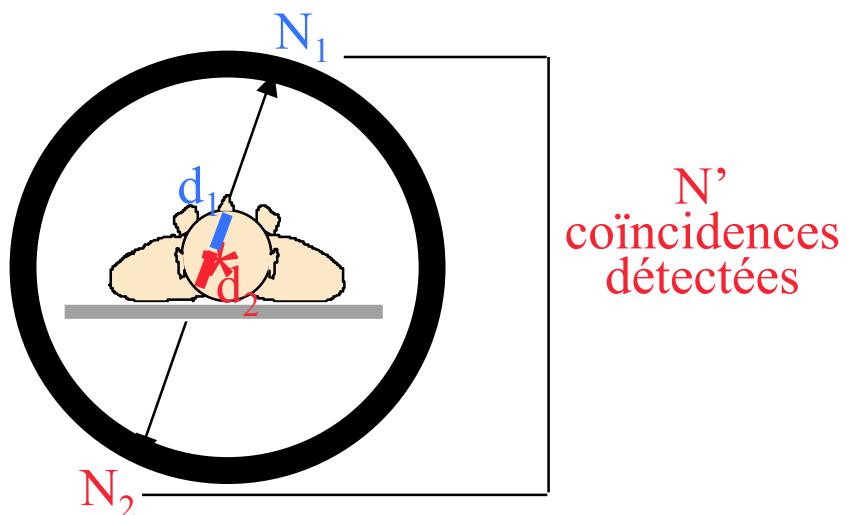

$$N' \mu N_1 N_2 = N_{\text{eff}}^2 \exp \int_{d_1}^{d_2} \mu(l) dl = N_{\text{eff}}^2 \exp \int_0^D \mu(l) dl$$


⇒ Correction

$$N'_{\text{corr}} = N' \cdot N_0 / N \mu N_{\text{eff}}^2 \quad \leftarrow \text{mesure non affectée par l'atténuation}$$


⇒ Reconstruction tomographique des projections corrigées
Correction théoriquement exacte

Correction après reconstruction (SPECT slmt)

- Multiplication des images reconstruites par des facteurs de correction approximatifs $C(x,y)$

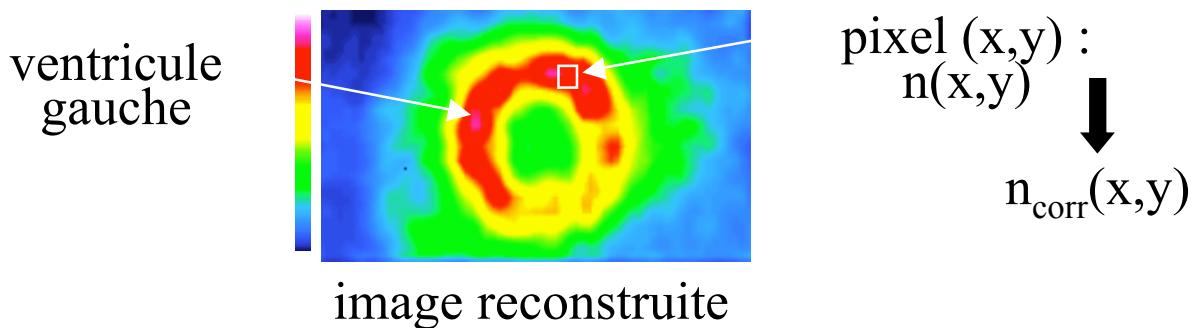

- Exemple : correction de Chang

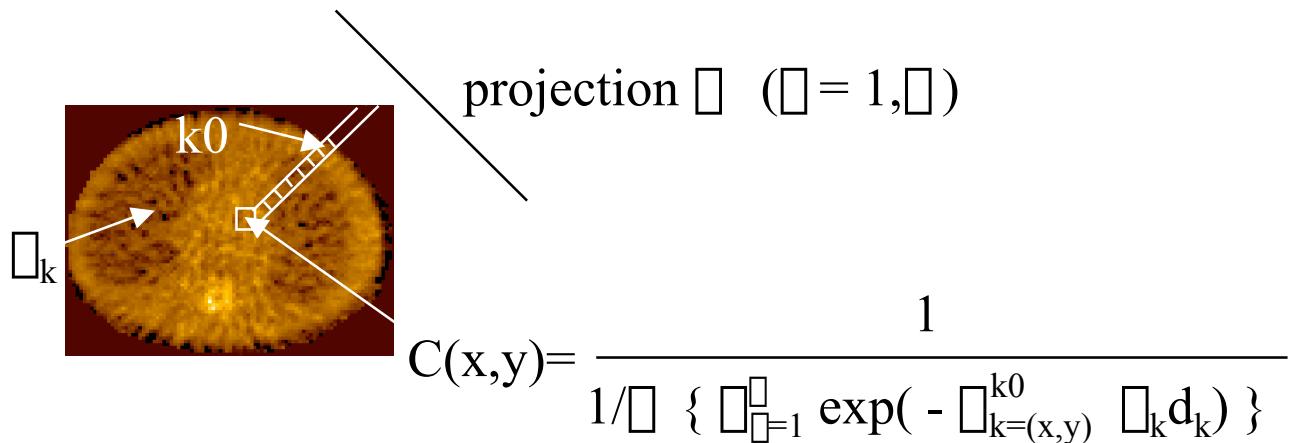


$$n_{corr}(x,y) = n(x,y) \cdot C(x,y)$$

- Exact pour une source ponctuelle
- Approximatif seulement dans le cas général

Itération d'une pré ou post correction en SPECT

- Répétition itérative d'une pré ou post correction
objet estimé

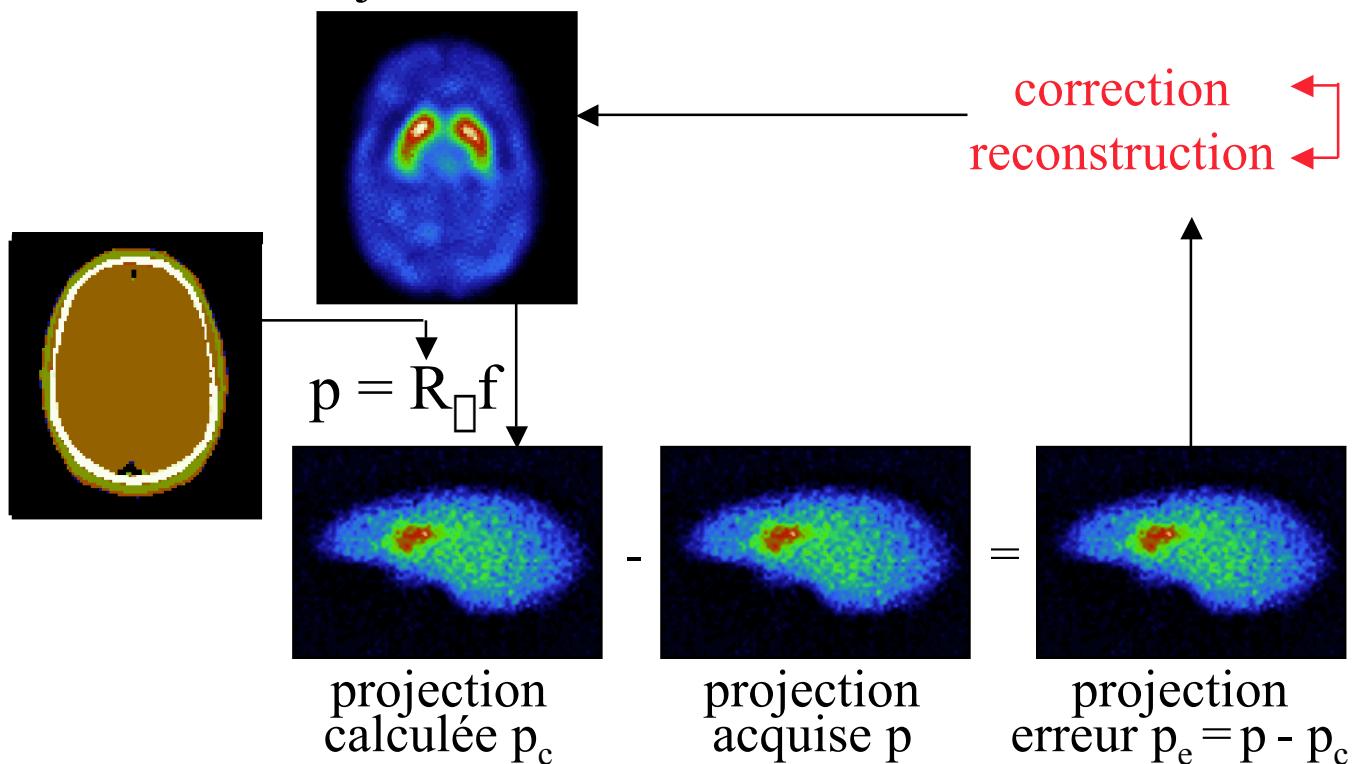



- Exemple : correction de Chang itérative

$$f^n = f^{n-1} + C(x,y) \cdot \text{rétroprojection filtrée } (p_e)$$

- Fonctionne avec n’importe quel algorithme de reconstruction (pas nécessairement itératif)
- Rapide : 2 à 5 itérations
- Plus exacte que les approches non itératives
- Convergence non démontrée et amplification rapide du bruit

Correction d'atténuation pendant la reconstruction


- Reconstruction itérative avec modélisation de l'atténuation dans le projecteur

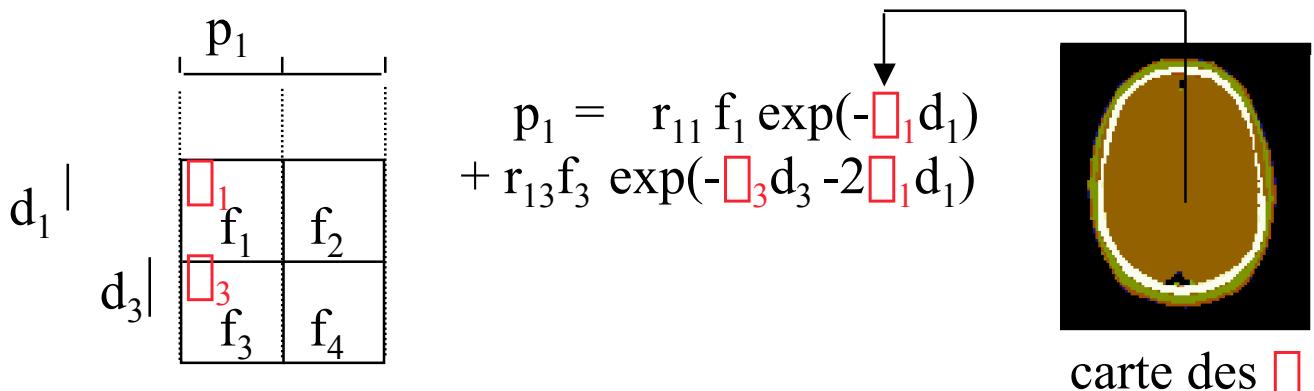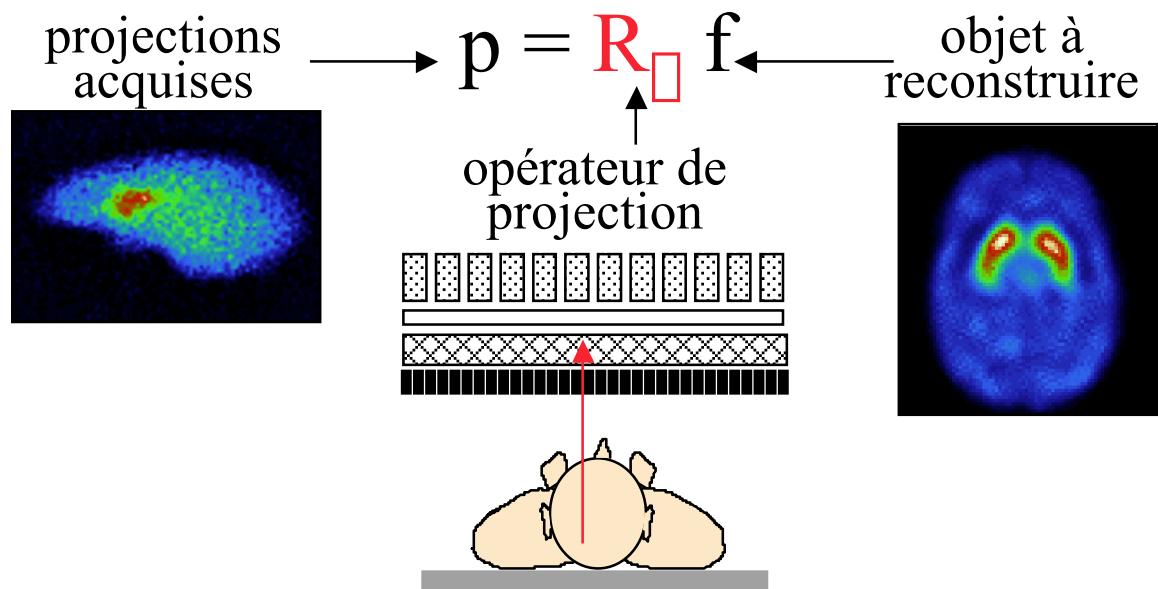


- Adapté à tous les algorithmes de reconstruction itérative : ML-EM, OSEM, etc
- Approche générale, adapté au PET et au SPECT

Correction d'atténuation : problèmes pratiques


- Mouvement possible du patient entre les examens émission et transmission

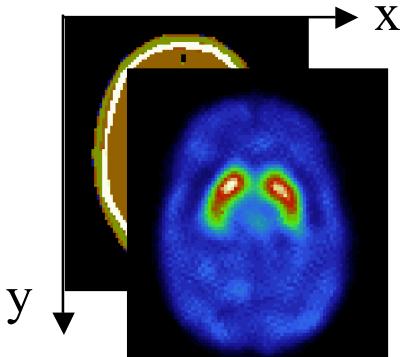

- ⇒ en SPECT cardiaque, décalage de 3 cm
 - variabilités d'intensité mesurées allant jusqu'à 40%
- ⇒ en SPECT cérébral, décalage de 2 cm induit des asymétries de fixation et des variabilités d'intensité allant jusqu'à 20 %




$tx = 0 \text{ cm}$
 $ty = 0 \text{ cm}$



$tx = 2,2 \text{ cm}$
 $ty = 0 \text{ cm}$

- Solutions potentielles
 - ⇒ recalage des images émission et transmission
 - ⇒ acquisitions émission/transmission simultanées (avec traitement des problèmes d'interférence)


Problèmes de mise en correspondance

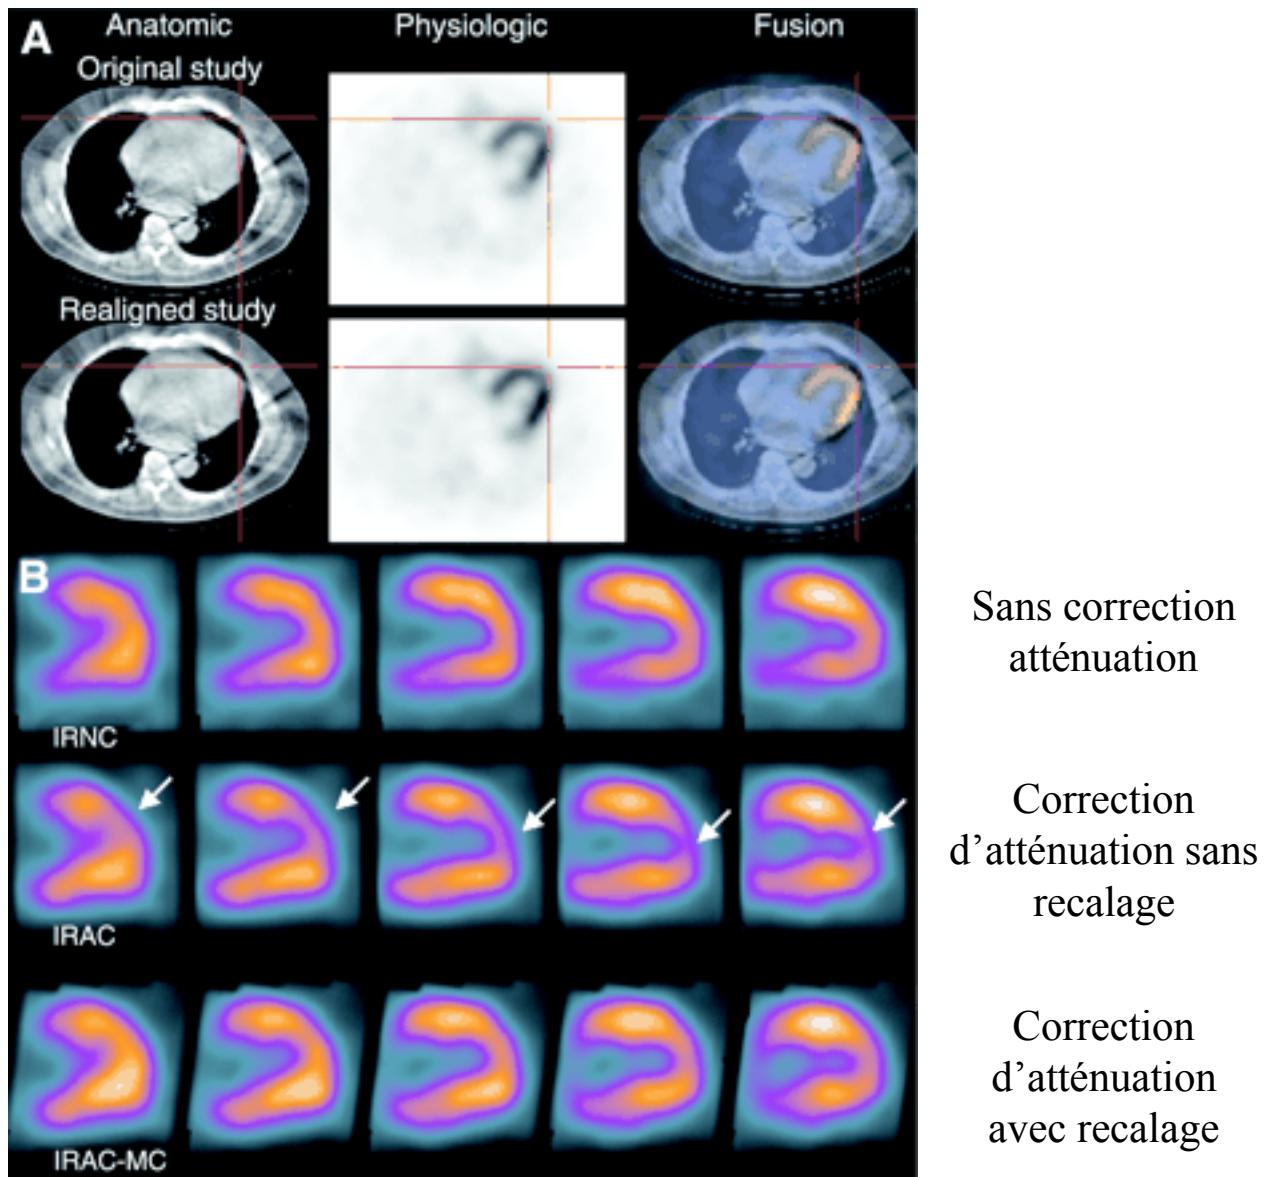

Fricke et al J Nucl Med 2004

Correction d'atténuation : problèmes pratiques

- Bruit dans les cartes des μ

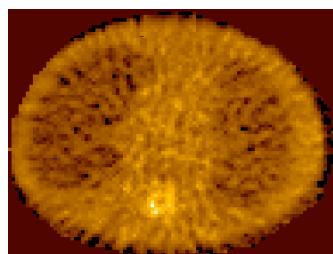

⇒ propagation du bruit lors de la correction d'atténuation



FBP+MAC 8-mm gaussian

Sans traitement du bruit



FBP+SAC 8-mm gaussian


$L = 2.27, T = 13.74$

Schöder et al J Nucl Med 2004

Avec traitement du bruit

Solutions au problème du bruit

- Filtrage des cartes des μ
 - ⇒ non concordance de résolution spatiale entre données de transmission et d'émission à l'origine d'artefacts aux interfaces (e.g., poumons / tissus mous)
- Segmentation des cartes des μ et affectation de valeurs de μ a priori dans les différentes régions (os, tissus mous, poumons)

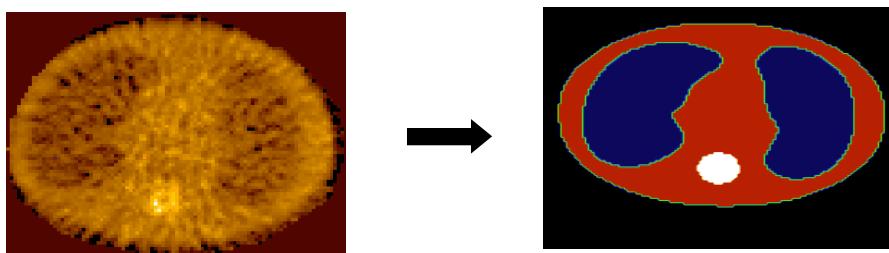


- ⇒ segmentation des différents tissus
- ⇒ hypothèse abusive de valeur de μ uniforme dans chaque tissu
- ⇒ choix des valeurs de μ
- ⇒ non concordance de résolution spatiale entre données de transmission et d'émission à l'origine d'artefacts aux interfaces (e.g., poumons / tissus mous)

En pratique



Les valeurs mesurées dans les images dépendent « un peu » de la façon dont la correction d'atténuation est effectuée

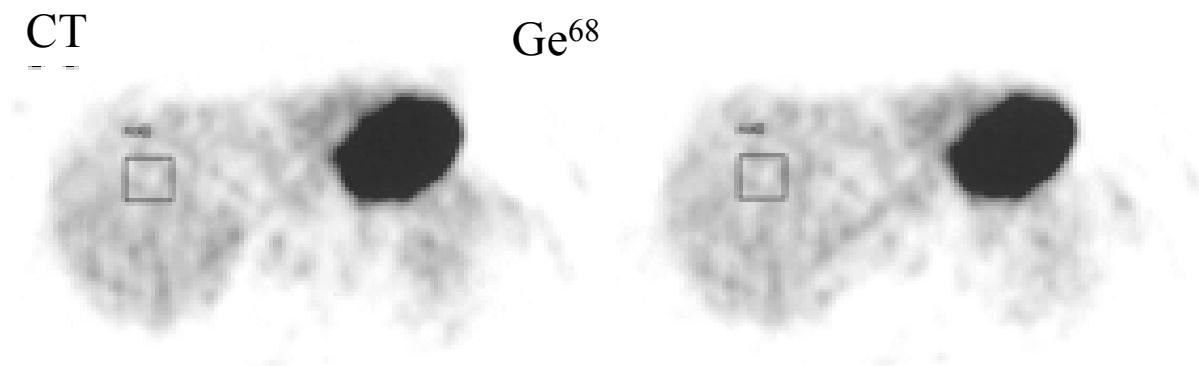


Concentrations d'activité environ 10% supérieure avec la correction utilisant la carte CT

Nakamoto et al, J Nucl Med 2002:1137-1143

Exemple en SPECT


Coupe ventriculaire gauche petit axe

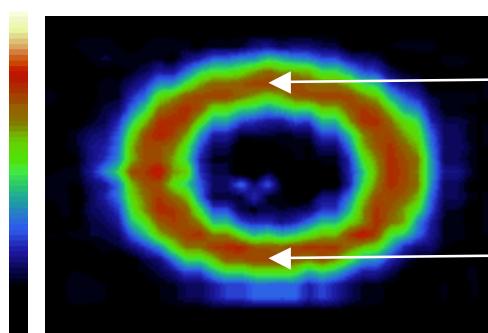

230

241


non atténué
 $A_{\text{ant}}/A_{\text{inf}}=1$

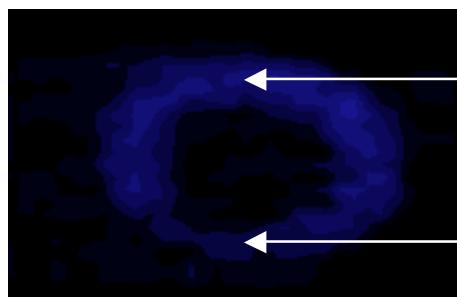

29

14


atténué
 $A_{\text{ant}}/A_{\text{inf}}=2,1$

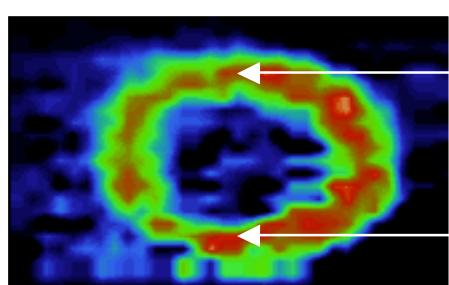

239

216


correction de Chang
 $A_{\text{ant}}/A_{\text{inf}}=1,1$

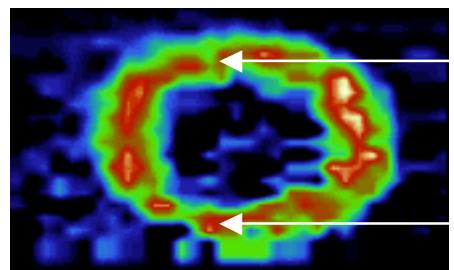

226

201

Chang itératif
 $A_{\text{ant}}/A_{\text{inf}}=1,1$

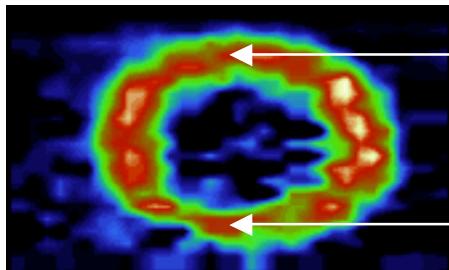

251

237

correction lors de la
reconstruction
 $A_{\text{ant}}/A_{\text{inf}}=1,1$

Correction d'atténuation : synthèse



- Nécessite un dispositif d'acquisition en transmission ou un CT pour estimer la cartographie des μ
 - Ceci reste une limite à l'application des méthodes en SPECT où ces dispositifs restent peu disponibles
 - Pas de problème en PET



- Connaissant la cartographie des μ :
 - pas de solution théoriquement exacte en SPECT, mais de nombreuses approches de corrections
 - correction exacte en PET
- Utiles
 - ⇒ qualitativement : e.g., correction de l'artefact de la paroi inférieure en imagerie cardiaque
 - ⇒ quantitativement : indispensable à la quantification absolue de l'activité, aux mesures de SUV


Correction d'atténuation : pratique de routine



- En SPECT :
 - pas de méthode systématiquement mise en œuvre
 - méthodes les plus utilisées le cas échéant :
 - ⇒ correction de Chang itérative avec rétroprojection filtrée
 - ⇒ modélisation de l'atténuation dans OSEM
- En PET :
 - correction des sinogrammes la plus fréquente
 - correction systématiquement utilisée en imagerie cardiaque et cérébrale
 - correction utilisée conjointement aux données non corrigées en imagerie oncologique

Questions pratiques


- Pourquoi a t-on systématiquement les images corrigées et non corrigées de l'atténuation en PET au FDG ?
- Pourquoi la correction d'atténuation ne marche t-elle pas toujours bien en SPECT cardiaque ?

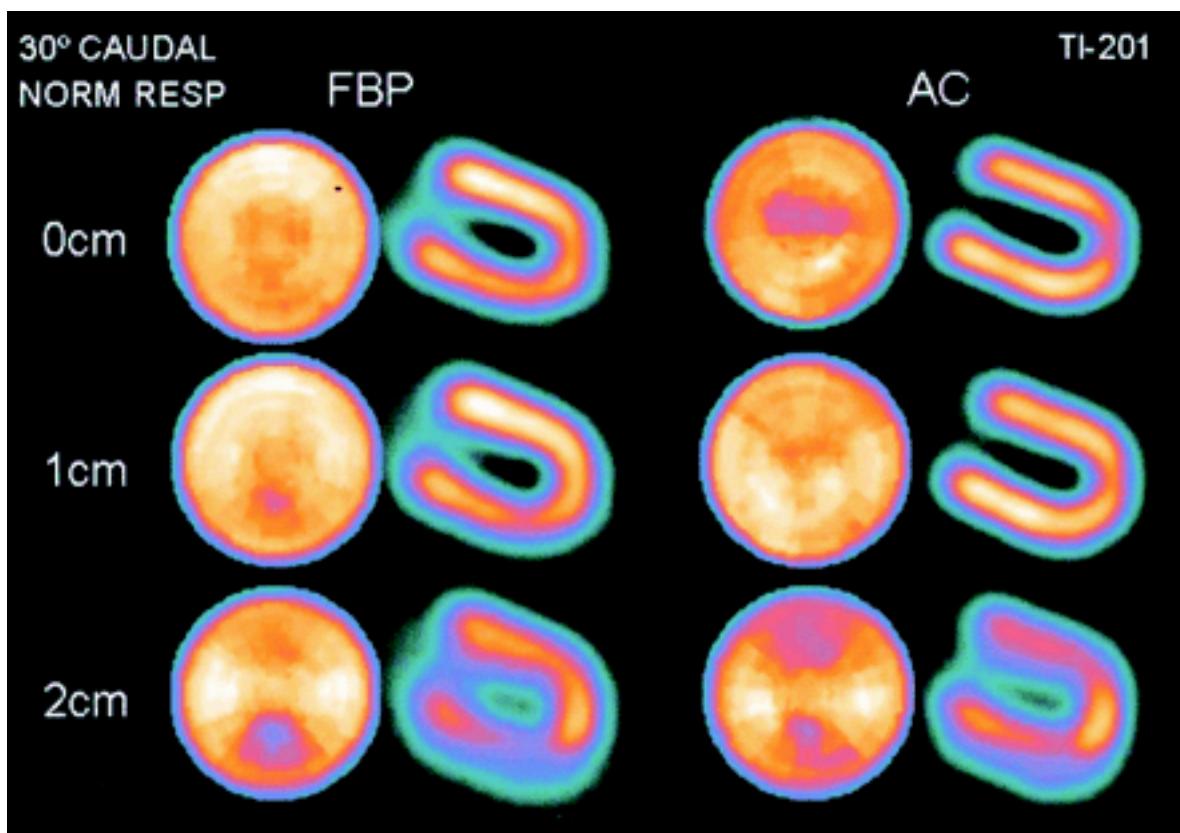



Vos questions



La diffusion Compton

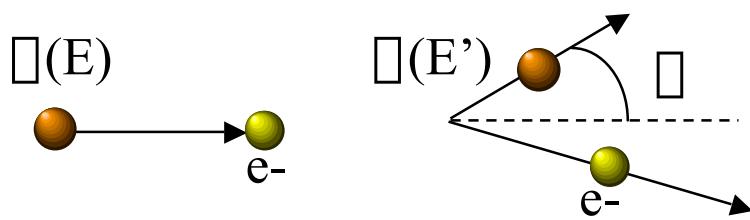


$$E' = \frac{E}{1 + E (1 - \cos \theta)/m_0 c^2}$$

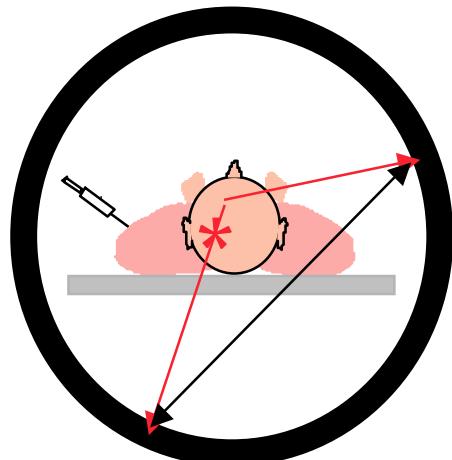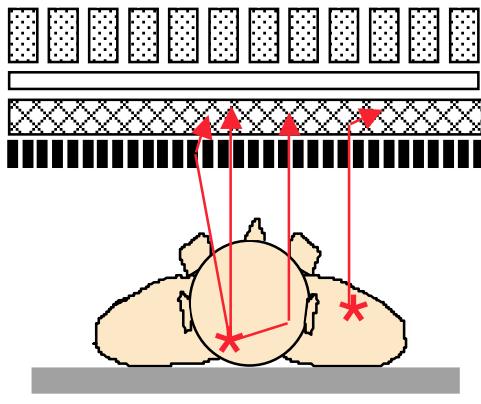


Diffusion :

- Dans le patient
- Dans le collimateur ou sur les septa en PET
- Dans le cristal

Conséquences de la diffusion

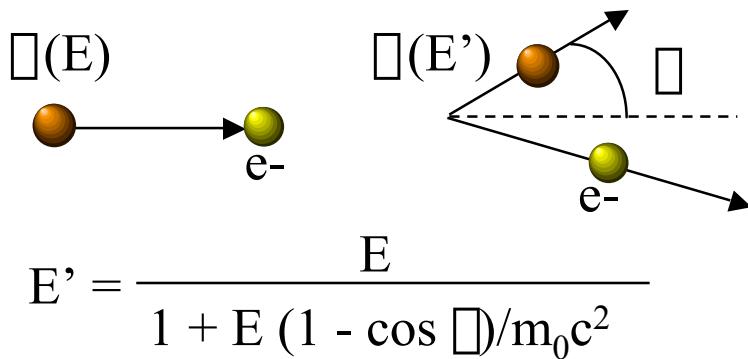


- Les photons perdent de l'énergie

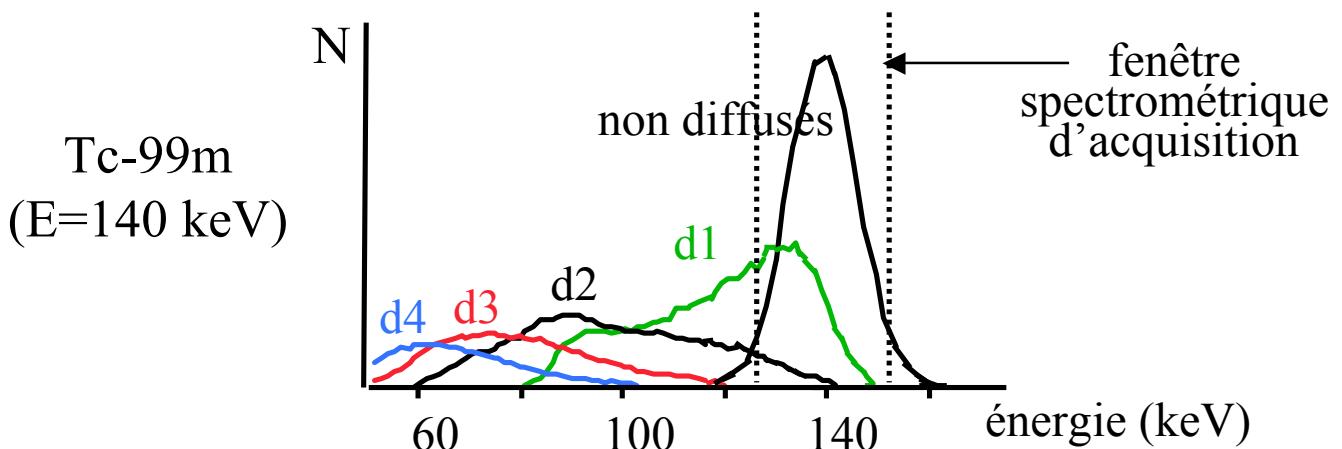


- Les photons changent de direction donc seront mal localisés dans les images
- Flou dans les images
- Diminution du contraste

Différence entre SPECT et PET

- En SPECT, les photons diffusés sont nécessairement détectés en regard du patient

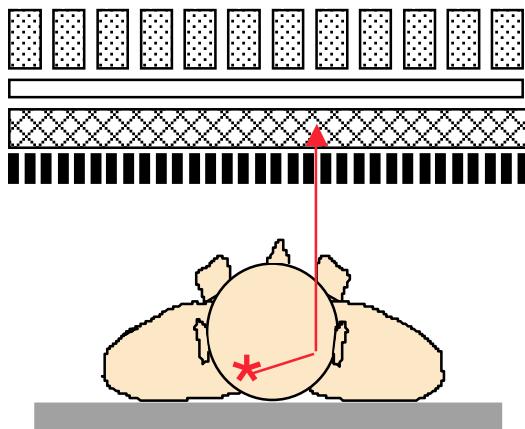


- En PET, les photons diffusés peuvent être détectés en dehors du patient

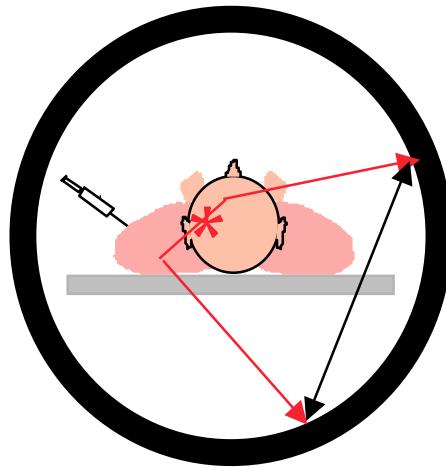

Ceci permet de facilement les repérer et donne lieu à une correction spécifique au PET

Importance de la diffusion en SPECT

- Tc-99m

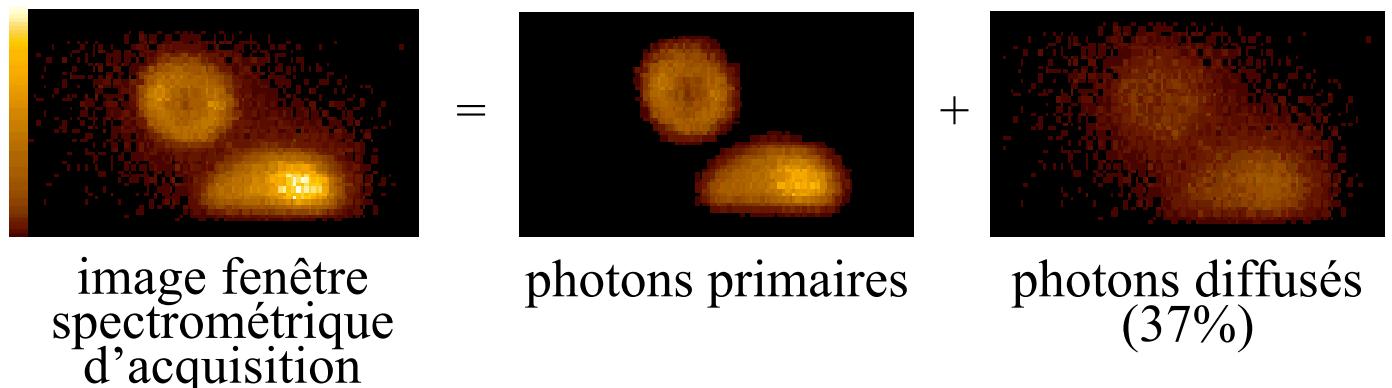


Au Tc-99m, environ 30% des photons détectés dans la fenêtre d'acquisition classique sont des photons diffusés (donc mal positionnés dans l'image)

- Accroissement de la section efficace quand l'énergie diminue : les images au Tl-201 sont plus affectées par la diffusion que les images au Tc-99m
- Phénomène dépendant du milieu diffusant : phénomène plus pénalisant chez les sujets obèses que chez les sujets minces




Importance de la diffusion en PET

- Phénomène pénalisant beaucoup le PET 3D
 - ⇒ ~30% en 2D
 - ⇒ >50% en 3D

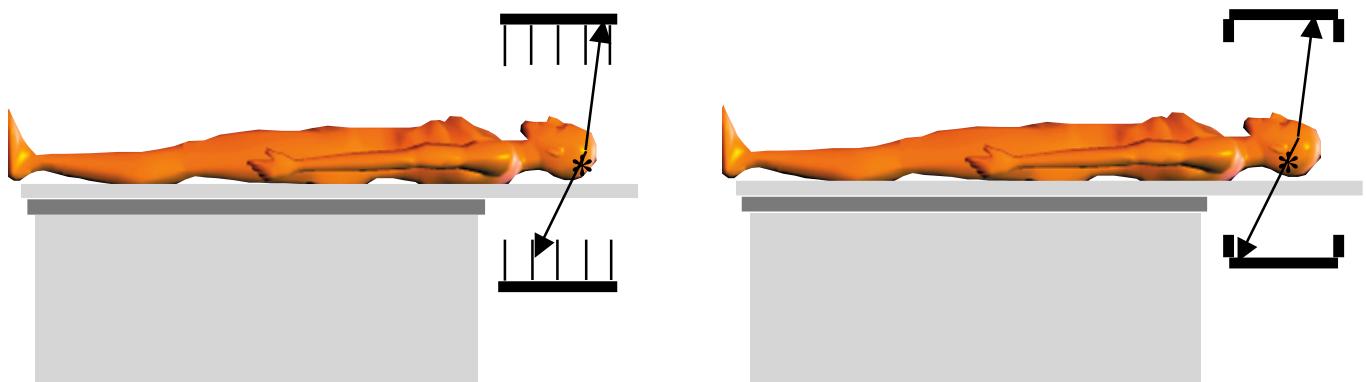

- En 3D, diffusion provenant d'activité extérieure au champ de vue : on détecte dans les images des événements émanant de l'extérieur du champ de vue (e.g., cœur, vessie)

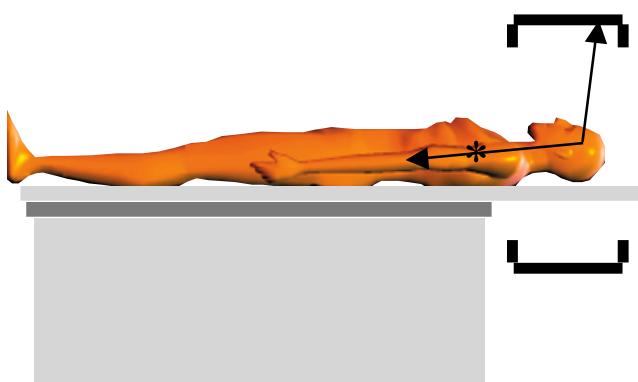


C'est une des raisons pour lesquelles le PET 3D ne conduit pas forcément à de meilleures (plus justes) images que le PET 2D


Correction de diffusion : stratégies



- Deux stratégies
 - élimination des photons diffusés

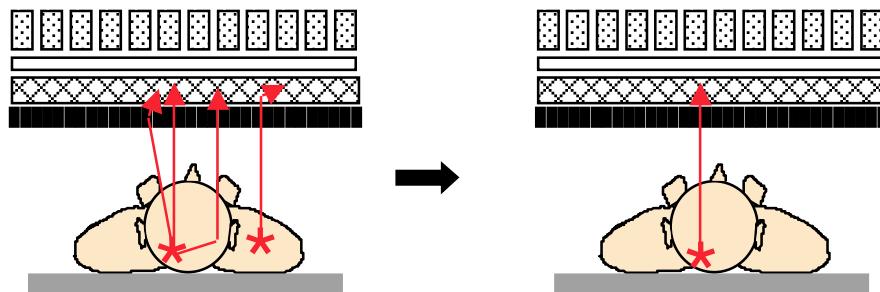




- repositionnement des photons diffusés

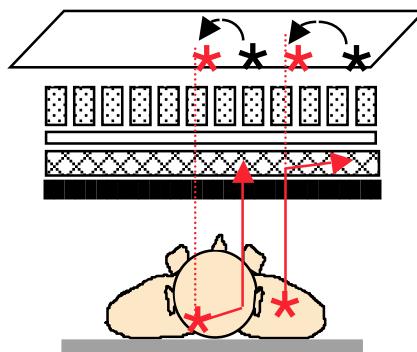

- Plus de 30 méthodes ont été proposées !

Réduction des photons diffusés à l'acquisition

- Par fenêtrage spectrométrique : 3 types de fenêtres

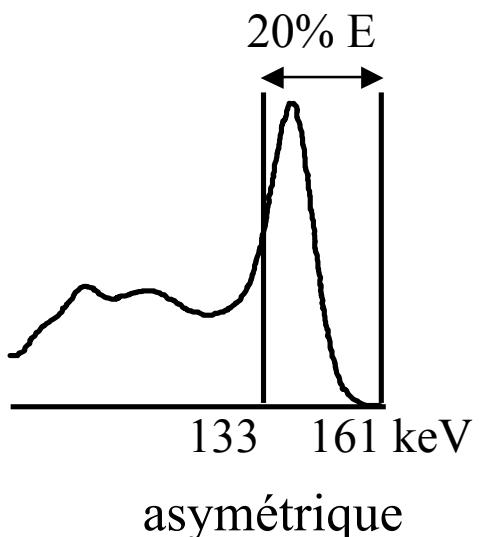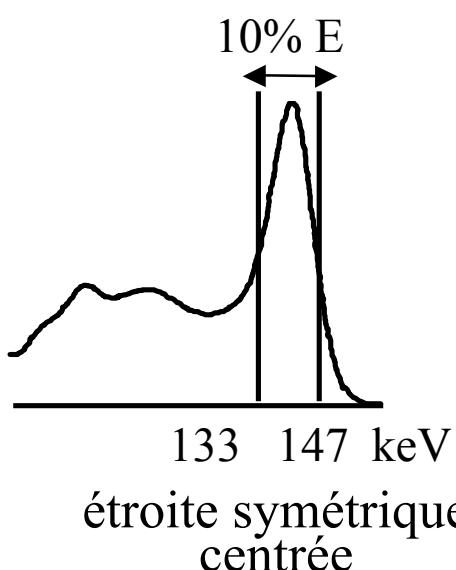
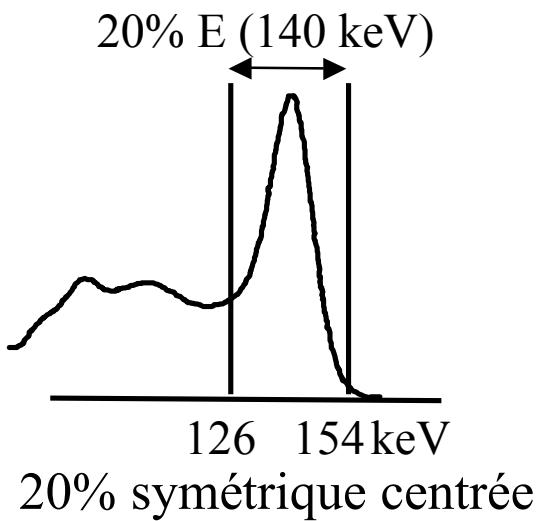


⇒ nécessaire mais insuffisant

Importance d'avoir un tomographe présentant une bonne résolution en énergie

Importance de la résolution en énergie


Importance d'avoir un tomographe présentant une bonne résolution en énergie

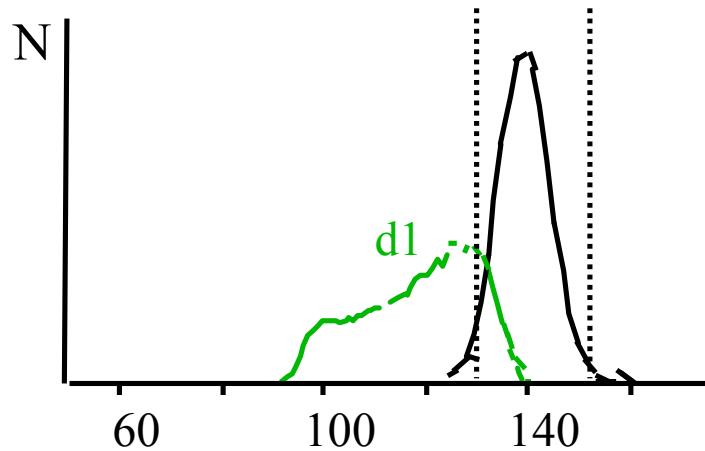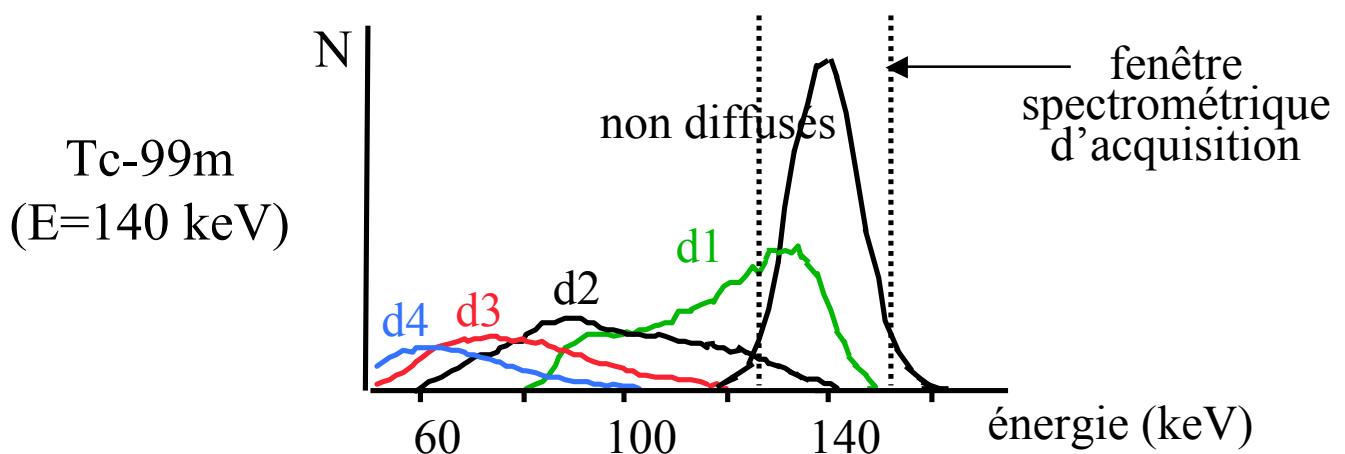


Soustraction de Jaszzczak en SPECT

- Hypothèse

$$\hat{D}(i) = k \cdot I_2(i)$$

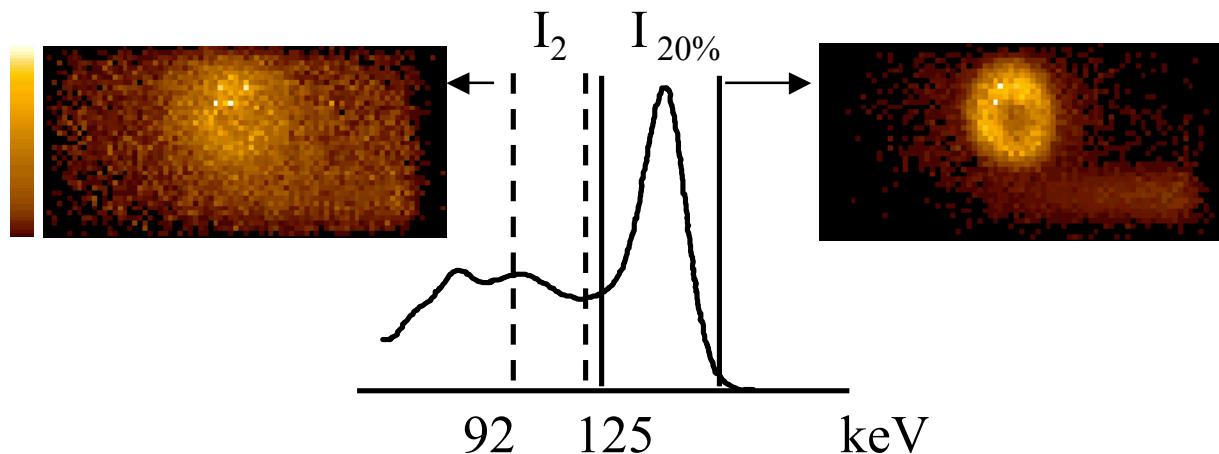

- Correction

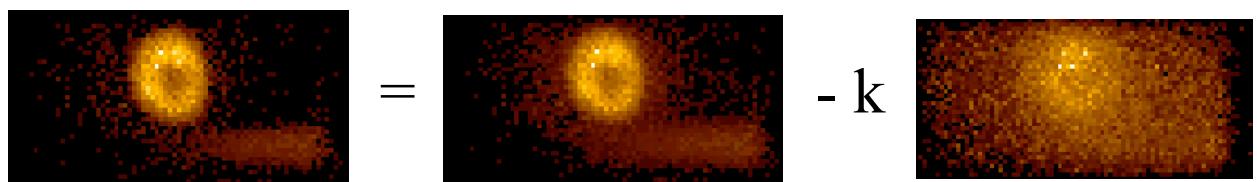

Très simple à mettre en œuvre (d'où son succès)




Applicable à différents isotopes (par simulation ou acquisitions sur fantôme) à condition de pré-optimiser la fenêtre secondaire et k

Soustraction de Jaszcza en SPECT

- néglige la dépendance entre angle de déviation \square et énergie perdue



$$E' = \frac{E}{1 + E(1 - \cos \square)/m_0 c^2}$$

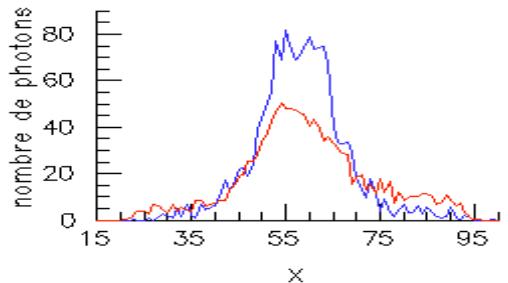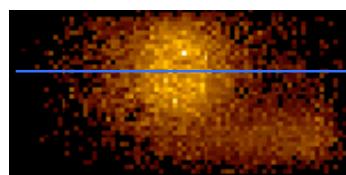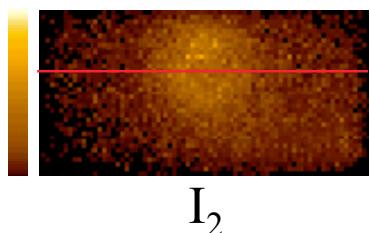


- surcorrection loin des sources
- sous-correction à proximité

Rehaussement artificiel du contraste plaisant à l'œil

Approximatif d'un point de vue quantitatif mais globalement performant


Méthode des 3 fenêtres en énergie (TEW) en SPECT

- Hypothèse :
spectre des photons détectés dans le pixel i :

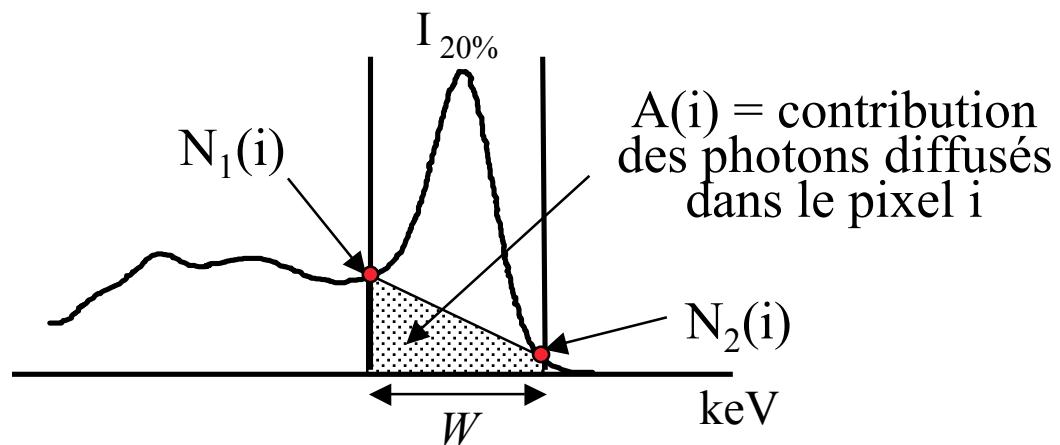

$$A(i) = W [N_1(i) + N_2(i)] / 2$$


Tc-99m
(E=140 keV)

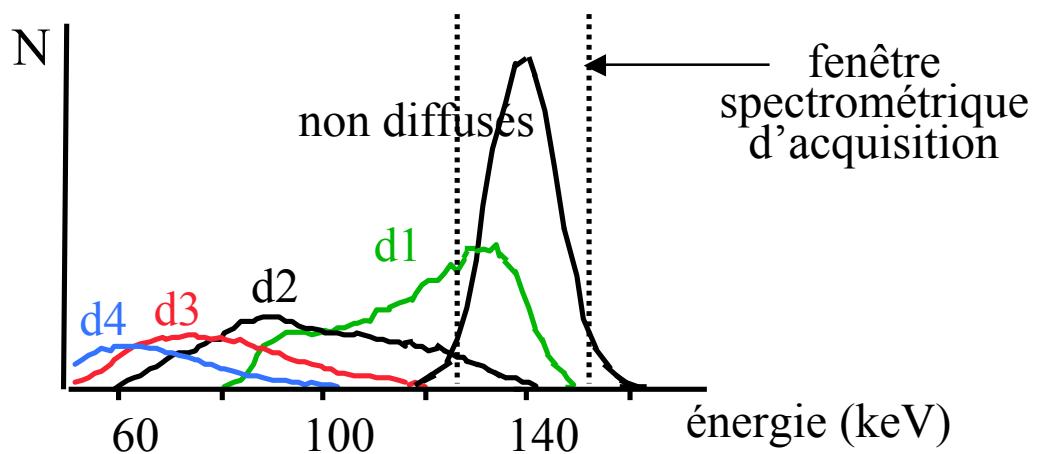

Méthode des 3 fenêtres en énergie (TEW)

- Correction

- acquisition des données dans 3 fenêtres $I_{20\%}$, I_1 et I_2

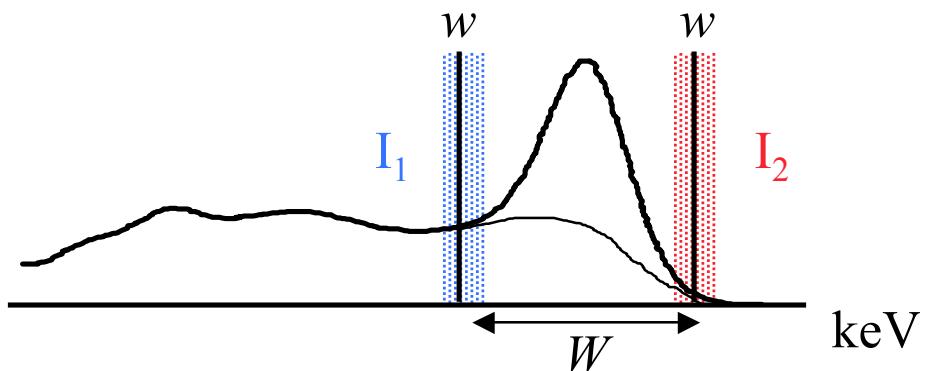

- estimation de $D(i)$ pour chaque pixel i :

$$\hat{D}(i) = W [I_1(i) + I_2(i)] / 2w$$

- estimation de P


$$\hat{P}(i) = I_{20\%}(i) - \hat{D}(i)$$

- facile à mettre en œuvre, donc assez utilisé
- ne nécessite pas de calibrer k , donc plus facilement adaptable à différents isotopes
- conduit à des images bruitées du fait de l'utilisation de I_1 et I_2

Calcul direct de la contribution du diffusé


distribution d'émission connue
(~ images reconstruites sans
correction de la diffusion)

distribution d'atténuation
connue (~ images de
transmission ou CT)

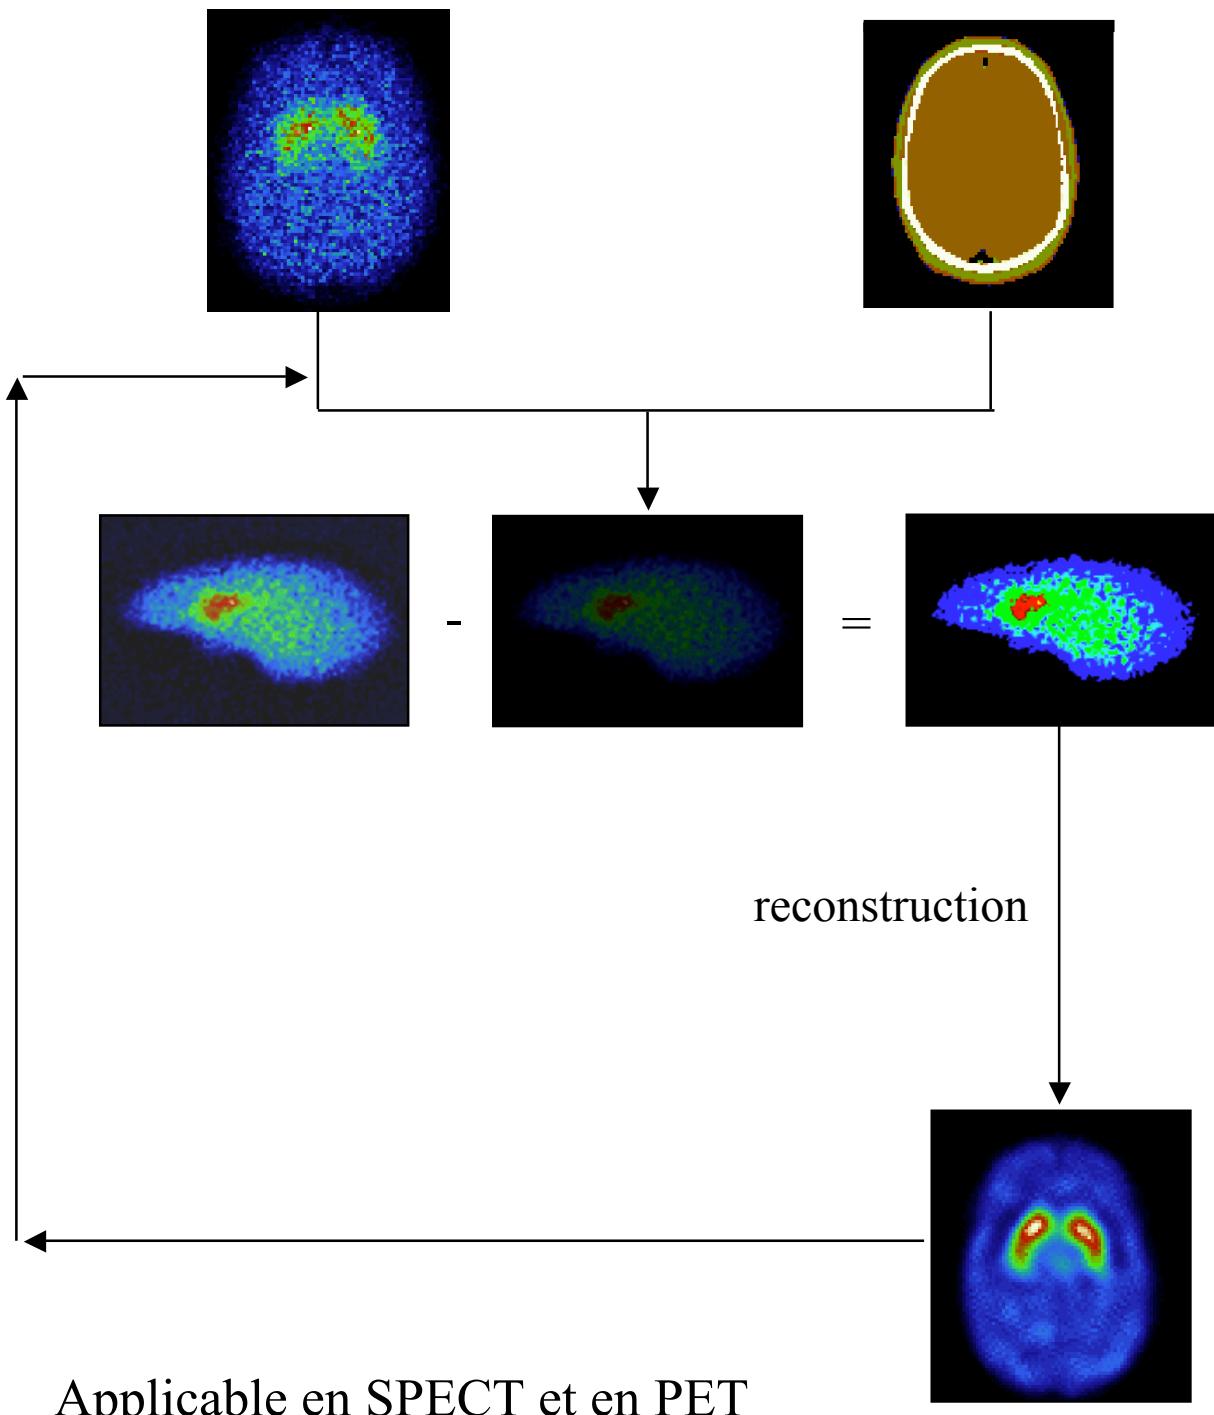

Ajustement des queues de distribution en PET



- Hypothèses
 - image du diffusé = image basse fréquence
 - distribution spatiale des photons diffusés modélisable par une fonction relativement simple (fonction gaussienne)
- Mise en oeuvre
 - filtrage des sinogrammes pour réduire l'influence du bruit
 - ajustement de l'activité enregistrée en dehors de l'objet par une fonction analytique simple (e.g., gaussienne)
 - soustraction la contribution du diffusé ainsi estimée

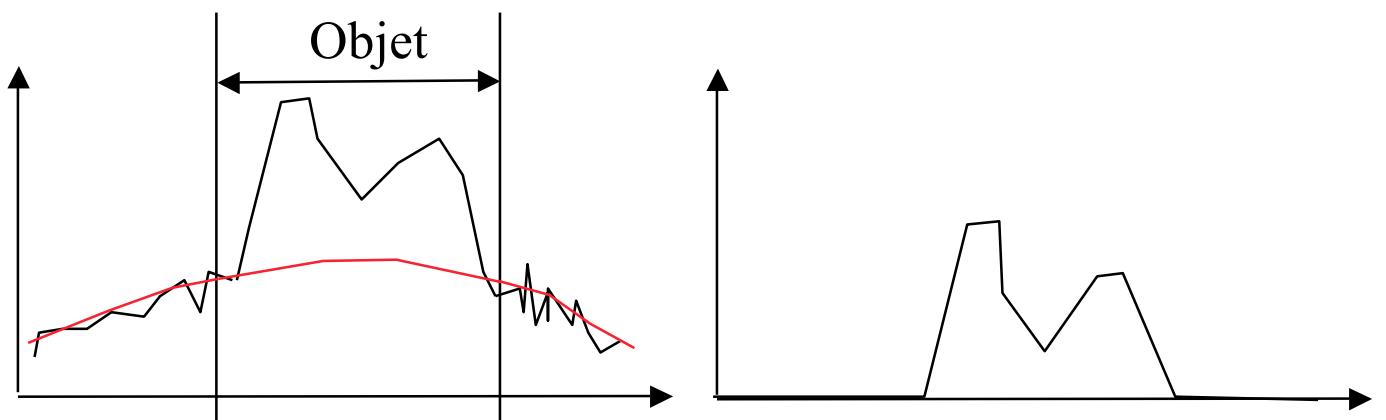

Sur les sinogrammes

Repositionnement des photons diffusés

- Modélisation de la diffusion dans le projecteur

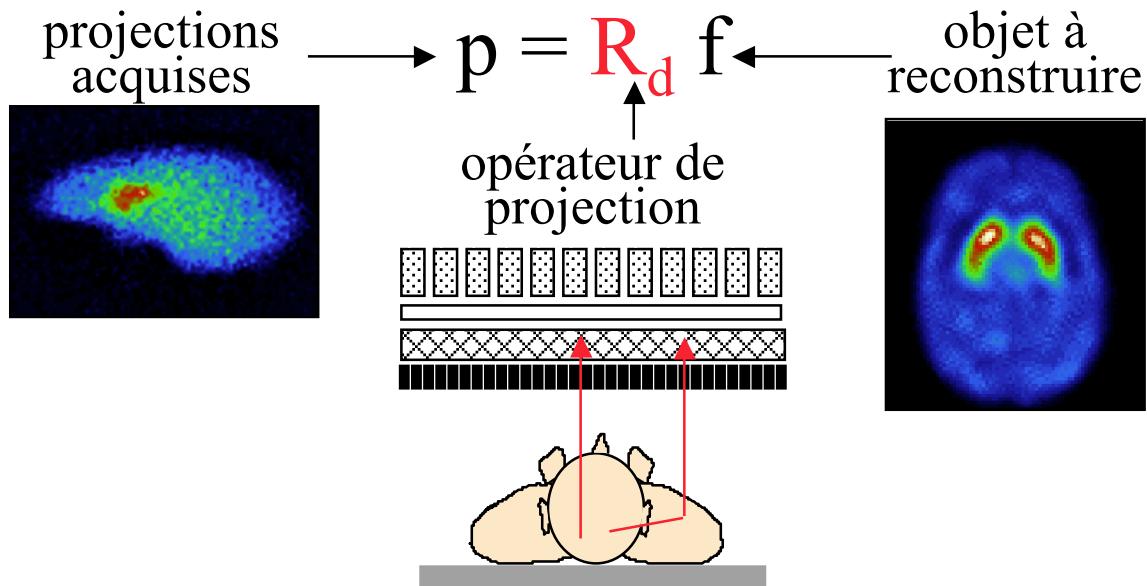

sans modélisation de la diffusion :

$$p_1 = r_{11} f_1 + r_{13} f_3$$


avec modélisation de la diffusion :

$$p_1 = r_{11} f_1 + r_{12} \mathbf{f}_2 + r_{13} f_3 + r_{14} f_4$$

- modélisation analytique approximative
- modélisation Monte Carlo

- Reconstruction itérative avec modélisation de la diffusion dans le projecteur
 - ⇒ approche très générale adaptée à tous les algorithmes de reconstruction itérative
 - ⇒ formulation difficile d'un modèle adaptatif
 - ⇒ coûteux en espace mémoire et en temps calcul

Illustration en SPECT

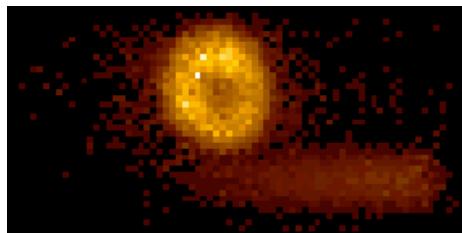

primaires

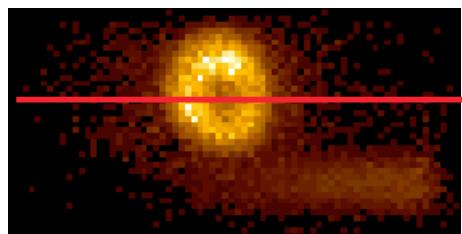


image 20% : 126-154 keV

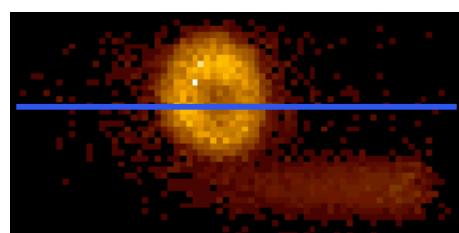
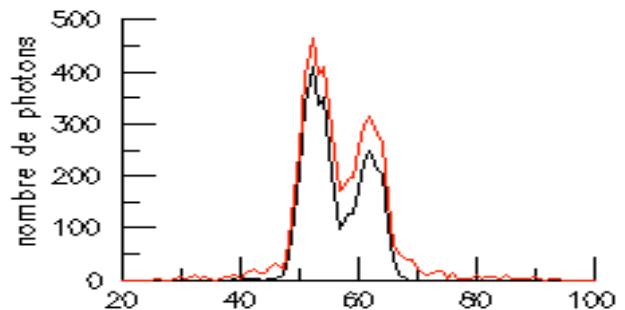


image 133-161 keV

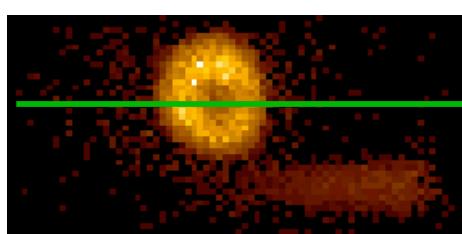
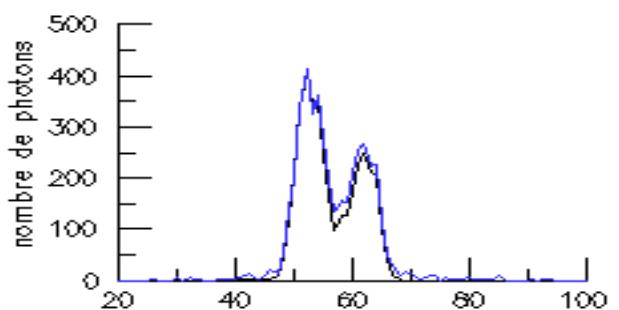


image Jaszczak




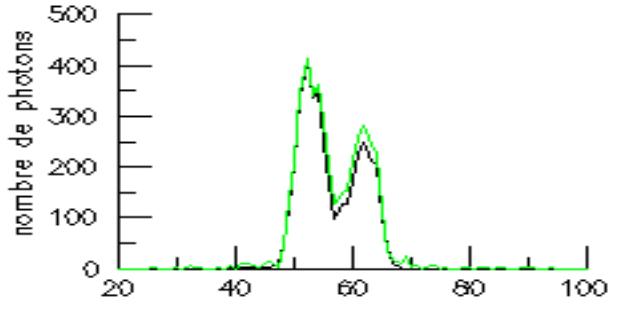


Illustration en PET

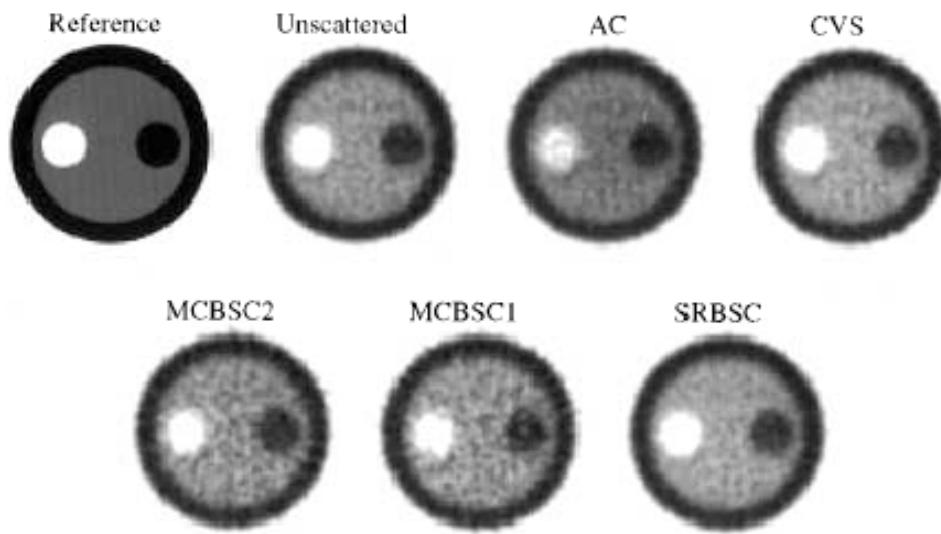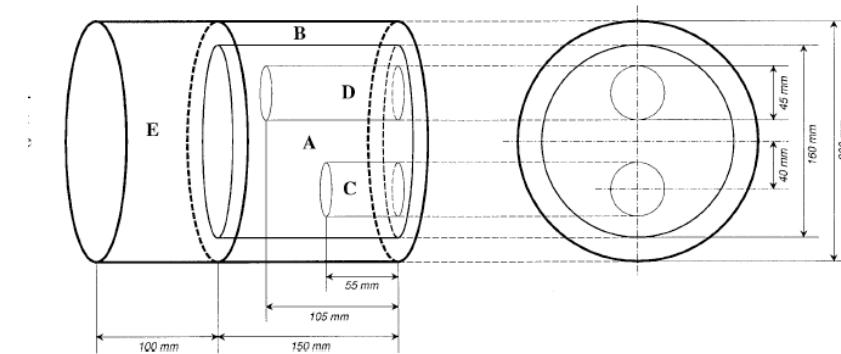

- sans correction de diffusion : erreurs : 9% à 30%



| Case/compartment | Figure of merit | | Absolute concentration (kBq/ml) | |
|---------------------------|-----------------|------|---------------------------------|---|
| | B | D | B | D |
| Calibration concentration | 5.88 | 4.86 | | |

- différentes corrections de diffusion : erreurs : -5% à 12%

Zaidi et al, Eur J Nucl Med 2000;18:1813-1826


Correction de diffusion : synthèse

- Correction indispensable pour une quantification non biaisée
 - pour enlever l'activité apparente dans des régions dénuées d'activité
 - surestimation de l'activité de 20% ou plus sans correction de la diffusion
 - correction critique en PET 3D
- Pas de solution exacte mais de nombreuses approches de correction
- Pas de correction de la diffusion systématique, la correction est laissée au choix de l'opérateur
- Pas de méthode “standard”
 - soustraction de Jaszczak ou TEW les plus fréquemment utilisées en SPECT
 - ajustement gaussien des queues de distributions fréquemment utilisé en PET, qui a l'avantage d'enlever le diffusé émanant d'activité extérieure au champ de vue
 - calcul direct de la contribution du diffusé souvent utilisé en PET, mais ne traite pas du diffusé émanant d'activité extérieure au champ de vue




Correction de diffusion : synthèse

- Modification sensible de l'aspect des images corrigées du fait de l'augmentation du bruit : les images les plus justes ne sont pas forcément les images les plus plaisantes à l'oeil

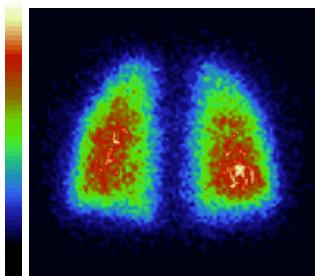

non corrigée

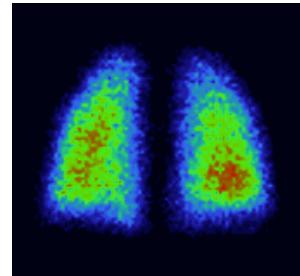

corrigée


La diffusion agit comme un lissage

L'interprétation visuelle des images corrigées du diffusé peut nécessiter un apprentissage

Vos questions




Effet de volume partiel en SPECT et PET

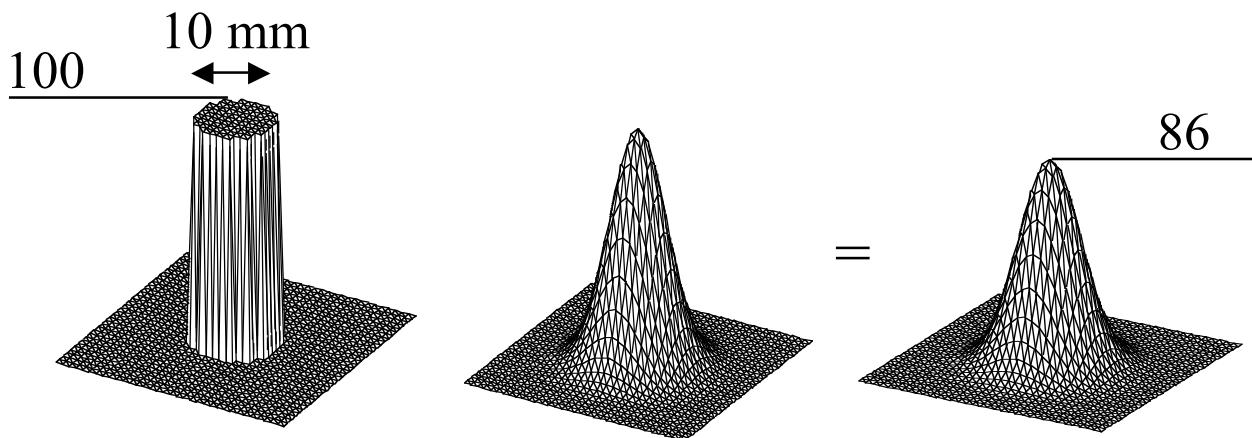


objet d'intensité maximale 100 fonction de réponse du détecteur image observée

- Sous-estimation de l'activité dans les structures de petite taille dépendant
 - ⇒ du contraste objet / fond
 - ⇒ de la dimension de l'objet
 - ⇒ de la résolution spatiale du système

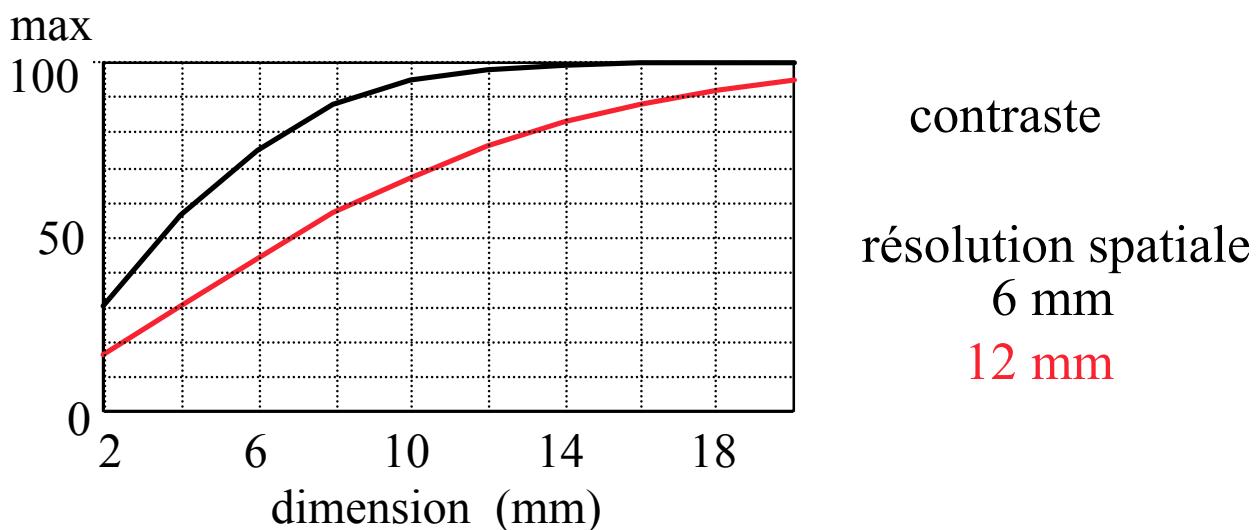

- ⇒ affecte les structures de taille <2-3 FWHM

Influence de la région d'intérêt (ROI) considérée

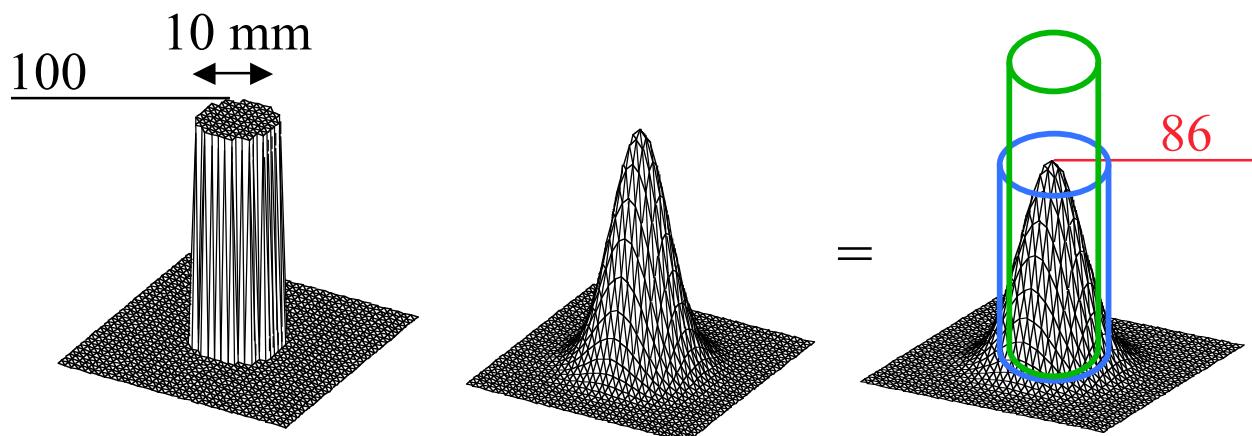

- **max** (ROI de 1 pixel) :
 - minimise le biais introduit par l'effet de volume partiel
 - très sensible au bruit dans l'image
- **tracée manuellement** :
 - effet de volume partiel dépendant fortement de l'observateur (biais peu reproductible)
 - biais toujours plus élevé qu'en considérant le max
- **ROI anatomique** :
 - biais introduit par l'effet de volume partiel important mais prévisible



Correction de volume partiel : stratégies



- Deux stratégies
 - coefficients de recouvrement
 - modélisation anatomo-fonctionnelle

- Quelques travaux en PET, peu en SPECT

Correction par coefficients de recouvrement


- Hypothèses

- taille de la structure d'intérêt connue
- contraste connu
- résolution spatiale du système connue

⇒ détermination d'un coefficient de recouvrement à partir de tables

- Exemple


- structure de 1 cm
- contraste infini (pas d'activité environnante)
- résolution spatiale de 12 mm

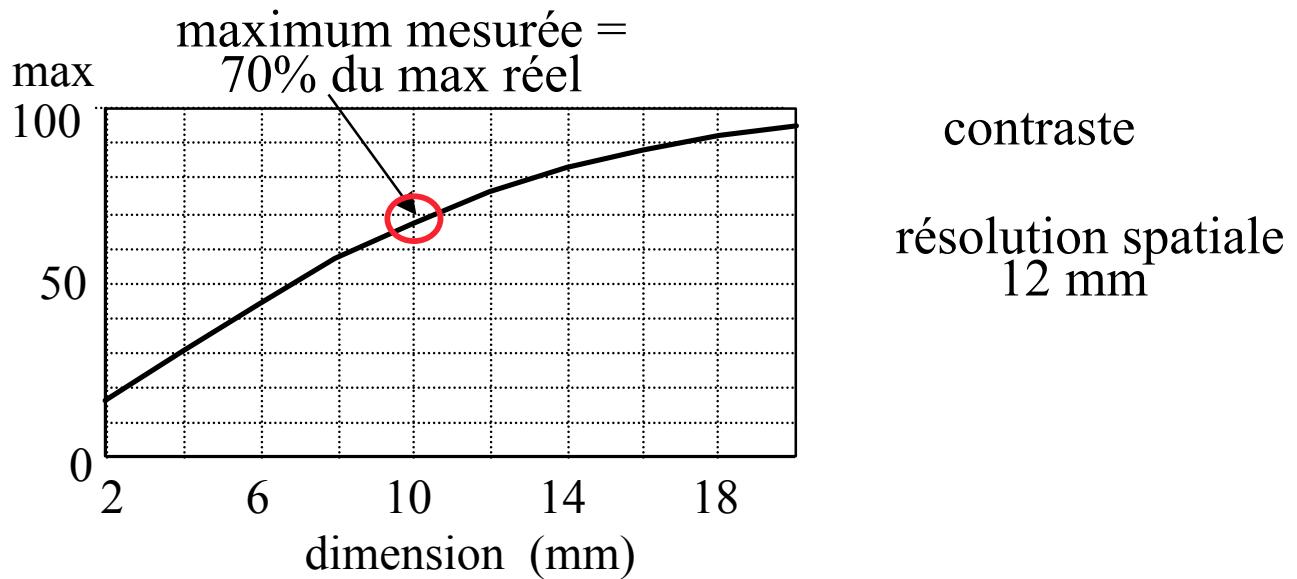


⇒ activité réelle = maximum de l'activité mesurée / 0,7

Inversion d'une matrice de contamination croisée

- Hypothèses
 - supports anatomiques des différentes structures fonctionnelles connus
 - fonction de réponse spatiale du système connue
- Exemple : imagerie des récepteurs dopaminergiques
 - modèle :

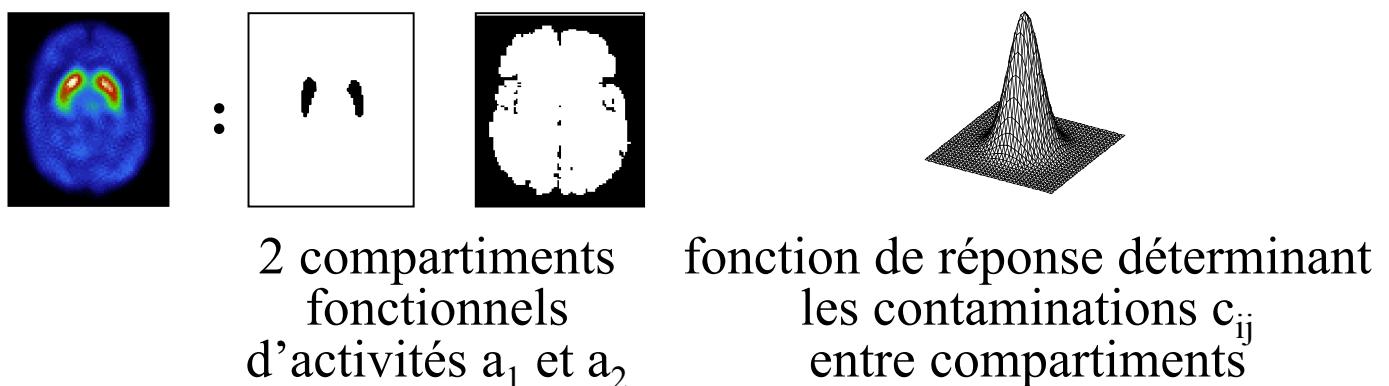

- estimation des contaminations entre compartiments

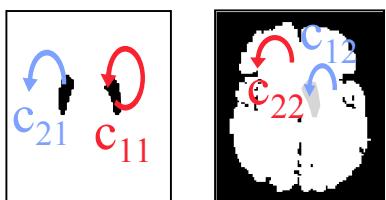


$$\begin{aligned}m_1 &= c_{11} a_1 + c_{12} a_2 \\m_2 &= c_{21} a_1 + c_{22} a_2\end{aligned}$$

- correction : inversion du système matriciel connaissant m_1 , m_2 , et les coefficients c_{ij}
 - ⇒ a_1 et a_2

⇒ modélisation relativement simpliste pour certaines applications


Illustration en SPECT

- Mesure de l'activité dans les striata en SPECT cérébral
 - “binding potential” (BP)

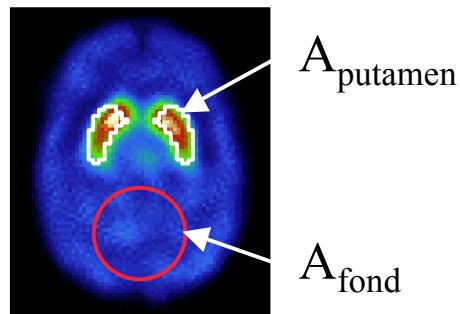

$$BP = \frac{A_{\text{putamen}} - A_{\text{fond}}}{A_{\text{fond}}}$$

binding potential

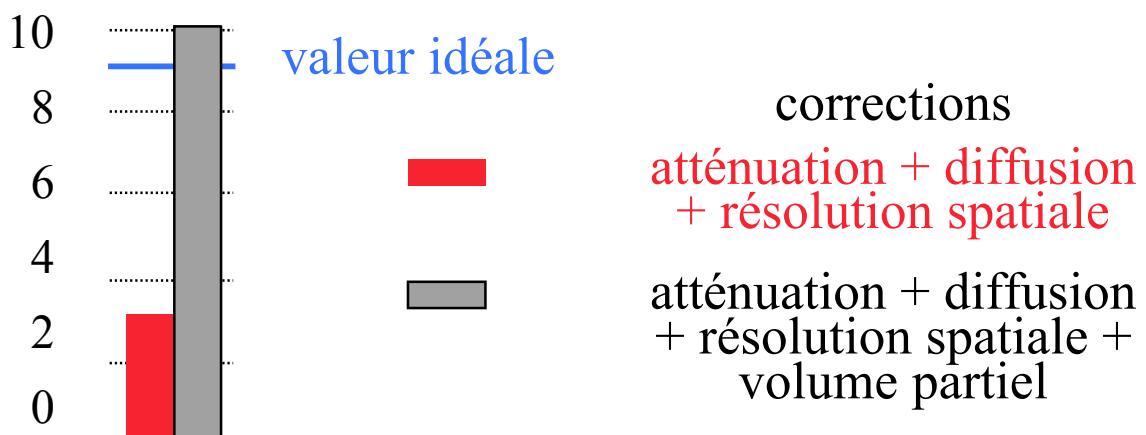

- activité restaurée dans le putamen



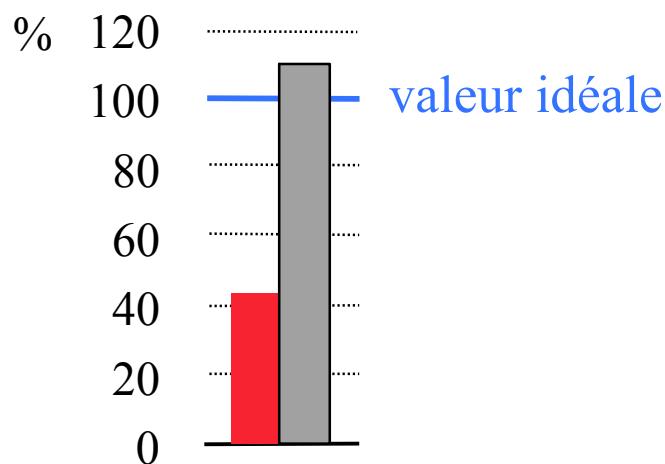


Illustration en PET

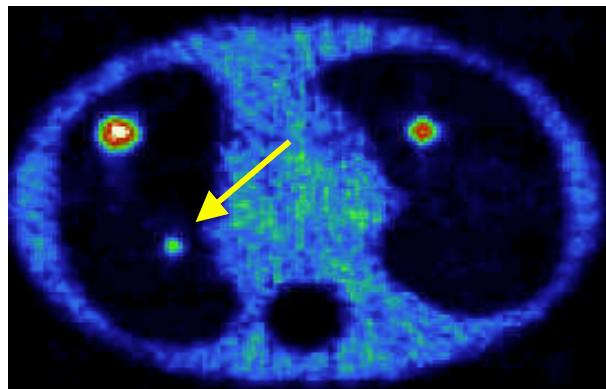

Tumeur du poumon $\varnothing = 10,5$ mm

Sous-estimation (%) des SUV

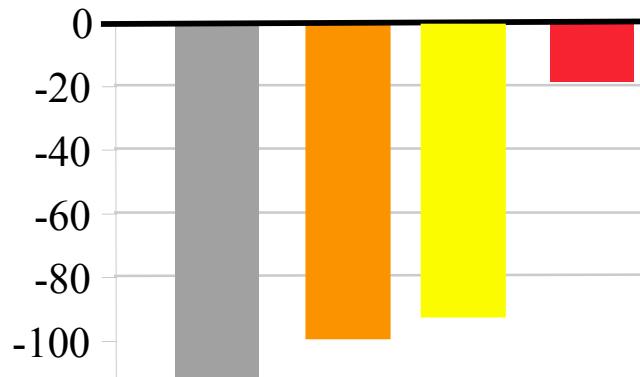


Corrections

- = diffusion (D) + coïncidences fortuites (F)
- = D + F + atténuation (A, carte Cs)
- = D + F + A (carte TDM)
- = D + F + A (TDM) + volume partiel (CC)



Effet de l'index pour le suivi thérapeutique

Détection de la réponse à une thérapie :

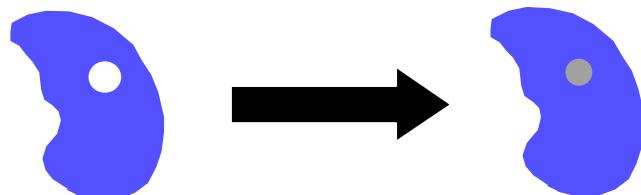

Avant : 33 mm, TNR=8 Après : 22 mm, TNR=4

Index étudiés :

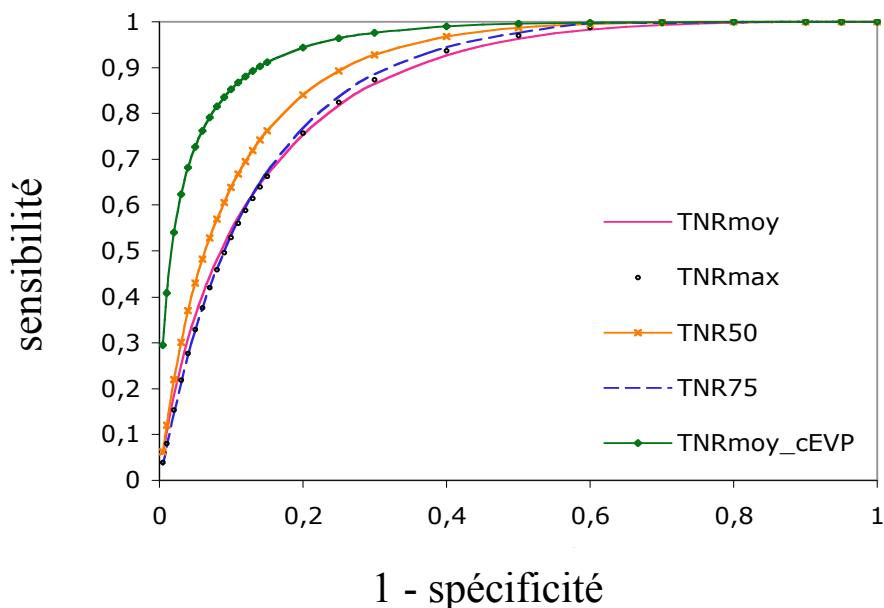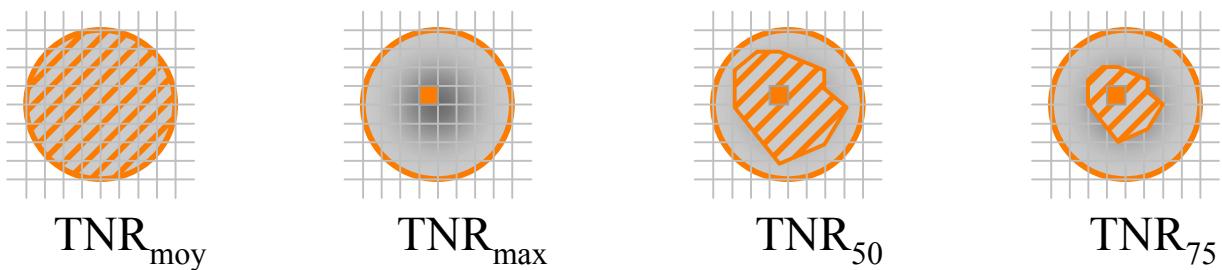

Feuillardent et al, J Nucl Med 2005 (abstract)

Correction de volume partiel : synthèse

- Correction non nécessaire pour estimer l'activité dans des structures de grande taille (> 3 FWHM)
- Correction indispensable pour une estimation non biaisée de l'activité dans les structures de taille $< 2\text{-}3$ FWHM
- Pas de correction systématiquement appliquée en routine
- Pas de consensus quant à la meilleure méthode de correction : différentes méthodes actuellement en développement



Vos questions





Mouvement en SPECT et en PET

2 types de mouvements :

- fortuits
- physiologiques : cardiaque, respiratoire, ...

Respiration normale : mouvement d'amplitude de 1 à 3 cm,
~18 fois/minute

SPECT cardiaque

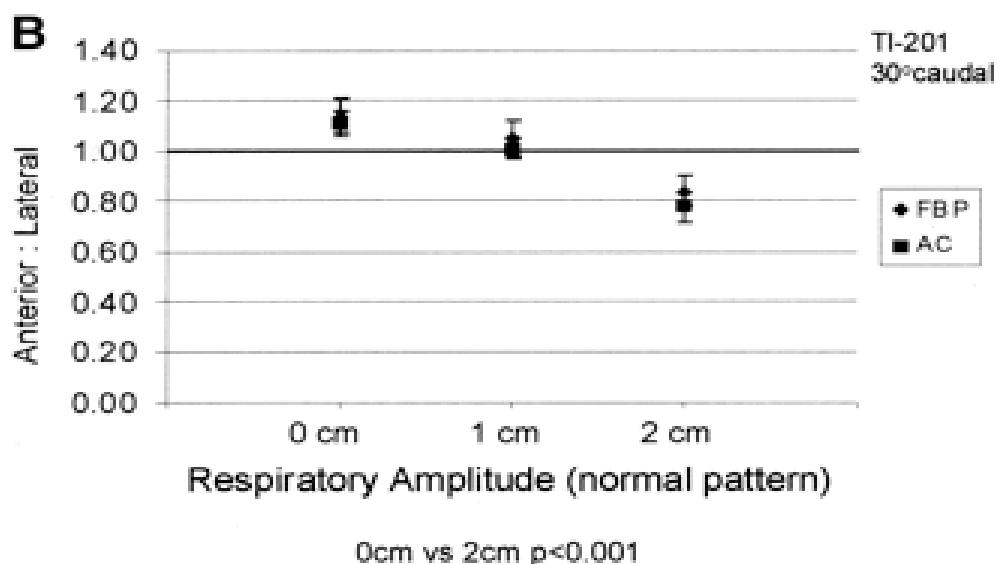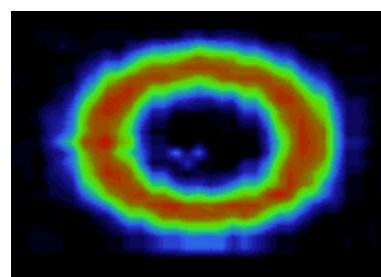


→ modification du rapport d'activité antérieure/latérale de ~25%


Pitman et al, J Nucl Med 2002:1259-1267

Le mouvement et ses conséquences

PET FDG pulmonaire

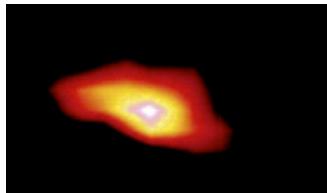

avec flou cinétique

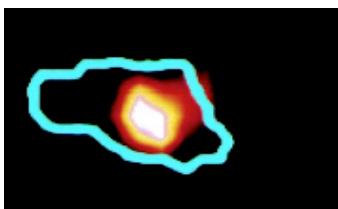

« sans » flou cinétique


- volume apparent des lésions augmenté de 10% à plus de 30% du fait du mouvement
- valeur de fixation diminuée de 5% à plus de 100%

Nehmeh et al, J Nucl Med 2002:876-881

Correction du mouvement fortuit


- Tendre vers des examens plus courts

PET/CT

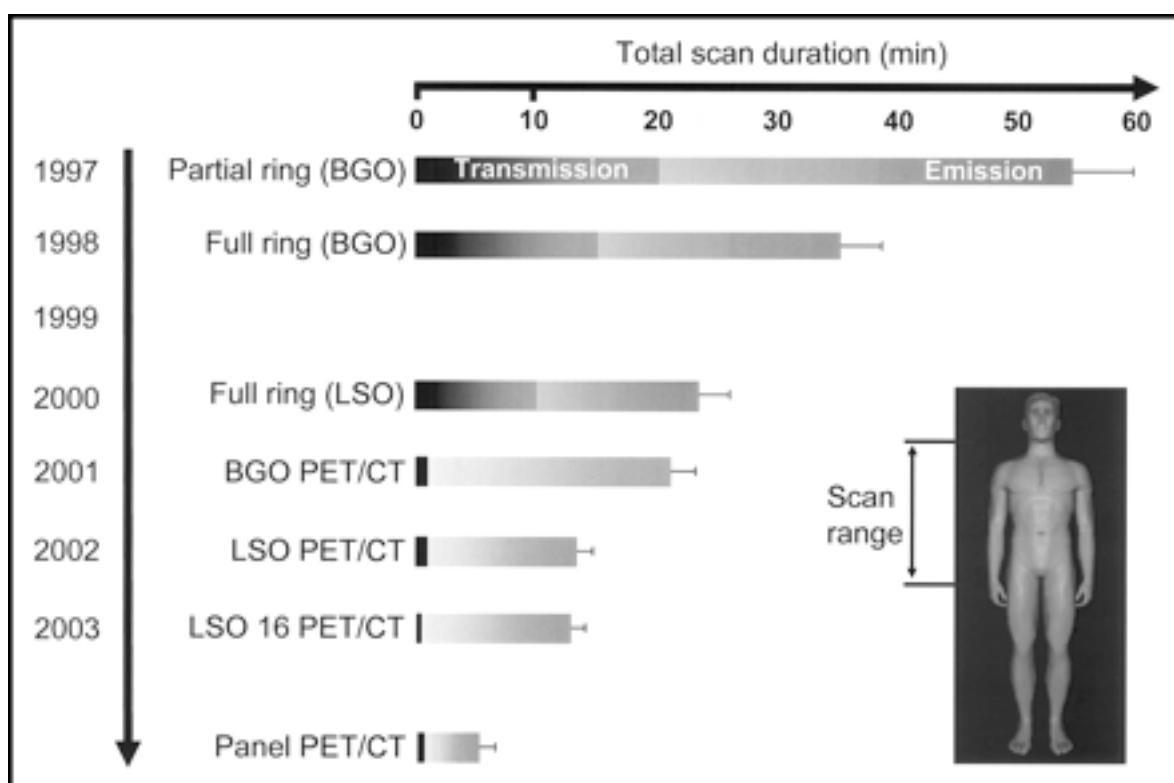


Correction des mouvements physiologiques

- Pas de correction systématique
- Synchronisation cardiaque classique (PET / SPECT) pour les examens cardiaques

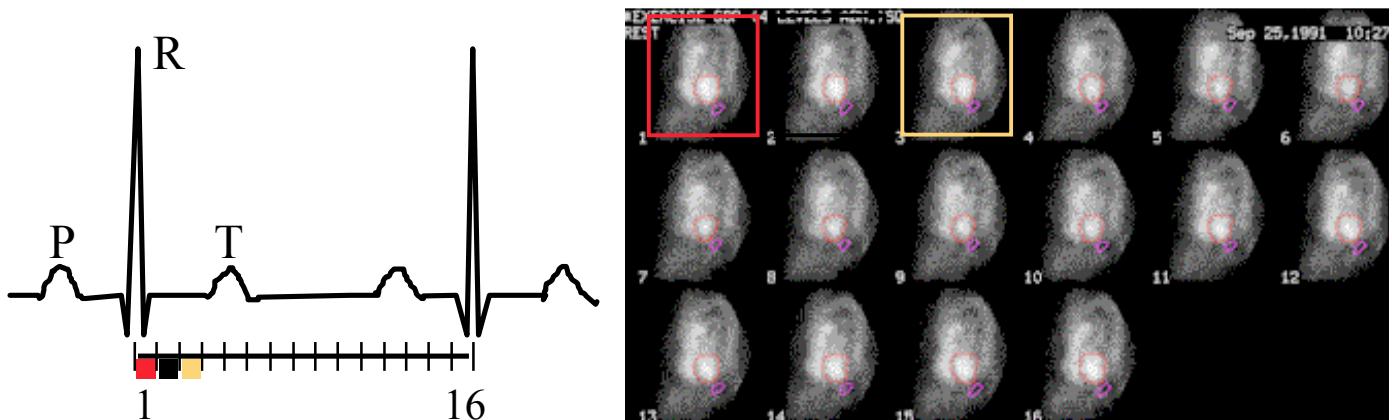

- Vers la synchronisation respiratoire (notamment PET oncologique pulmonaire)

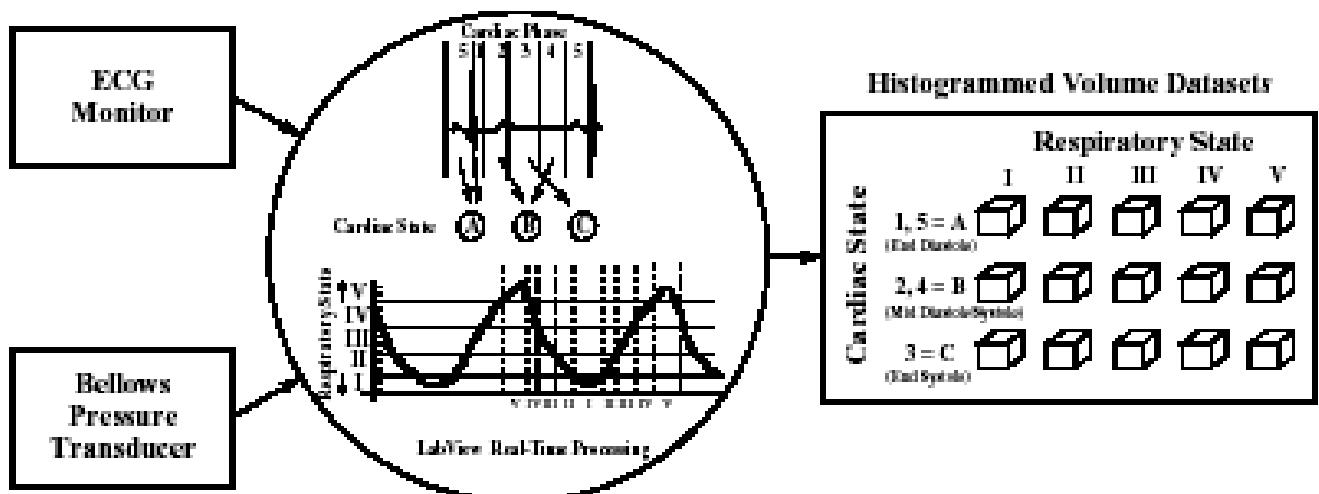

Impact de la méthode de reconstruction tomographique

FBP, OSEM, Gradient Conjugué ?



- Affecte la quantification indirectement, au travers de :
 - la résolution spatiale dans les images reconstruites (qui détermine notamment l'importance de l'effet de volume partiel)
 - le niveau de bruit dans les images reconstruites
- A compromis résolution spatiale / niveau de bruit identique, la méthode de reconstruction n'influence pas la qualité de la quantification (mais peut influencer les performances de détection !)
- En pratique cependant, différents algorithmes présentent souvent des compromis résolution spatiale / niveau de bruit différents




Exemple

FBP, OSEM, Gradient Conjugué ?





Différences (%) entre les valeurs de MRglu suivant la méthode de reconstruction tomographique mise en œuvre

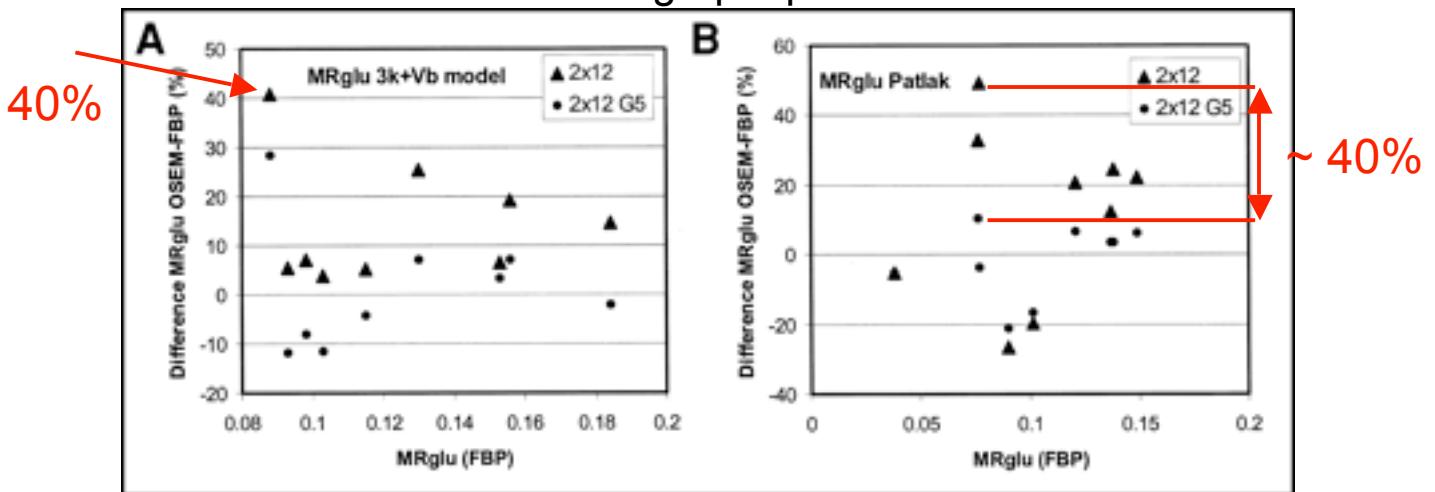

Boellaard et al, J Nucl Med 2001:808-817

Différences non négligeables en fonction de la méthode de reconstruction

Résolution spatiale non stationnaire en SPECT

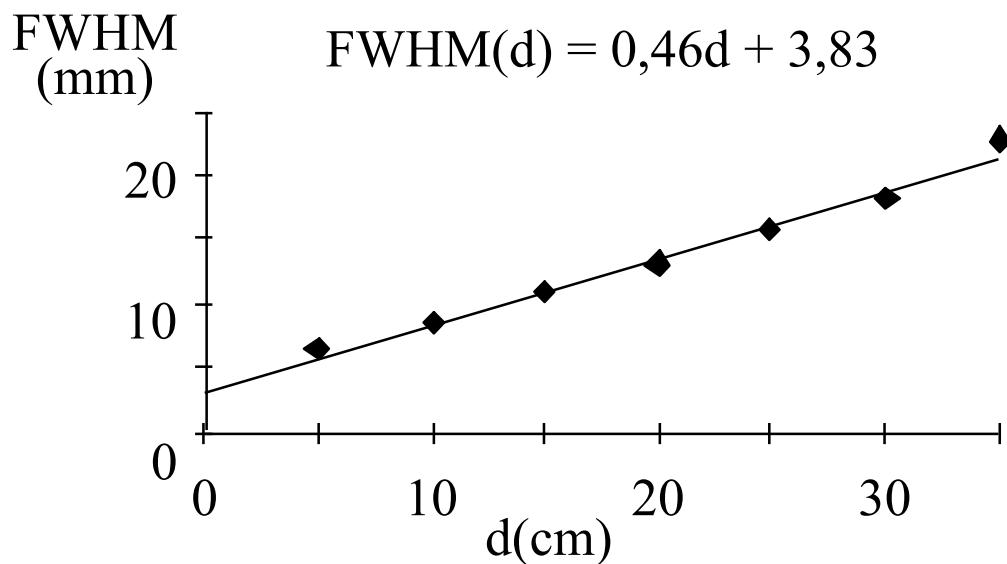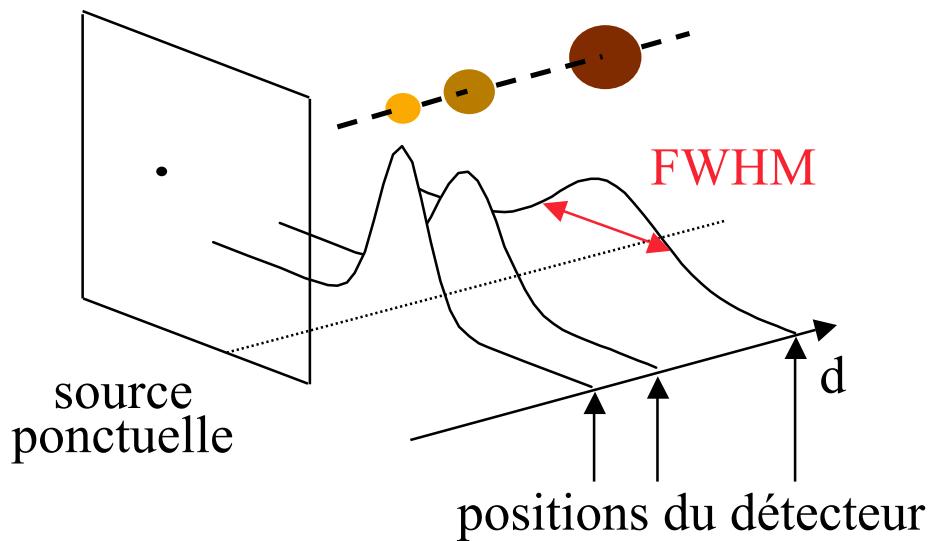

Picker PRISM 3000, colli // BE

- ⇒ distorsions dans les images tomographiques reconstruites : une sphère excentrée apparaît comme un ellipsoïde
- ⇒ résolution spatiale non stationnaire dans les images tomographiques reconstruites

Correction de résolution spatiale en SPECT




- Deux stratégies de correction
 - filtrage non stationnaire des projections avant reconstruction
 - modélisation de la fonction de réponse non stationnaire dans le projecteur utilisé pour la reconstruction tomographique



Correction par déconvolution non stationnaire



- Principe fréquence-distance

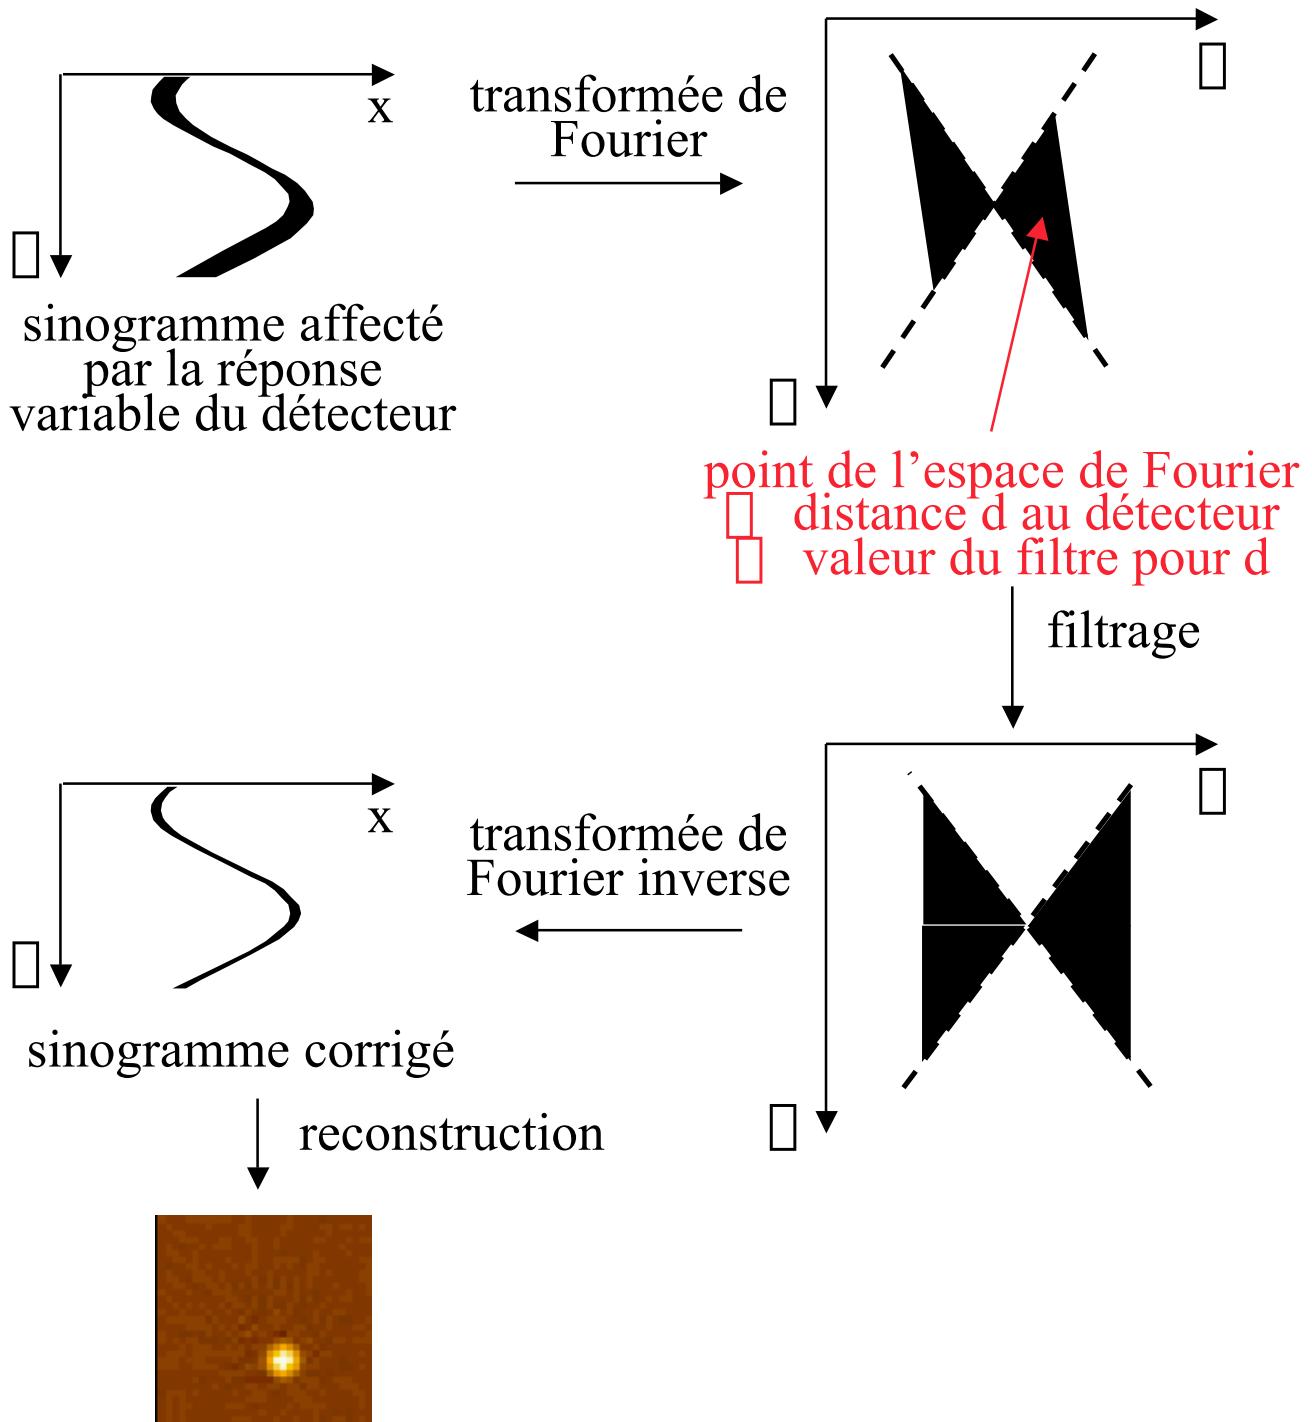

- ⇒ simple et rapide à mettre en oeuvre
- ⇒ filtre approximatif seulement

Modélisation lors de la reconstruction

- Modélisation de la fonction de réponse du détecteur dans le projecteur

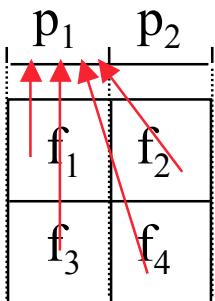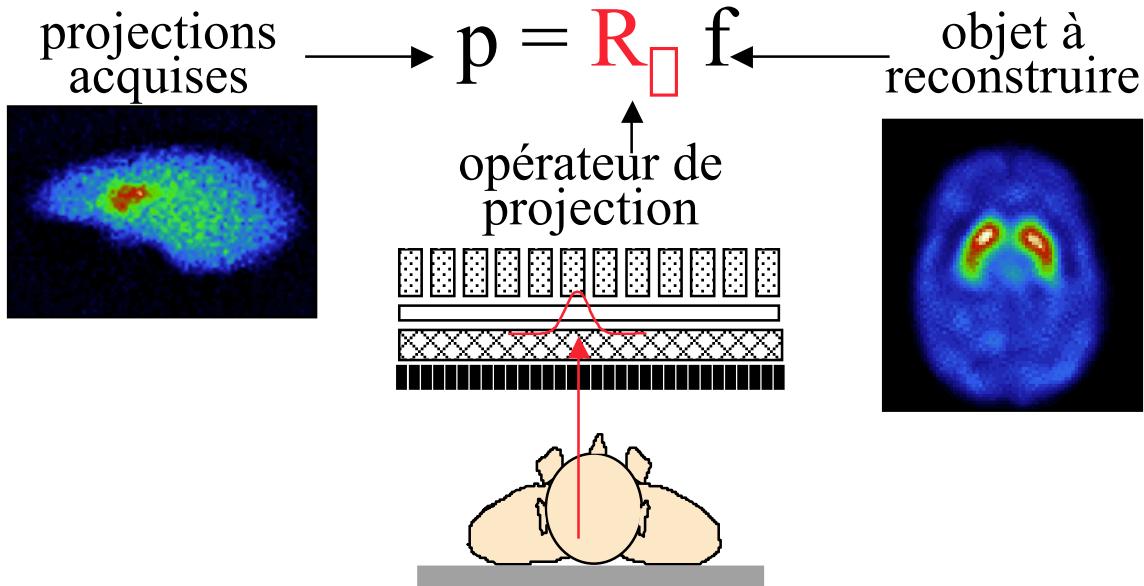

sans modélisation de la fonction de réponse de la caméra :

$$p_1 = r_{11} f_1 + r_{13} f_3$$



avec modélisation :

$$p_1 = r_{11} f_1 + r_{12} \mathbf{f}_2 + r_{13} f_3 + r_{14} \mathbf{f}_4$$


- modélisation analytique exacte possible

- Reconstruction itérative avec modélisation de la fonction de réponse dans le projecteur
 - ⇒ approche très générale adaptée à tous les algorithmes de reconstruction itérative
 - ⇒ calibration de FWHM(d)
 - ⇒ convergence modifiée





Illustration

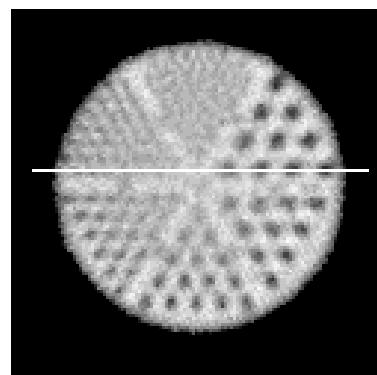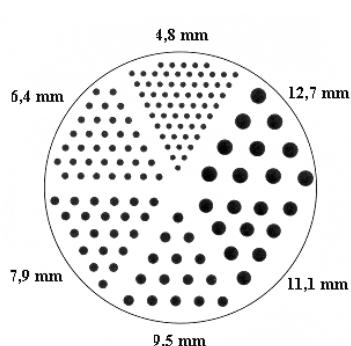

sans correction

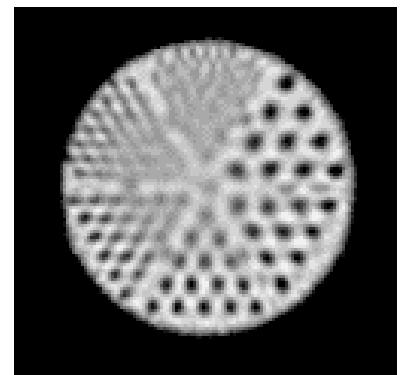

avec correction

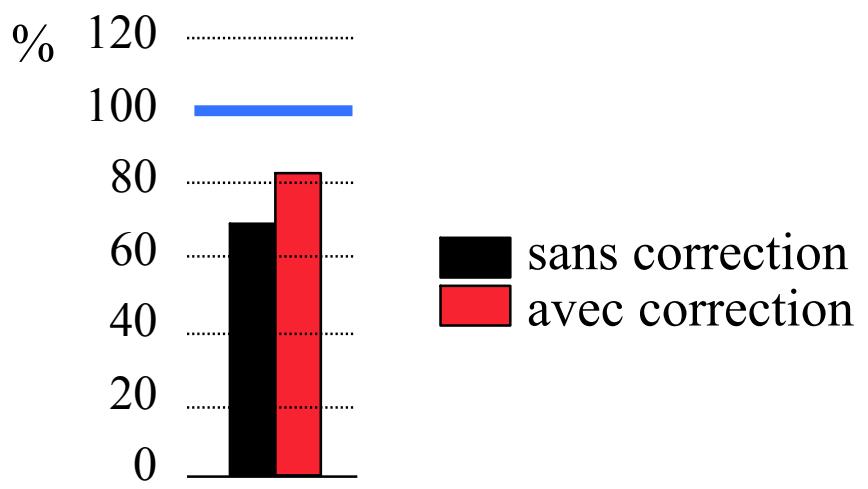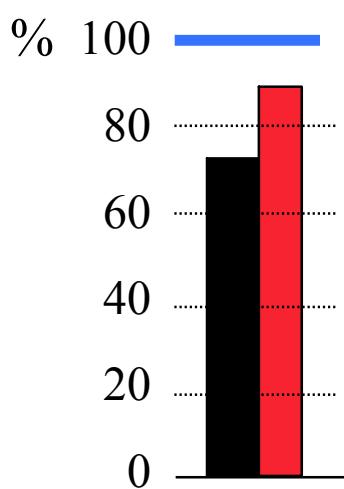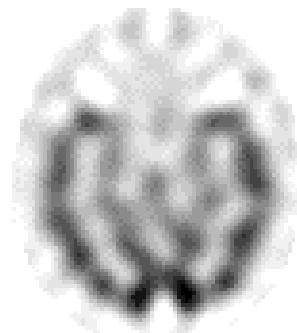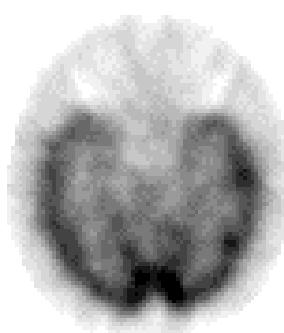


contraste entre paroi ventriculaire gauche (VG) et cavité VG (froide)


restauration d'activité dans la paroi VG (1 cm)

Correction de résolution spatiale en SPECT : synthèse

- Correction indispensable pour :
 - une meilleure résolution spatiale dans les images reconstruites
 - une amélioration du contraste dans les images reconstruites
 - une réduction des biais quantitatifs (réduction de l'effet de volume partiel)



sans correction




avec correction

- Pas de correction systématiquement appliquée en routine
- Deux méthodes “classiques” de correction
 - filtrage non stationnaire des projections
 - modélisation lors de la reconstruction tomographique
- Pas de consensus quant à la meilleure méthode de correction



Coïncidences fortuites en PET

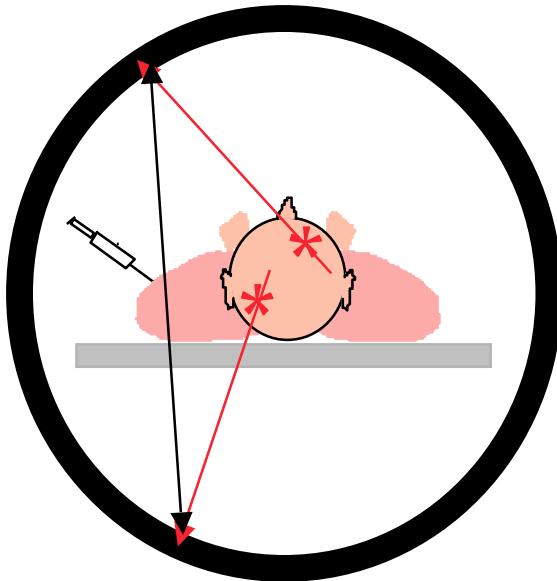

- Mauvaise localisation
 - Réduction des capacités de comptage
 - Biais quantitatif
- ⇒ Nécessite une correction systématique

Importance des coïncidences fortuites en PET

- Nombre de coïncidences fortuites

Nb d'événements simples
enregistré par le détecteur 1

$$N_{\text{random}} = 2 \int S_1 S_2$$

longueur de la fenêtre de coïncidence

⇒ proportionnel au carré de l'activité A vue par le détecteur

- Coïncidences vraies proportionnelles à l'activité A
⇒ (fortuits / vrais) proportionnel à A

- Réduction des coïncidences fortuites
 - par réduction de la fenêtre de coïncidence

⇒ une correction reste cependant nécessaire

Correction des fortuites en PET : stratégies




- Estimation du nombre de coïncidences fortuites $N_{\text{random}(i,j)}$ pour chaque ligne de coïncidence (i,j) : 2 approches possibles
- Soustraction du nombre de coïncidences fortuites $N_{\text{random}(i,j)}$ pour chaque ligne de coïncidence (i,j) avant reconstruction

Estimation via les événements non coïncidents

- Nombre de coïncidences fortuites pour une ligne de coïncidence entre les détecteurs 1 et 2 :



$$N_{\text{random } 1-2} = 2 \boxed{} S_1 S_2$$

↑
longueur de la fenêtre de coïncidence

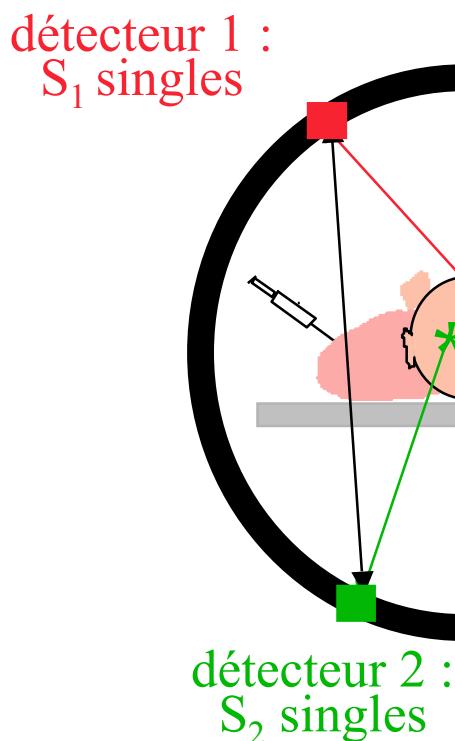

Estimation via une ligne retard

- Utilisation de deux circuits de coïncidences

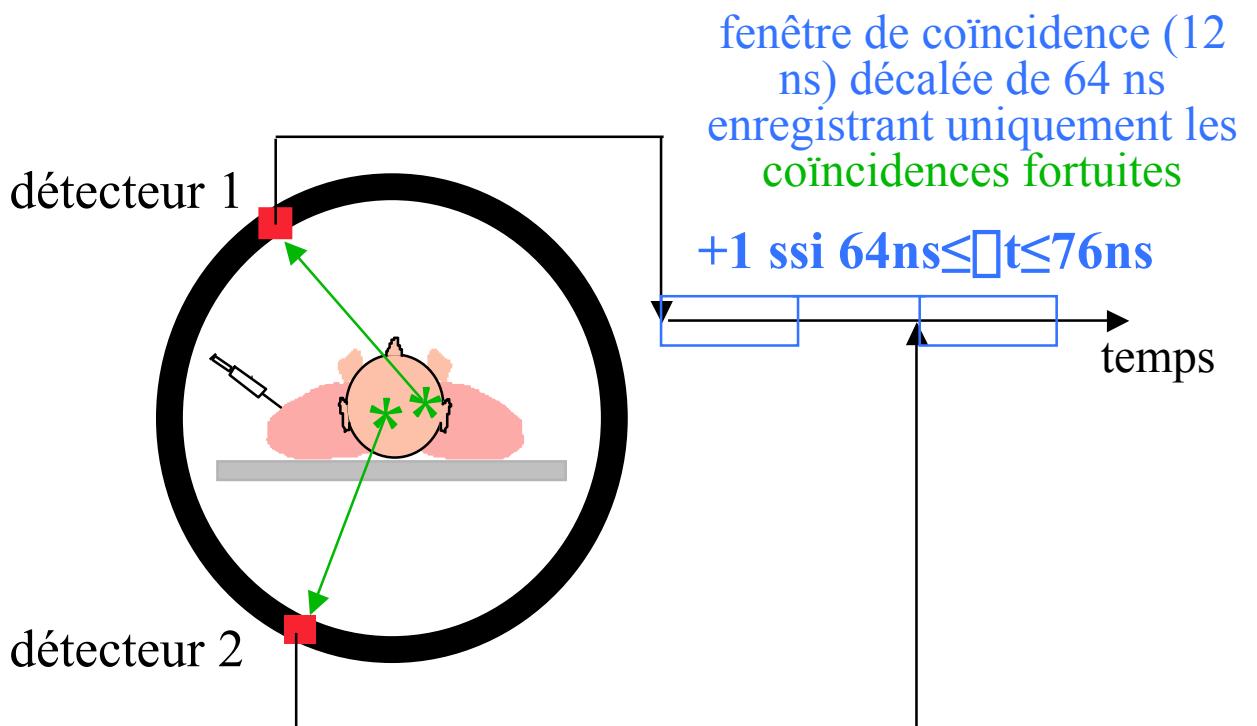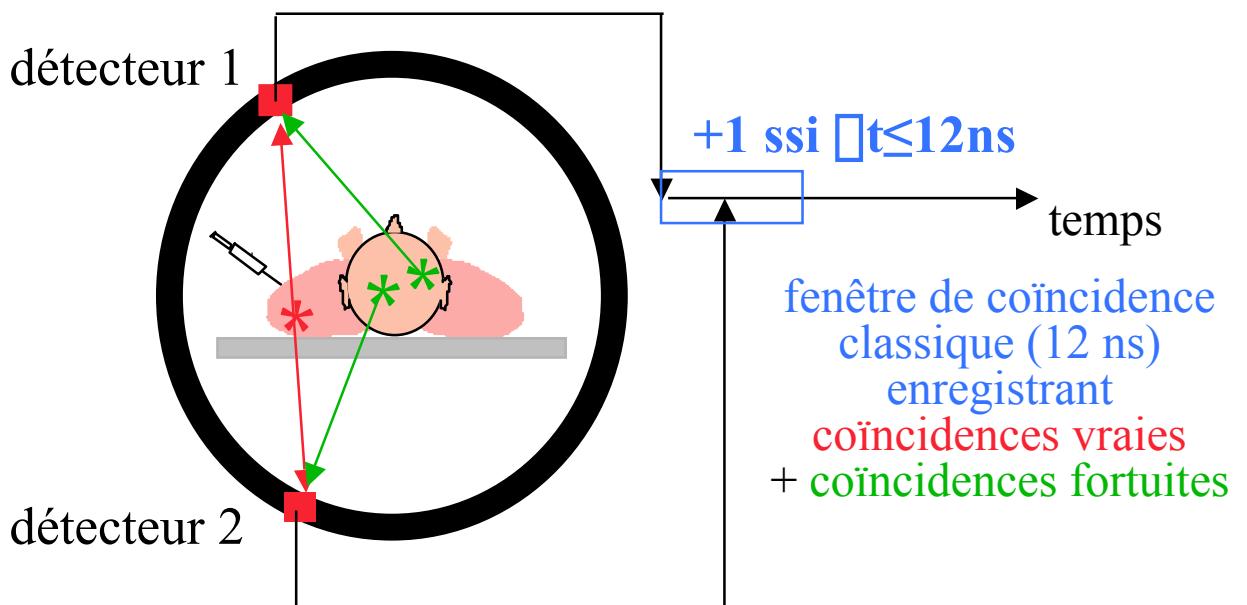

Coïncidences fortuites en PET : synthèse

- Correction systématique sur toutes les caméras, le plus souvent par une ligne retard
- Pourtant, nécessité de limiter le nombre de coïncidences fortuites, car :
 - sans coïncidences fortuites :

$$\square(\text{vraies} + \text{diffusées}) = \sqrt{(\text{vraies} + \text{diffusées})}$$



incertitude sur le nombre de coïncidences détectées

- avec coïncidences fortuites, après soustraction des coïncidences fortuites :

$$\square(\text{vraies} + \text{diffusées}) = \sqrt{(\text{vraies} + \text{diffusées} + 2 * \text{fortuites})}$$




Geluck

La détection de coïncidences fortuites augmente le bruit dans les images, même si on sait les soustraire !




Problème de normalisation en PET



- Tomographe PET « typique » : entre 10 000 et 20 000 cristaux détecteurs



blocs : 8x8 détecteurs

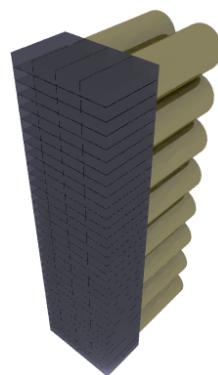


bucket = 256 détecteurs

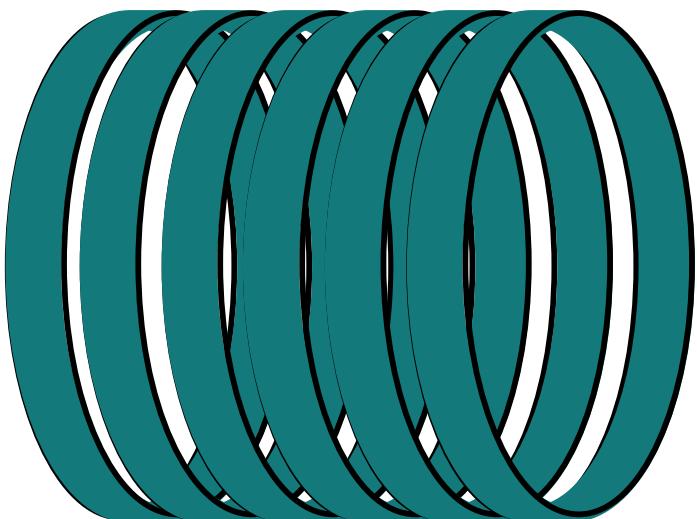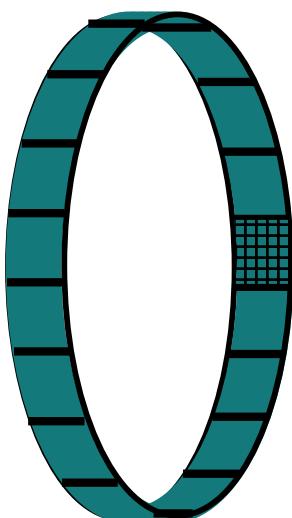

- Les cristaux peuvent être très légèrement différents en dimensions, ou fraction de la lumière de scintillation arrivant sur les tubes photomultiplicateurs, ou épaisseur du cristal vue par les photons incidents suivant l'angle d'incidence
→ réponses variables des différents cristaux détecteurs
- Correction de ces effets = normalisation

Méthode de normalisation

- Enregistrement de la réponse du tomographe lorsque celui ci est soumis à un flux de photons uniforme

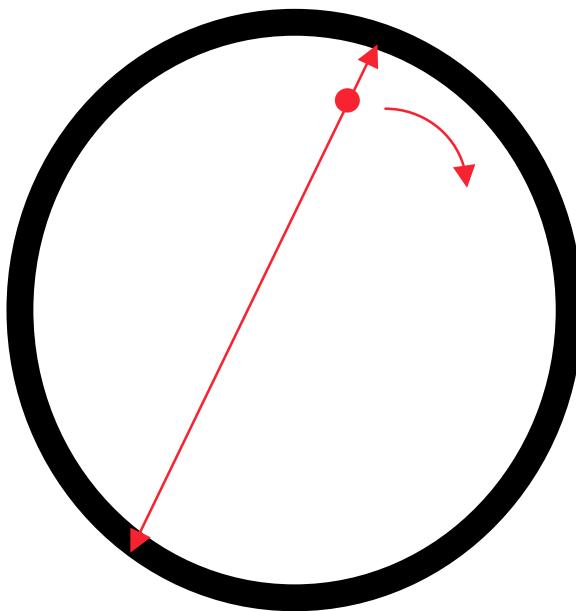


- Idéalement, toutes les LOR (i,j) devraient recevoir le même nombre d'événements N_{ij}
- Facteur de normalisation de la LOR (i,j) = N_{ij} / \bar{N} , où \bar{N} est la valeur moyenne de N_{ij} pour toutes les LOR
- Correction : pour chaque acquisition, le nombre de coups enregistrés sur la LOR (i,j) est divisé par le facteur de normalisation.

Vos questions



L'étalonnage

- Etape indispensable à la quantification absolue
- Permet de relier un nombre de coups par pixel à une concentration d'activité

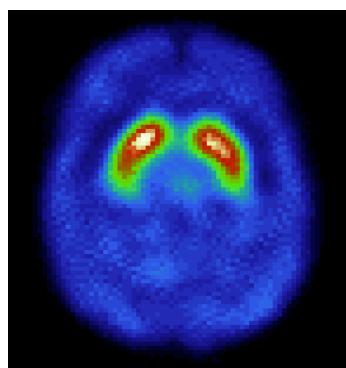


$$X \text{ coups/s/pixel} \xrightarrow{\text{Facteur d'étalonnage}} Y \text{ kBq/ml}$$

- Calcul du facteur d'étalonnage K par une expérience préliminaire au moyen d'une source (ponctuelle) d'activité connue, par $K = Y/X$
- Activité = $K \cdot X$



Temps mort

taux de comptage mesuré

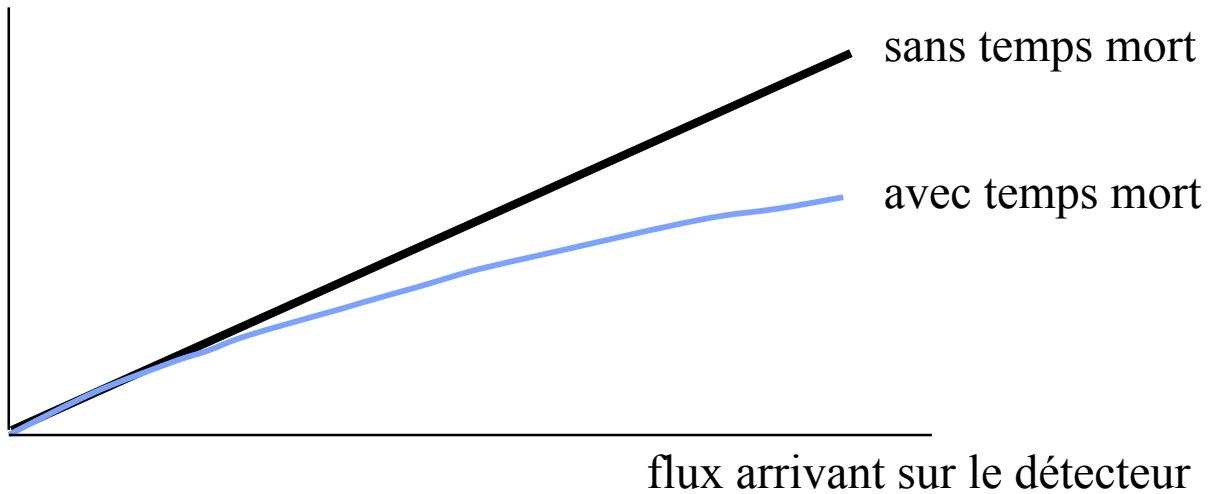


effet surtout pénalisant en TEP 3D (> 100 kcps/s)


- effectuer si possible les mesures dans la zone de flux correspondant à une réponse linéaire du détecteur
- effectuer l'étalonnage de sensibilité dans la zone de flux d'intérêt

Quantification en SPECT : synthèse


- Importance respective des différentes corrections
 - exemple de la quantification en SPECT cérébral

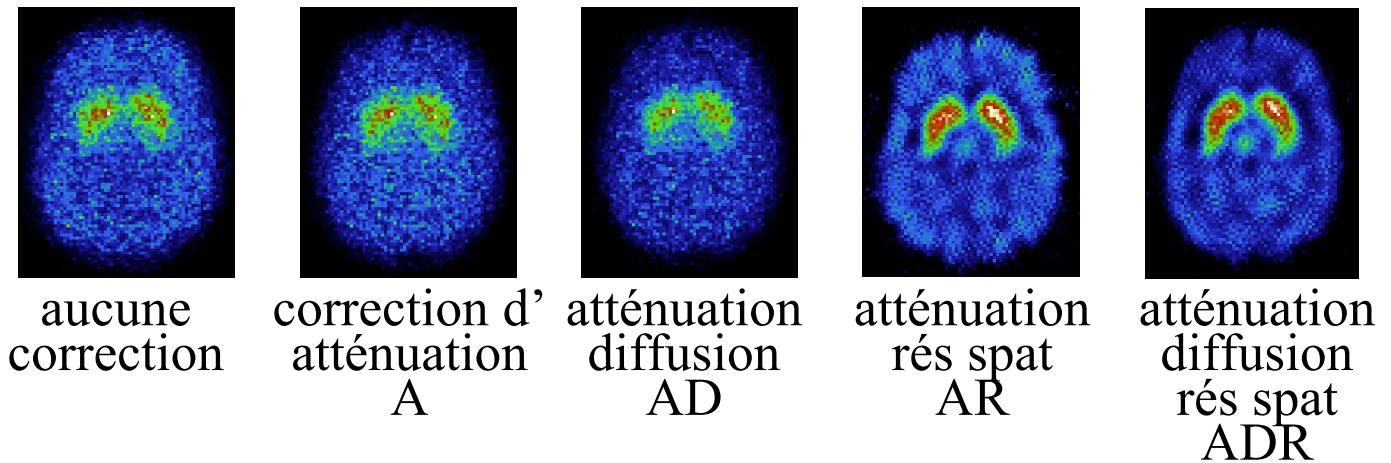

⇒ mesure du binding potential

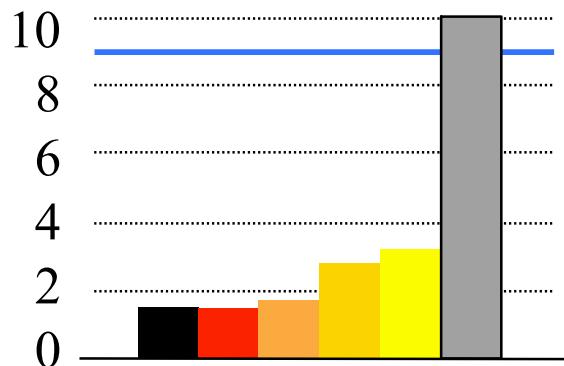


⇒ pourcentage de l'activité restaurée dans les putamens

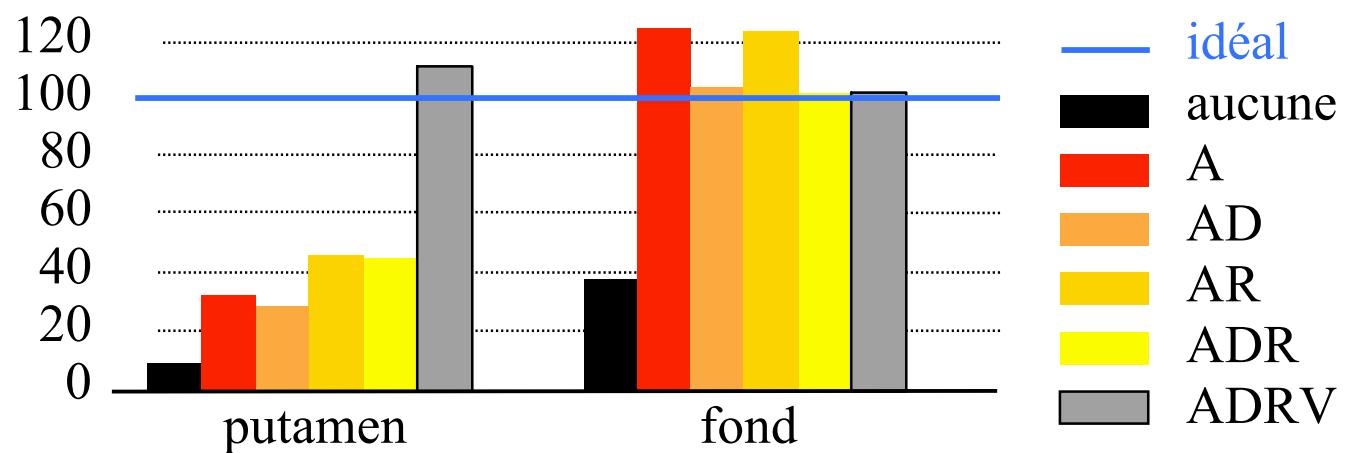



Intérêt clinique des corrections en SPECT

- Exemple de la neurotransmission dopaminergique

Mesure du potentiel de liaison

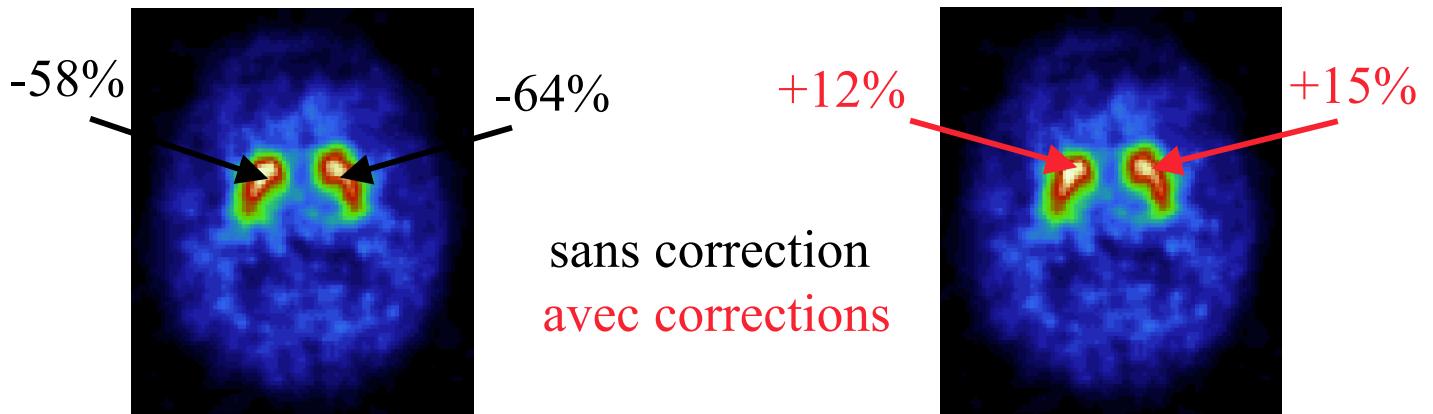

Diagnostic différentiel

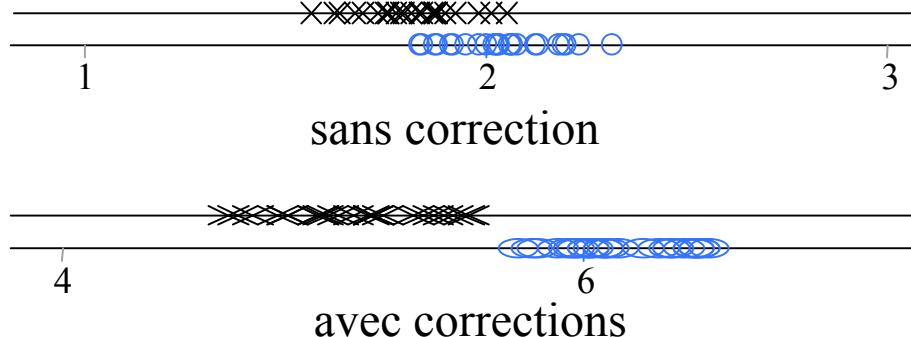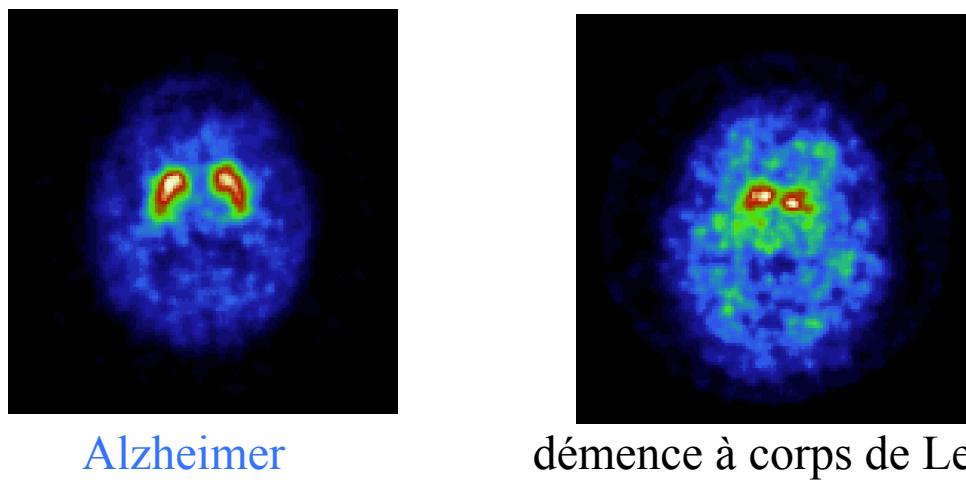

Soret et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006

DESMN : Quantification en tomographie d'émission - Irène Buvat - février 2006 - 109


Quantification en SPECT : synthèse

- Quantification absolue
 - correction d'atténuation indispensable
 - correction de diffusion nécessaire pour éviter une surestimation d'activité pouvant aller jusqu'à plus de 30%
 - correction de volume partiel indispensable pour éviter une sous-estimation de l'activité dans les structures de petites tailles (< 2-3 FWHM)
- Quantification relative
 - correction de diffusion parfois nécessaire pour réduire l'activité parasite dans les structures de fond
 - correction de volume partiel nécessaire si structures de petites tailles
- En pratique
 - corrections d'atténuation de plus en plus disponibles (modélisation dans un algorithme de reconstruction itératif)
 - corrections de diffusion et de résolution spatiale disponibles mais trop peu utilisées
 - correction de volume partiel non disponible et en développement

Quantification en PET : synthèse

- Quantification absolue
 - corrections d'atténuation et de coïncidences fortuites indispensables
 - correction de diffusion nécessaire en PET 3D
 - correction de volume partiel indispensable pour éviter une sous-estimation de l'activité dans les structures de petites tailles (< 2-3 FWHM)
- Quantification relative
 - correction de diffusion nécessaire en PET 3D pour réduire l'activité parasite dans les structures de fond
 - correction de volume partiel nécessaire si structures de petites tailles
- En pratique
 - correction de coïncidences fortuites systématique
 - correction d'atténuation quasi-systématique (en sus des images non corrigées)
 - correction de diffusion encore peu utilisée
 - correction de volume partiel non disponible en routine et utilisée seulement en recherche

Conclusion 1

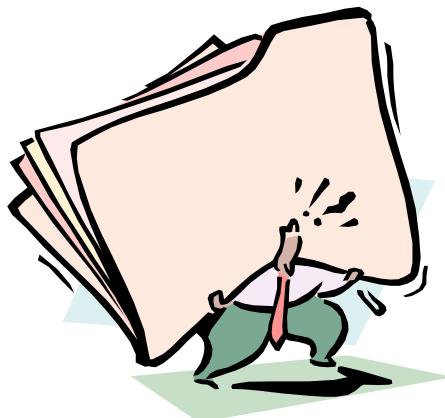

- La quantification est **accessible**, en PET et en SPECT
- Une quantification absolue fiable, en SPECT ou en PET, est un **processus complexe**, nécessitant une cartographie de la densité des tissus, un protocole d'acquisition et d'analyse rigoureusement contrôlé, et idéalement, une cartographie anatomique haute résolution
- La quantification fiable est **plus aisée en PET qu'en SPECT**, du fait de la correction d'atténuation plus accessible et de la meilleure résolution spatiale, **mais** reste **difficile** en PET
- Les **détecteurs bimodaux** PET/CT et SPECT/CT pourraient jouer un **rôle majeur** pour faire de la quantification une réalité clinique
- Les problèmes de **volume partiel** et de **mouvement** restent des **obstacles majeurs** à la quantification des structures de petites tailles


En pratique ?

- Il est indispensable d'évaluer la précision avec laquelle le protocole d'acquisition et de calcul des images estime les concentrations d'activité



Evaluation d'un protocole de quantification

- Calculer le facteur d'étalonnage

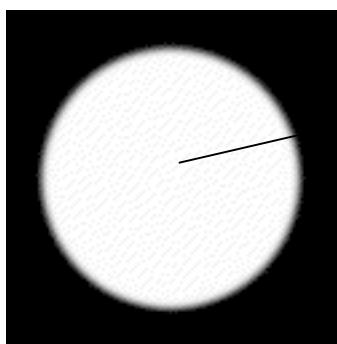

X coups/s/pixel




Y kBq/ml

$$C = Y/X$$

- Effectuer une acquisition sur fantôme




Fantôme NEMA / IEC 2000

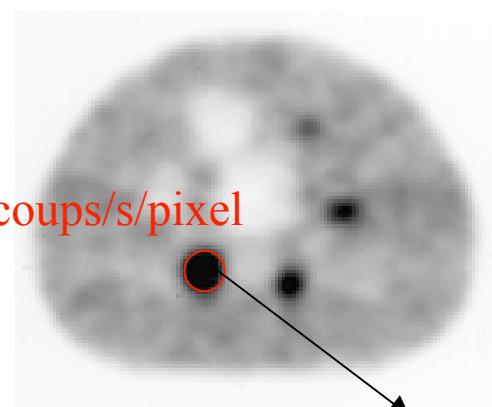

Z coups/s/pixel

activité = C.Z

Variabilité des mesures en fonction du protocole

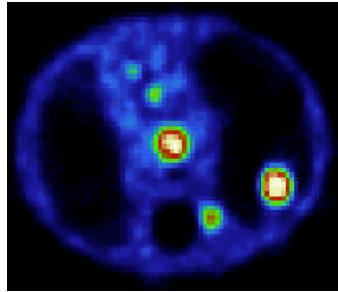

vrai rapport sphère/fond
= 8

- Mesures en conditions « standard »
 - Acquisition de 6 min
 - Correction d'atténuation à partir d'une acquisition de transmission au Cs137
 - Pas de correction de volume partiel
 - Mesure de SUV à partir du nombre de coups moyen dans une région anatomique


| | sphères pulmonaires diamètre (en mm) | | | |
|---------------------|---|-----|-----|-----|
| | 10.5 | 16 | 22 | 33 |
| rapport tumeur/fond | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 3.5 |

- Mesures dans différentes conditions
 - Acquisition de 18 min
 - Correction d'atténuation à partir d'un CT
 - Correction de volume partiel
 - Mesure de SUV à partir du max

| | sphères pulmonaires diamètre (en mm) | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|
| | 10.5 | 16 | 22 | 33 |
| acqui 18 min | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 3.7 |
| corr. atténuation CT | 0.7 | 2 | 2.8 | 3.7 |
| corr. volume partiel | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| SUVmax | 0.6 | 2.3 | 4.1 | 6.3 |

Variabilité des mesures en fonction du protocole

- Différentes façons de tracer les régions

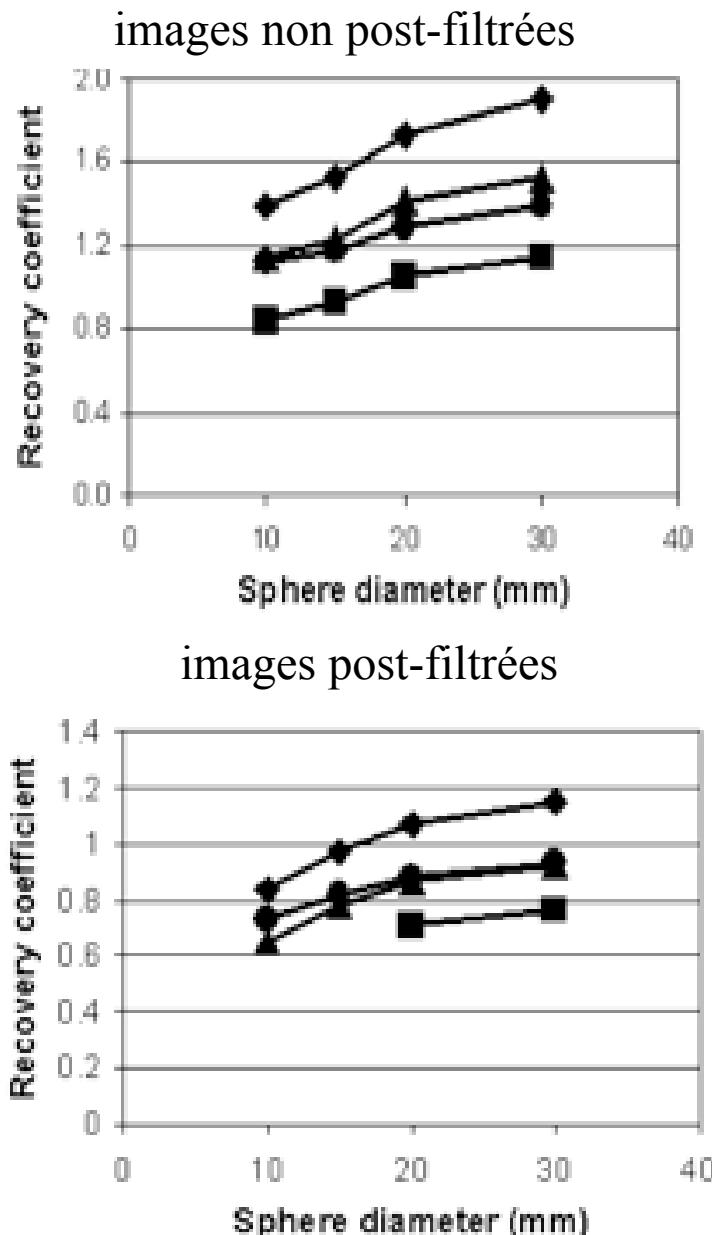


- max dans la région
- isocontour 70% du max
- isocontour intermédiaire max/fond
- isocontour 50% du max

Boellaard et al, J Nucl Med 2004:1519-1527


DESMN : Quantification en tomographie d'émission - Irène Buvat - février 2006 - 116

Conclusion 2

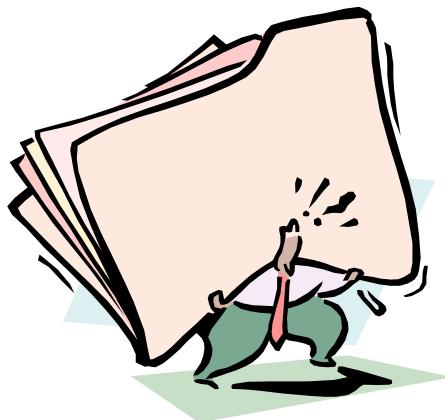

- La qualité de la quantification dépend fortement du protocole d'acquisition et de traitement utilisé
- Des méta-analyses sont actuellement impossibles
- Suivi thérapeutique faisable en conditions très standardisées

Conclusion 2

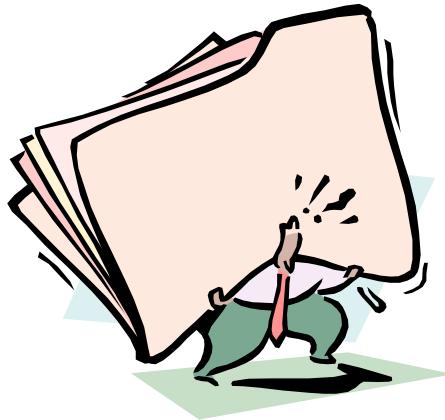

The SUV depended strongly on all studied parameters, and it can only be used for diagnostic purposes when data acquisition and processing are performed in a standardized way. This might be a problem for multicenter studies.


Boellaard et al, J Nucl Med 2004:1519-1527

Biases in SUV estimates slightly depend on the emission scan duration but strongly depend on the \square map used for attenuation correction, on whether PVE is corrected for and on whether SUV is calculated using the average count value within the tumor VOI or using the maximum value at the tumor location. Differences in SUV estimates greater than 100% (i.e., by a factor greater than 2) can be caused only by differences in the way data are acquired and processed, which suggest that comparison of SUV between PET centers using different scanning and processing protocols is almost impossible.

Feuillardent et al, IEEE Trans Nucl Sci 2005

Au delà de la mesure d'une concentration d'activité


- Exploiter les mesures de concentration pour estimer des paramètres PHYSIOLOGIQUES caractérisant les processus étudiés

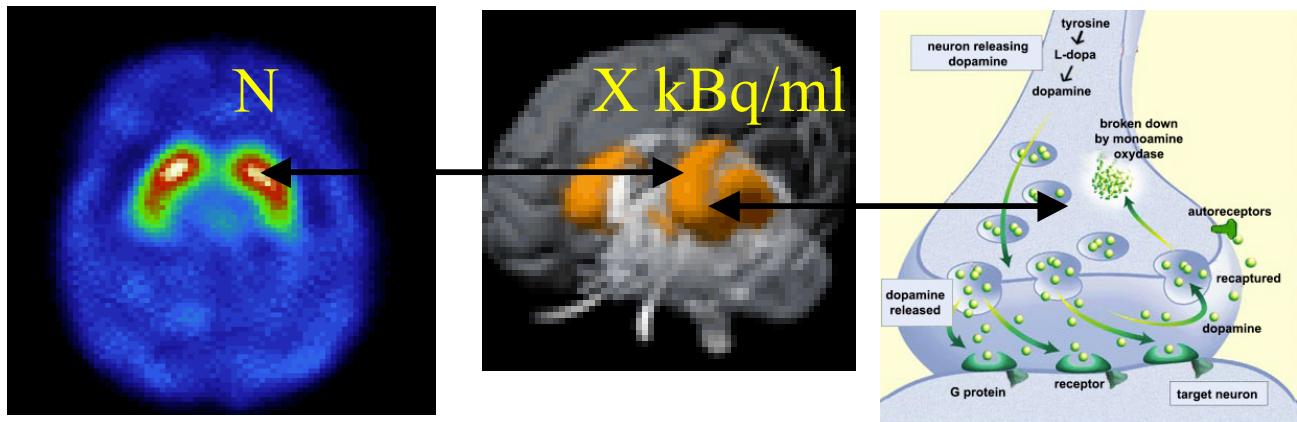


- Exemple : concentration de radiotraceur dans les striata pour déterminer la densité de transporteurs dopaminergiques

La modélisation

Principe de l'estimation de paramètres physiologiques

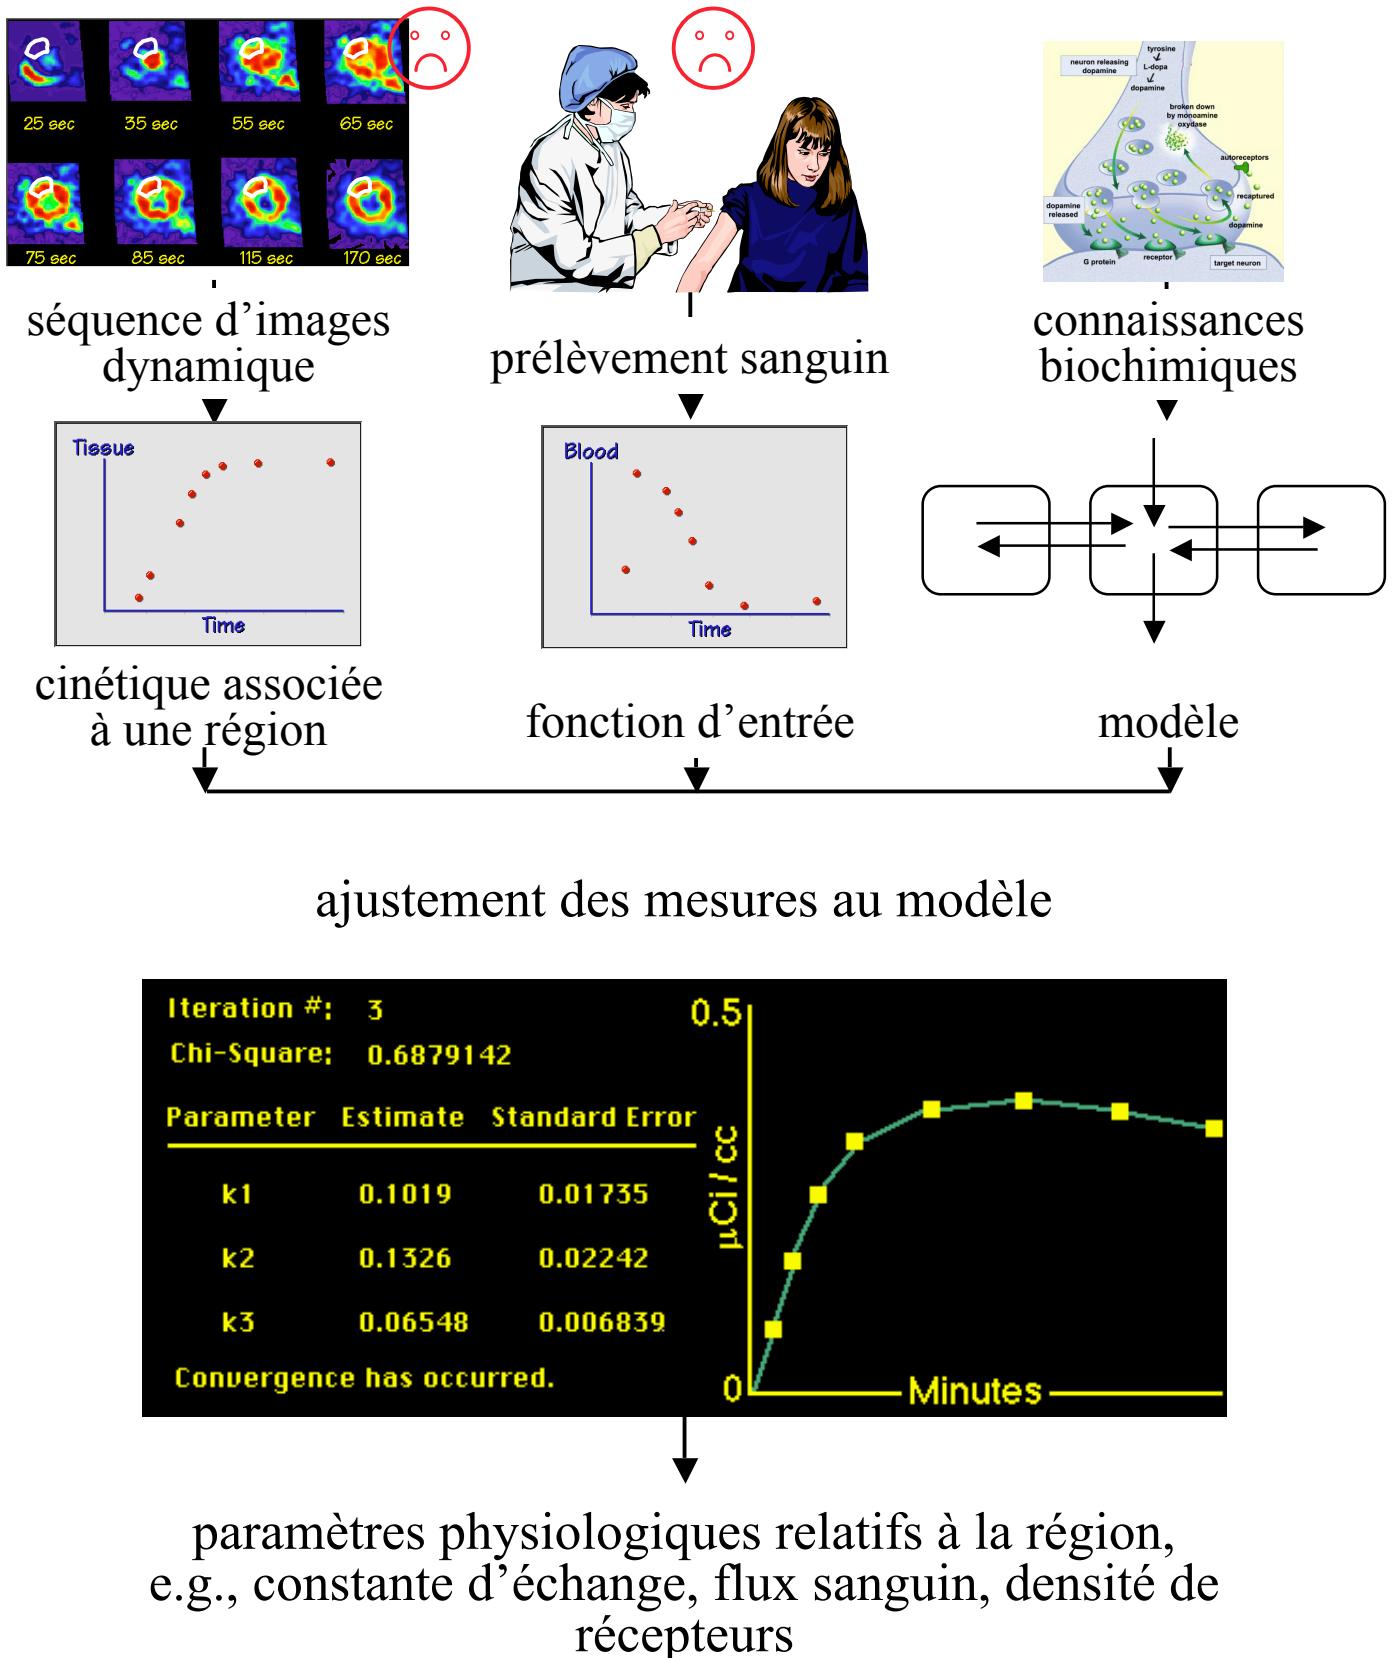



Conclusion 3

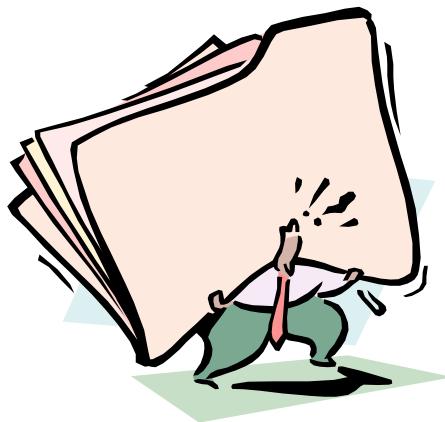

Il existe plusieurs méthodes permettant d'extraire des informations physiologiques à partir d'images quantifiées, présentant différents compromis « qualité - complexité »

Exemple typique : le SUV utilisé pour le PET-FDG

Exemple : métabolisme du glucose

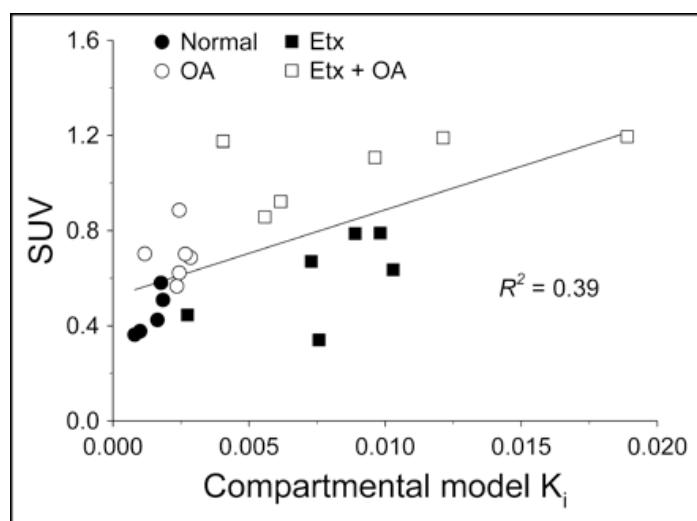
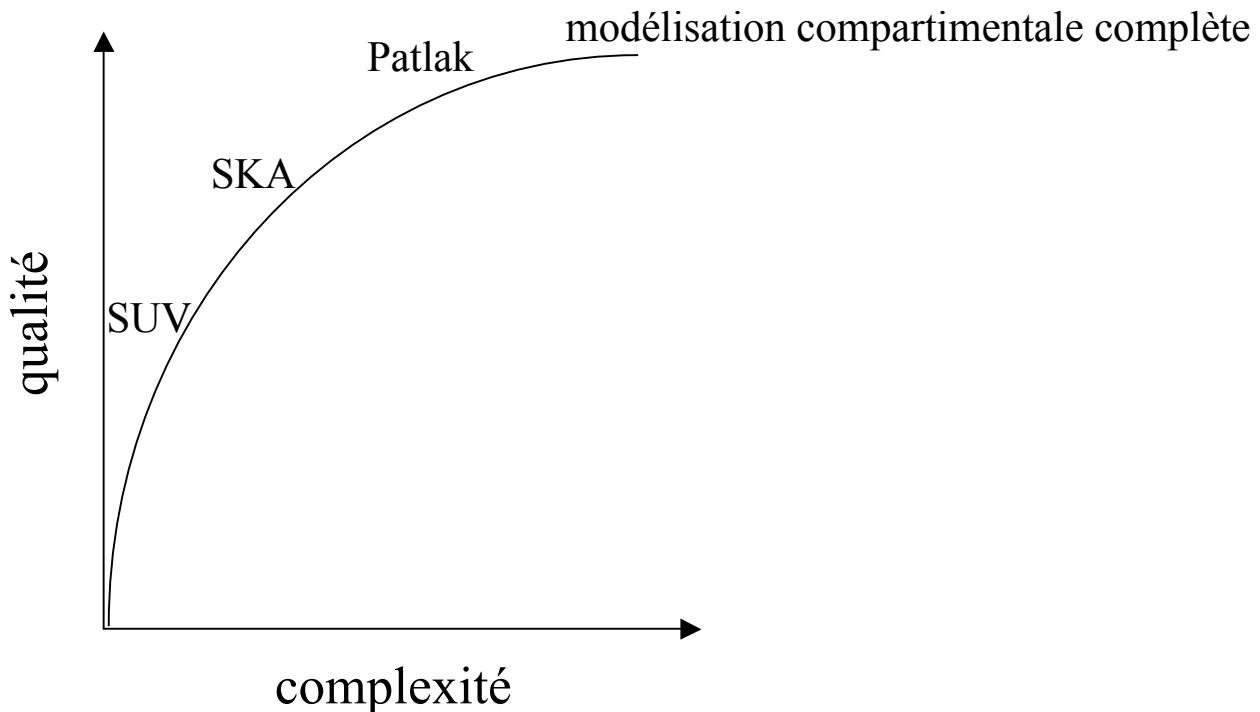


Chen et al, J Nucl Med 2004:1583-1590

Et enfin ...

Les limites du traceur


- Le métabolisme du FDG ne représente pas exactement le métabolisme du glucose

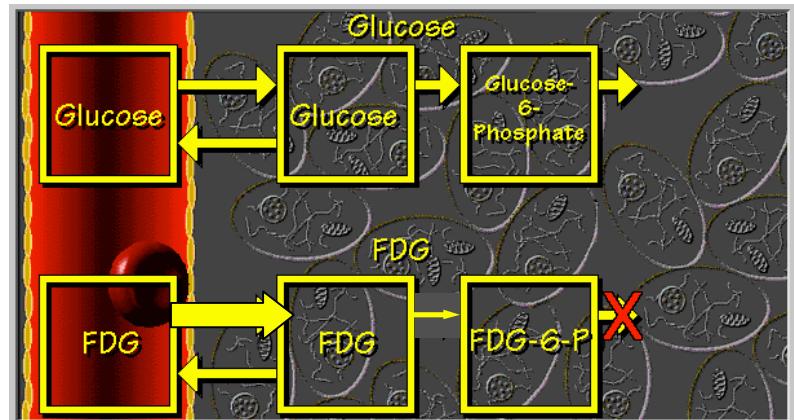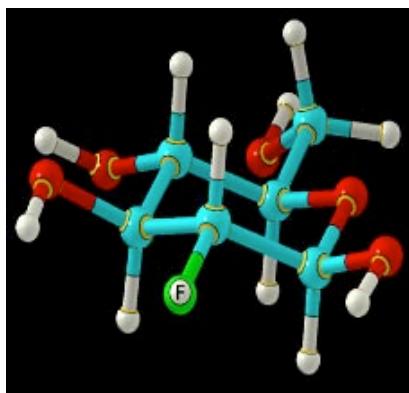

- FDG parfois transporté à travers les membranes cellulaires plus facilement que le glucose
- FDG moins facilement phosphorilé que le glucose une fois dans la cellule

« lumped constant » (supposée égale à 1 par défaut) : est-elle vraiment constante ? (sous thérapie notamment)

Fin

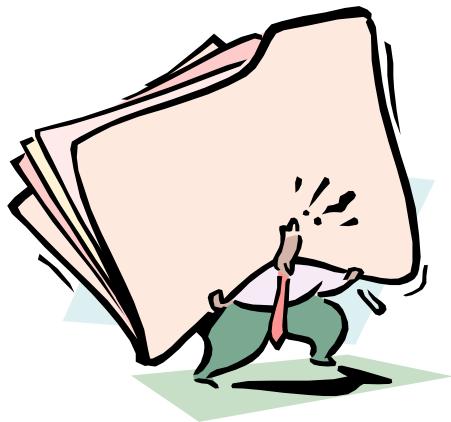

Ressources disponibles sur <http://www.guillemet.org/irene>