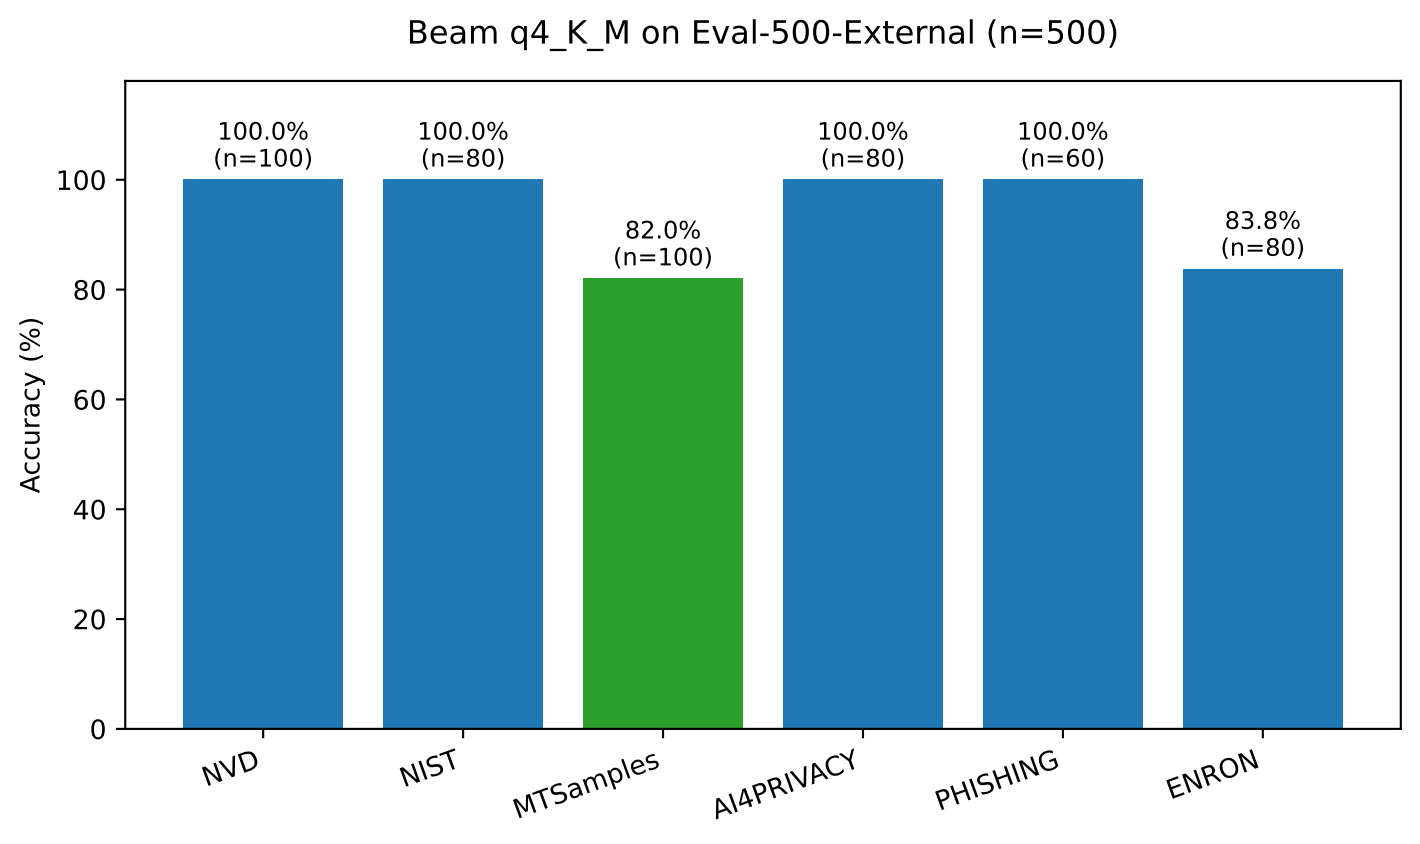
Beam q4_K_M on Eval-500-External (n=500)
Accuracy (%)
0
20
40
60
80
100
100.0%
(n=100)
100.0%
(n=80)
82.0%
(n=100)
100.0%
(n=80)
100.0%
(n=60)
83.8%
(n=80)
NVD
NIST
MTSamples
AI4PRIVACY
PHISHING
ENRON