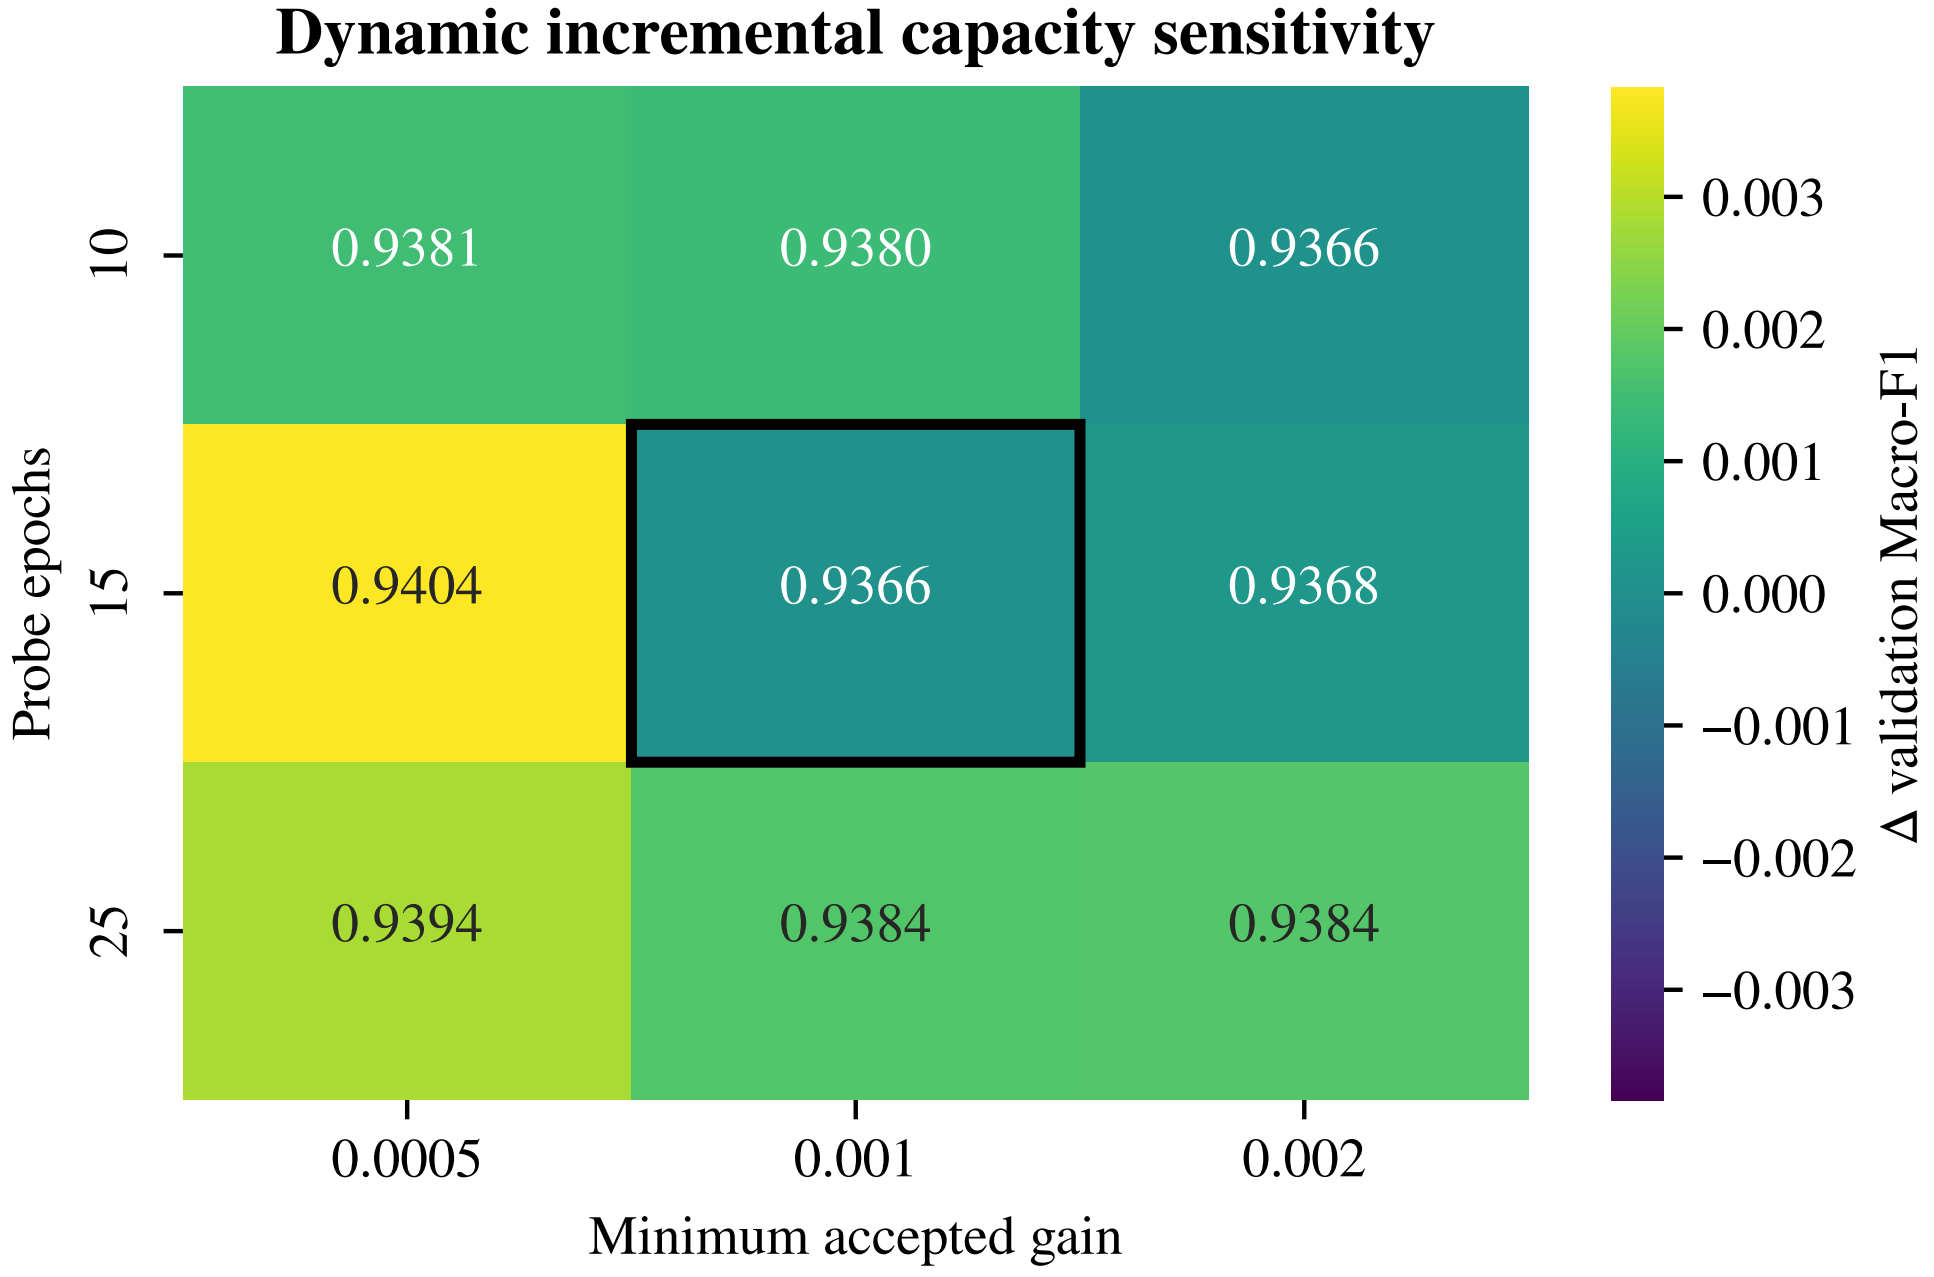
Dynamic incremental capacity sensitivity
Probe epochs
10
15
25
0.9381
0.9380
0.9366
0.9404
0.9366
0.9368
0.9394
0.9384
0.9384
0.0005
0.001
0.002
Minimum accepted gain
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
Δ validation Macro-F1