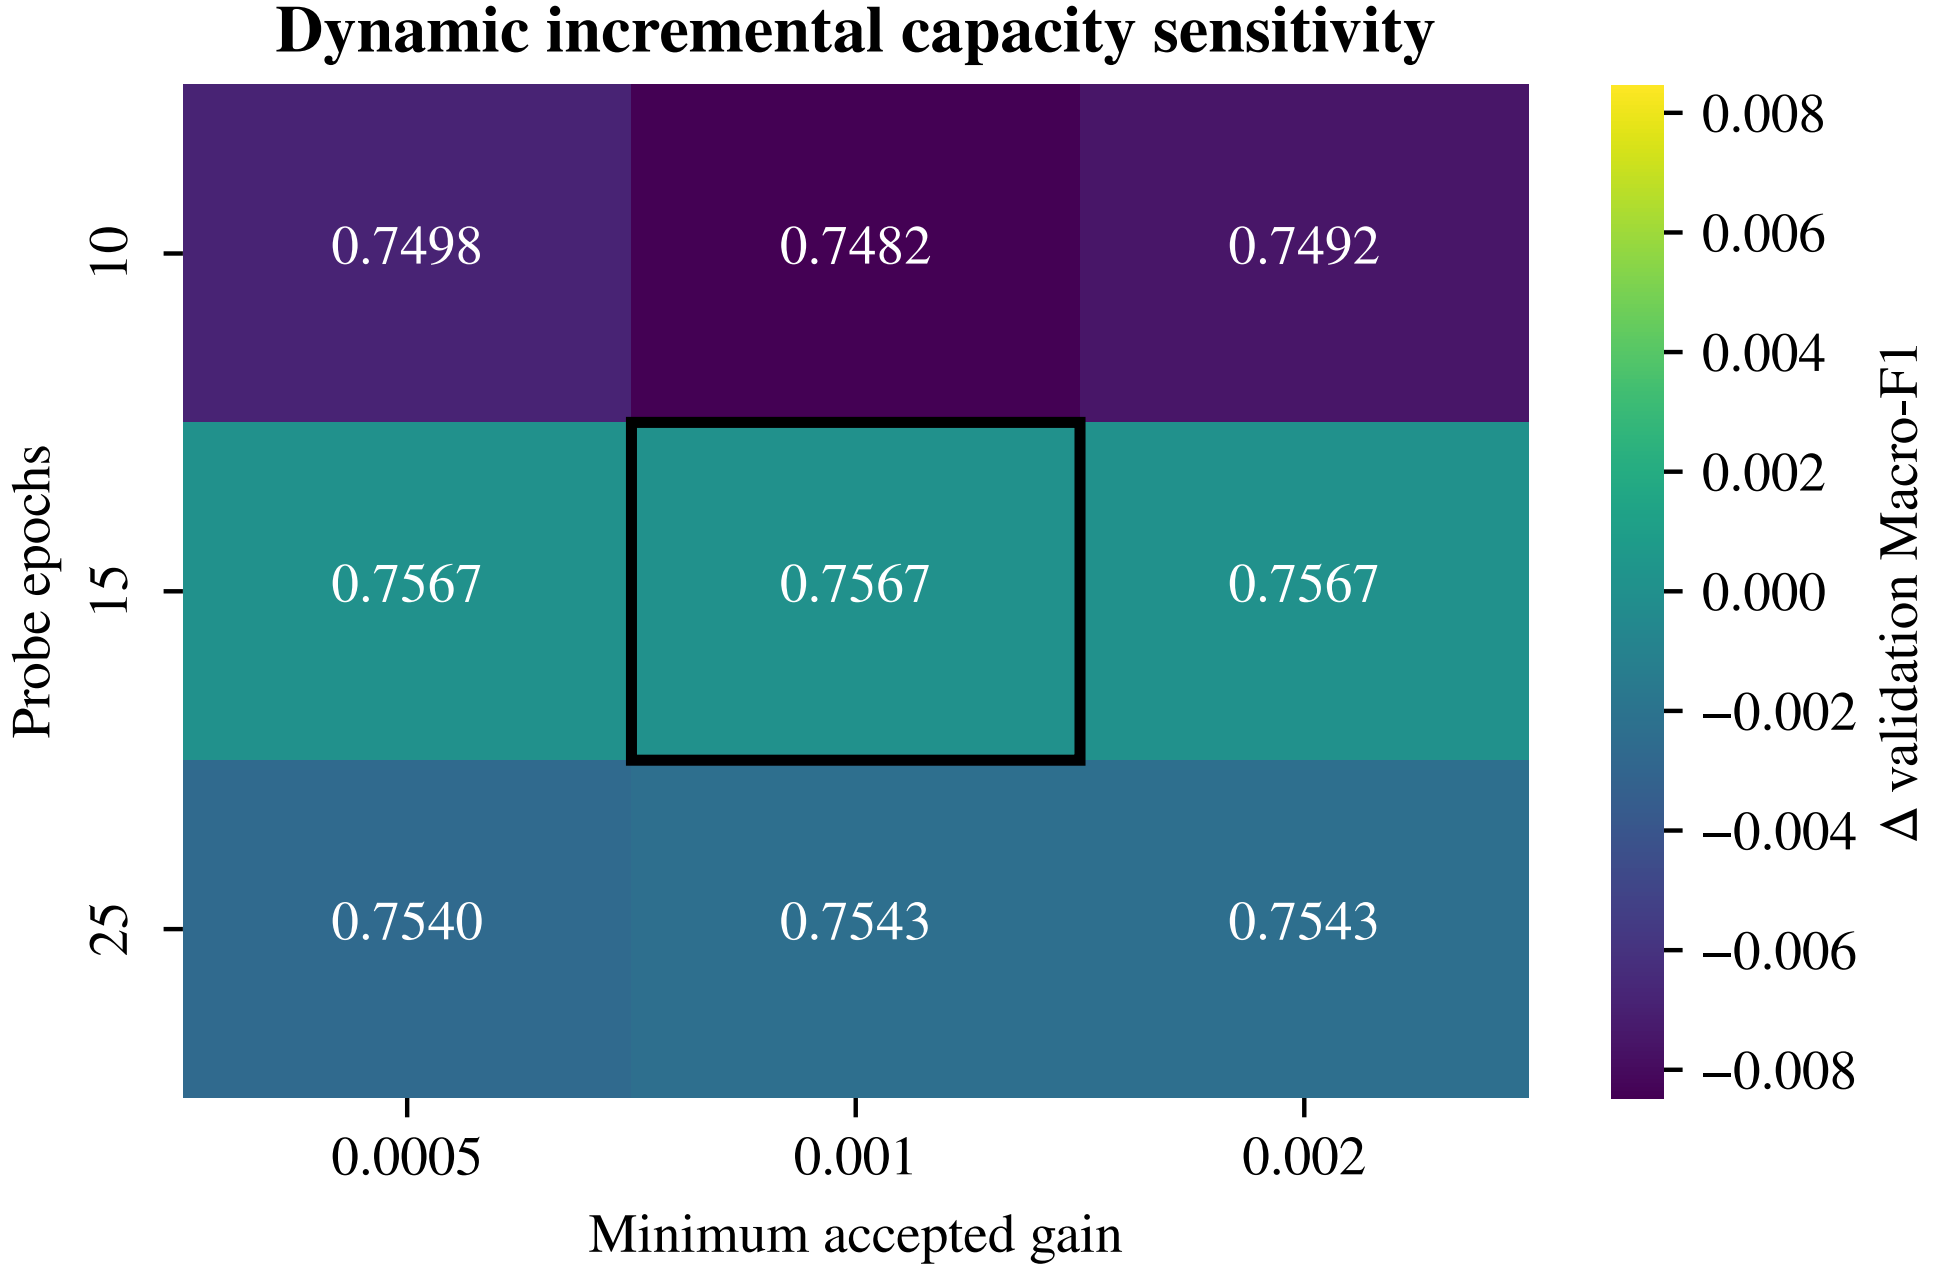
Dynamic incremental capacity sensitivity
Probe epochs
10
15
25
0.7498
0.7482
0.7492
0.7567
0.7567
0.7567
0.7540
0.7543
0.7543
0.0005
0.001
0.002
Minimum accepted gain
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
Δ validation Macro-F1