GMS 软件使用指导

1、 驱动安装

打开以下网址:

R&S®VISA | Rohde & Schwarz (rohde-schwarz.com)

选择下图红色框安装驱动:

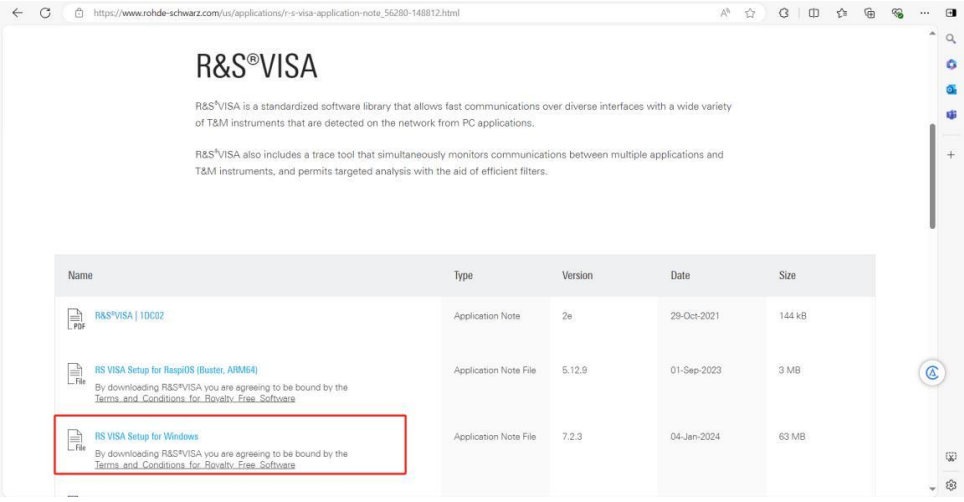

2、 GMS 软件安装

GMS 软件一般用于实验室或者研发阶段，打开以下网址直接下载并安装:
https://santec.imgix.net/Files/Software/GMS-Installer-4.1.3.1.exe

3、 设备搭建

3.1 RLM 仪器单独使用场景

背面板连线

3.2 RLM 和 OSX 搭配使用场景

背面板连线

4、 GMS 软件操作

4.1 打开仪器

确定 RLM 和 OSX 背面板的电源开关（3、设备搭建的两个图中红色框圈出的位置）在“off”状态（即 O 被按下），分别给 RLM 和 OSX 接上电源线，然后打开设备（即上图中红色框中按钮 I 被按下）。注意：为了测量的准确性，RLM(SM 单模)仪器需要预热至少 30 分钟，RLM(MM 多模) 仪器需要预热至少 60 分钟。

4.2 打开软件

双击下面按钮打开 GMS 软件。

4.3 仪器设定

点击左上角设置，在下拉菜单中选择第一个仪器设定。

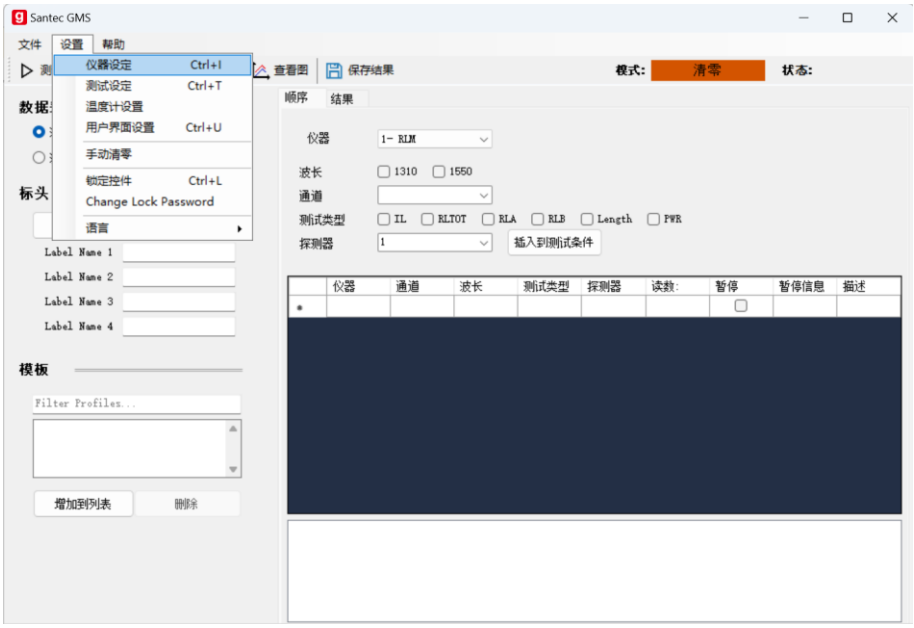

选择仪器和通讯端口，然后点击“自动选择”按钮来建立连接；弹出对话框显示选择了 USB 连接，点击确定。

然后点击“测试端口”检查连接是否建立，弹出的对话框“端口处于激活状态”代表 USB 连接已经建立，点击确定。

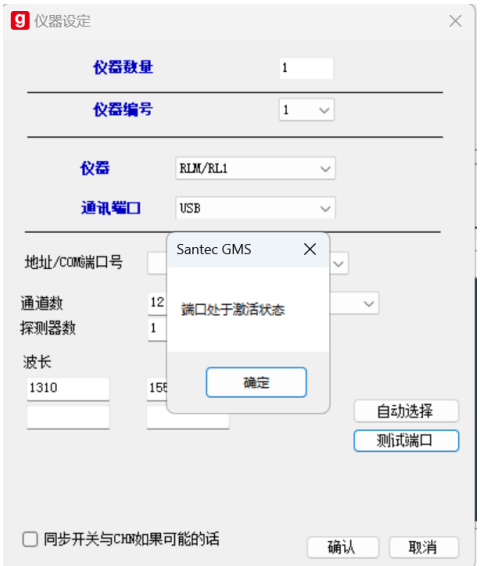

弹出的对话框点击“是”，将自动检测仪器的波长。

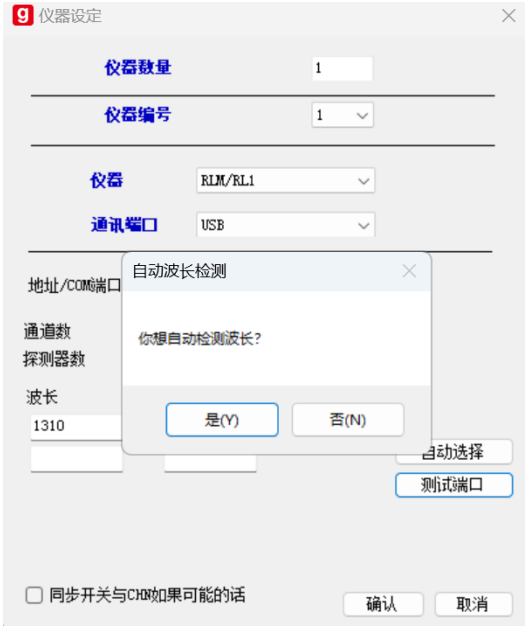

4.4 测试设定

点击左上角设置，在下拉菜单中选择第二个测试设定。

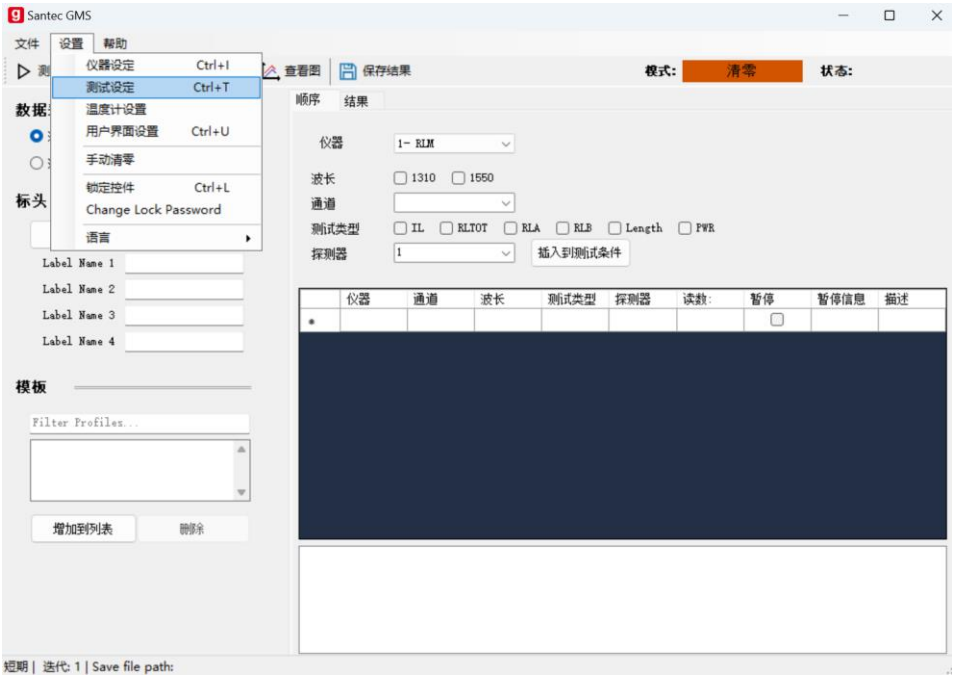

在测试格式里，设备类型已默认无需选择，根据需要分别选择测试界面第一列到第四列的显示类型。

如果需要循环或者持续测试，可以在测试长度里设置相关的条件。

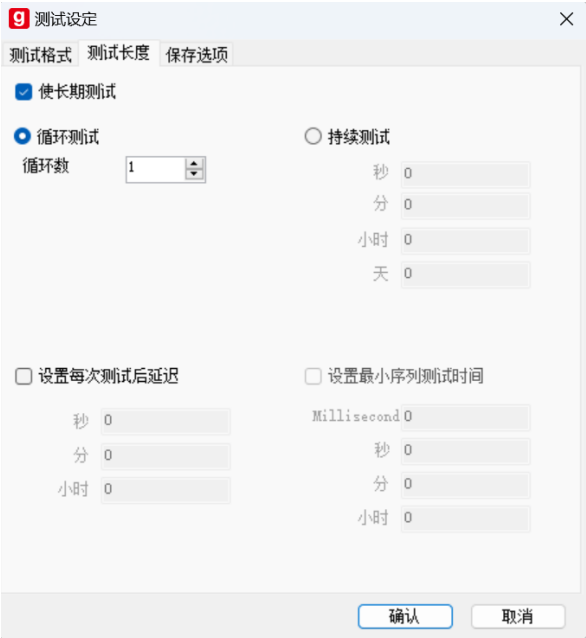

最后可以在保存选项中对相应的长期试验、短期测试（即每次测试一次）和 Additional Save Format 进行设定。

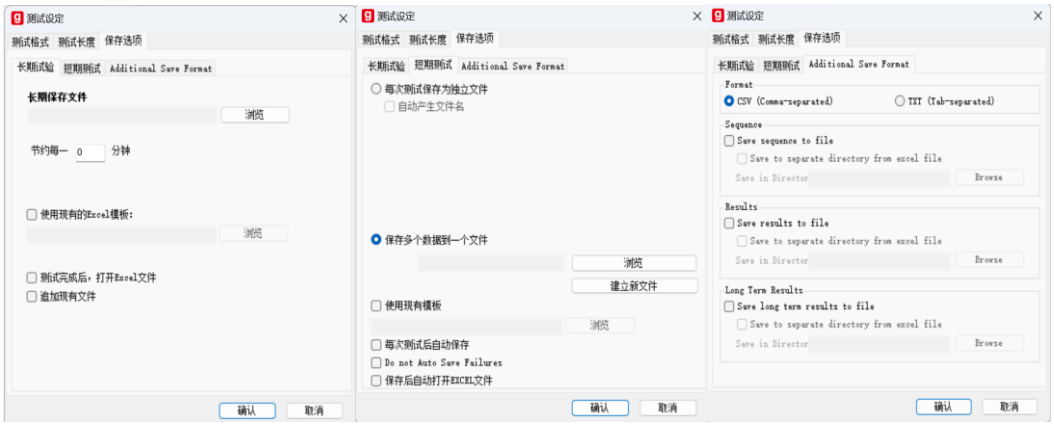

4.5 清零

首先按照所测产品的类型参照本文档的第 6 部分（6、清零的前面板连线）相应的清零类型搭建前面板连线。

在下面的软件界面中，首先选择左边红框中“清零”，然后在右边红框“顺序”下面选择相应的仪器，波长，通道，测试类型（请注意清零只需对 IL 进行，RL 无需清零）和探测器。

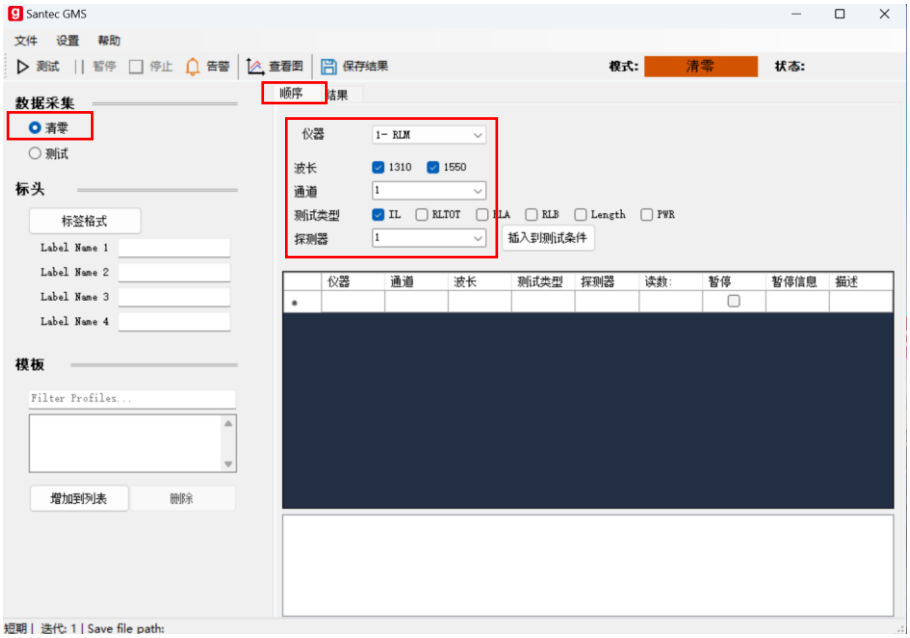

选择完成后，点击“插入到测试条件”后，相应通道的测试条件显示在下方（如右图蓝色框显示）。

“通道“的下拉菜单中有多个通道可供选择（如下左图显示），对于每个需要清零的通道，先选择对应的通道号，然后确认其他选项无误后点击“插入到测试条件”，下面右图示例 5 个通道被选择进行清零。

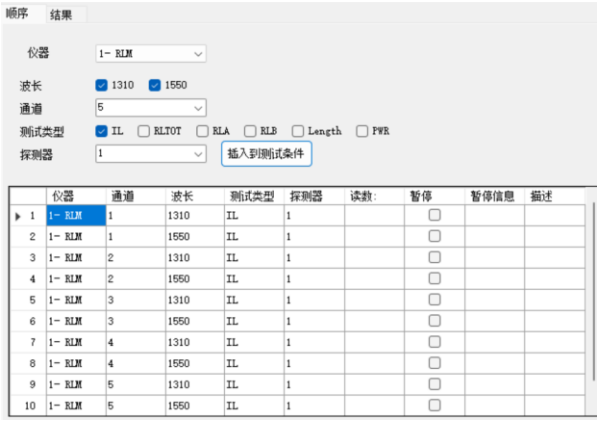

最后点击下图左上角红框中“测试”按钮进行清零。

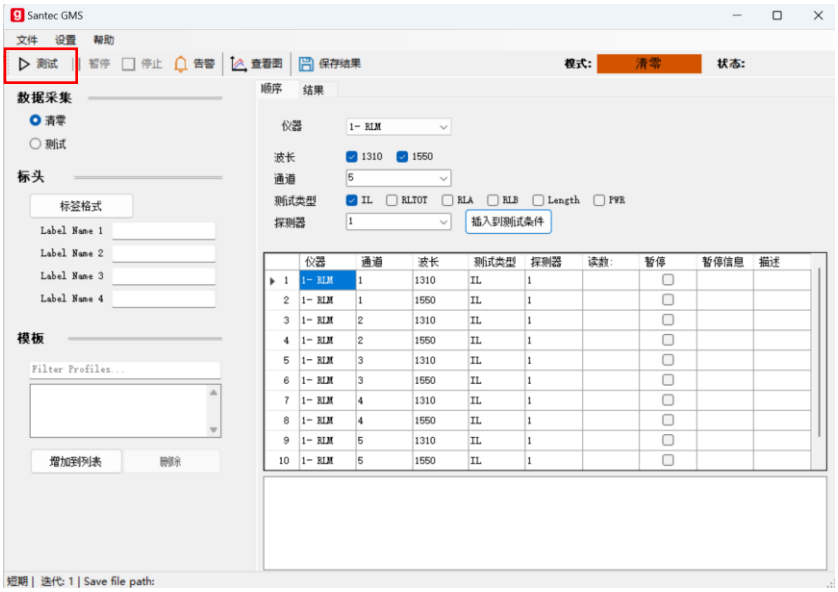

清零完成后，在弹出的对话框中选择“确认”。

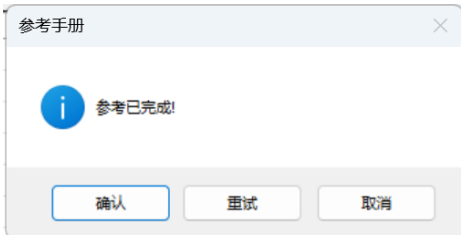

4.6 测试

清零完成后，软件会自动进入测试界面，如下图自动“测试”按钮自动被选中。

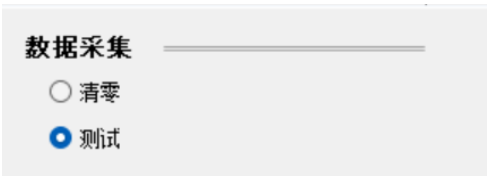

按照所测产品的类型参照本文档的第 7 部分（7、测试的前面板连线）相应的测试类型搭建前面板连线。

在加入测试条件之前，先清楚下面左图中清零的测试条件，点击每个项目前面的数字后，点击键盘 Delete 按钮对每个项目进行删除；如需批量删除，可以先点击第一条，然后按住 Shift 键的同时选择最后一条，如下右图所示，最后点击键盘 Delete 按钮对选中的所有测试项目进行删除。

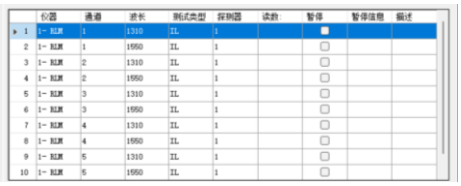

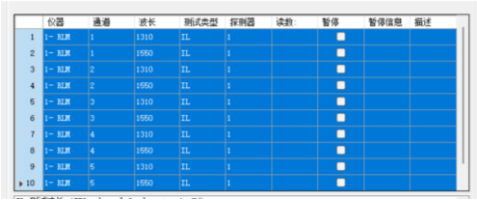

按照测试需求，将需要测试的项目依次加入插入到测试条件。

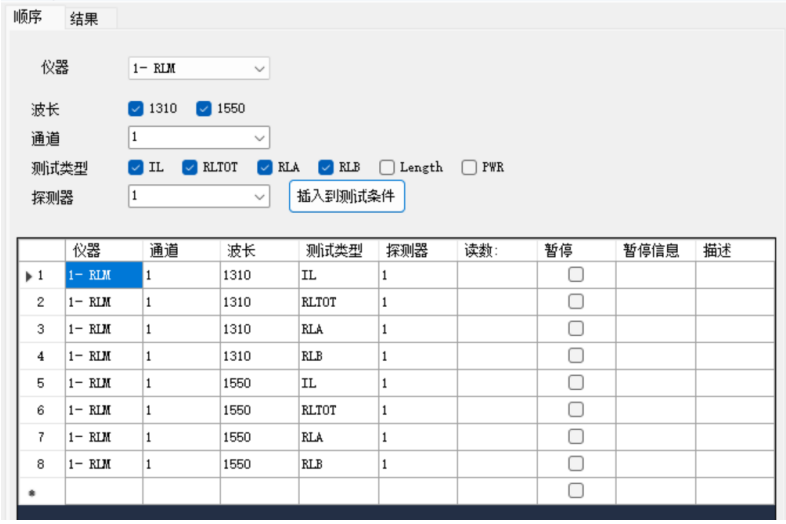

点击左上角红框中“测试”按钮进行测试即可完成测试流程。

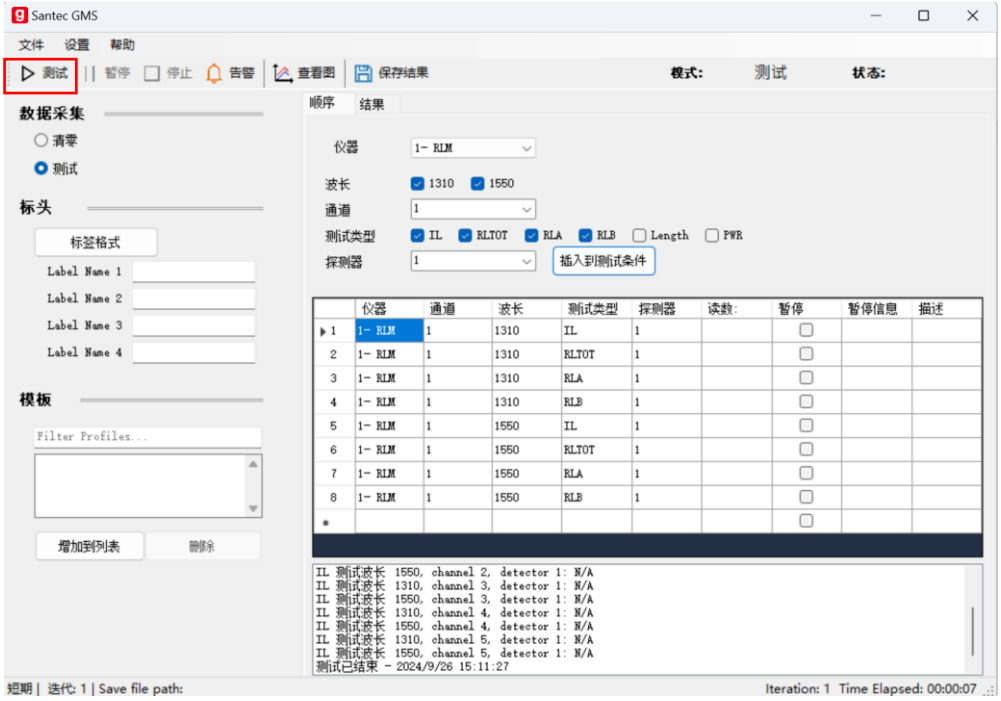

4.7 告警设置

通过设置告警，可以在测试不通过的情况下提醒用户。

首先选择下面左图“告警”按钮。

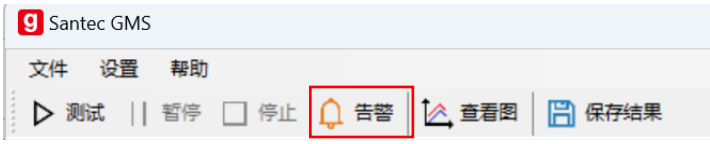

在弹出的对话框中选择“新警示”（如下左图），此时上方空白框中自动出现一栏以 1.开头的蓝色横条（如下右图红色框显示），在右图下面红框的下拉菜单中选择预警或者失败（选择预警作为示例）。

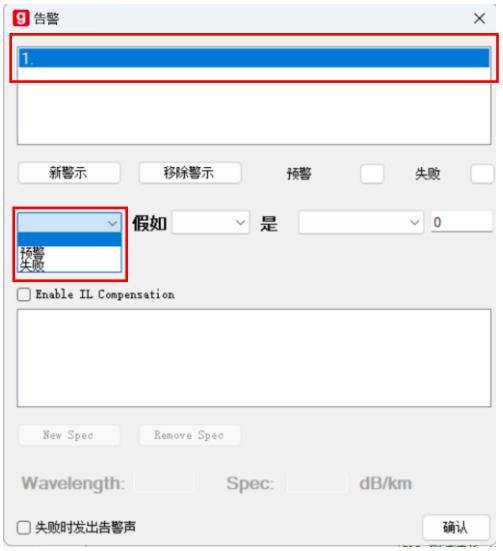

下面左图“假如”菜单是选择需要预警的参数（选择 IL 作为示例），右图“是”菜单选择条件（选择等于作为示例），最后一列根据需要输入阈值（输入 0 作为示例）。

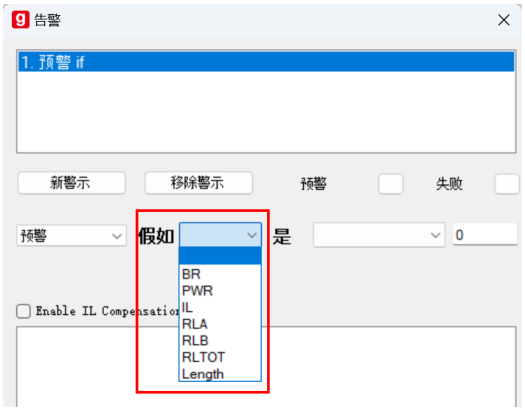

下面左图显示已经设置了一项预警，点击预警右边的空白框，在弹出的颜色中选择预警时显示的颜色。

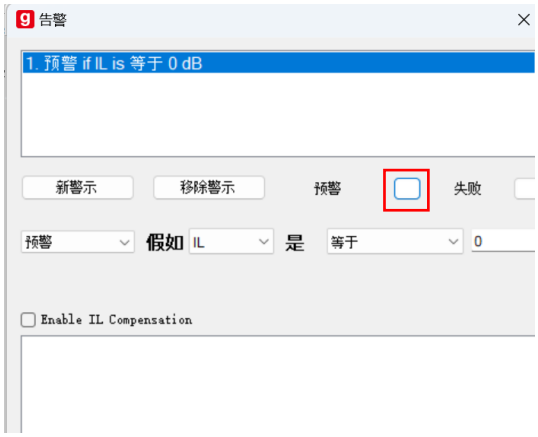

以同样的方法可以添加多个告警，如下示例添加了两个告警（预警和失败）并设置了颜色。如果同一测试结果既触发了预警又触发了失败，优先显示失败。下图中最下面”失败时发出告警声“选中后，任何预警或者失败被触发都会发出声音告警。

告警
1. 预警 if IL is 等于 0 dB
2. 失败 if IL is 大于 1 dB
新警示
移除警示
预警
失败
失败
假如
IL
是
大于
1
Enable IL Compensation
New Spec
Remove Spec
Wavelength:
Spec:
dB/km
失败时发出告警声
确认