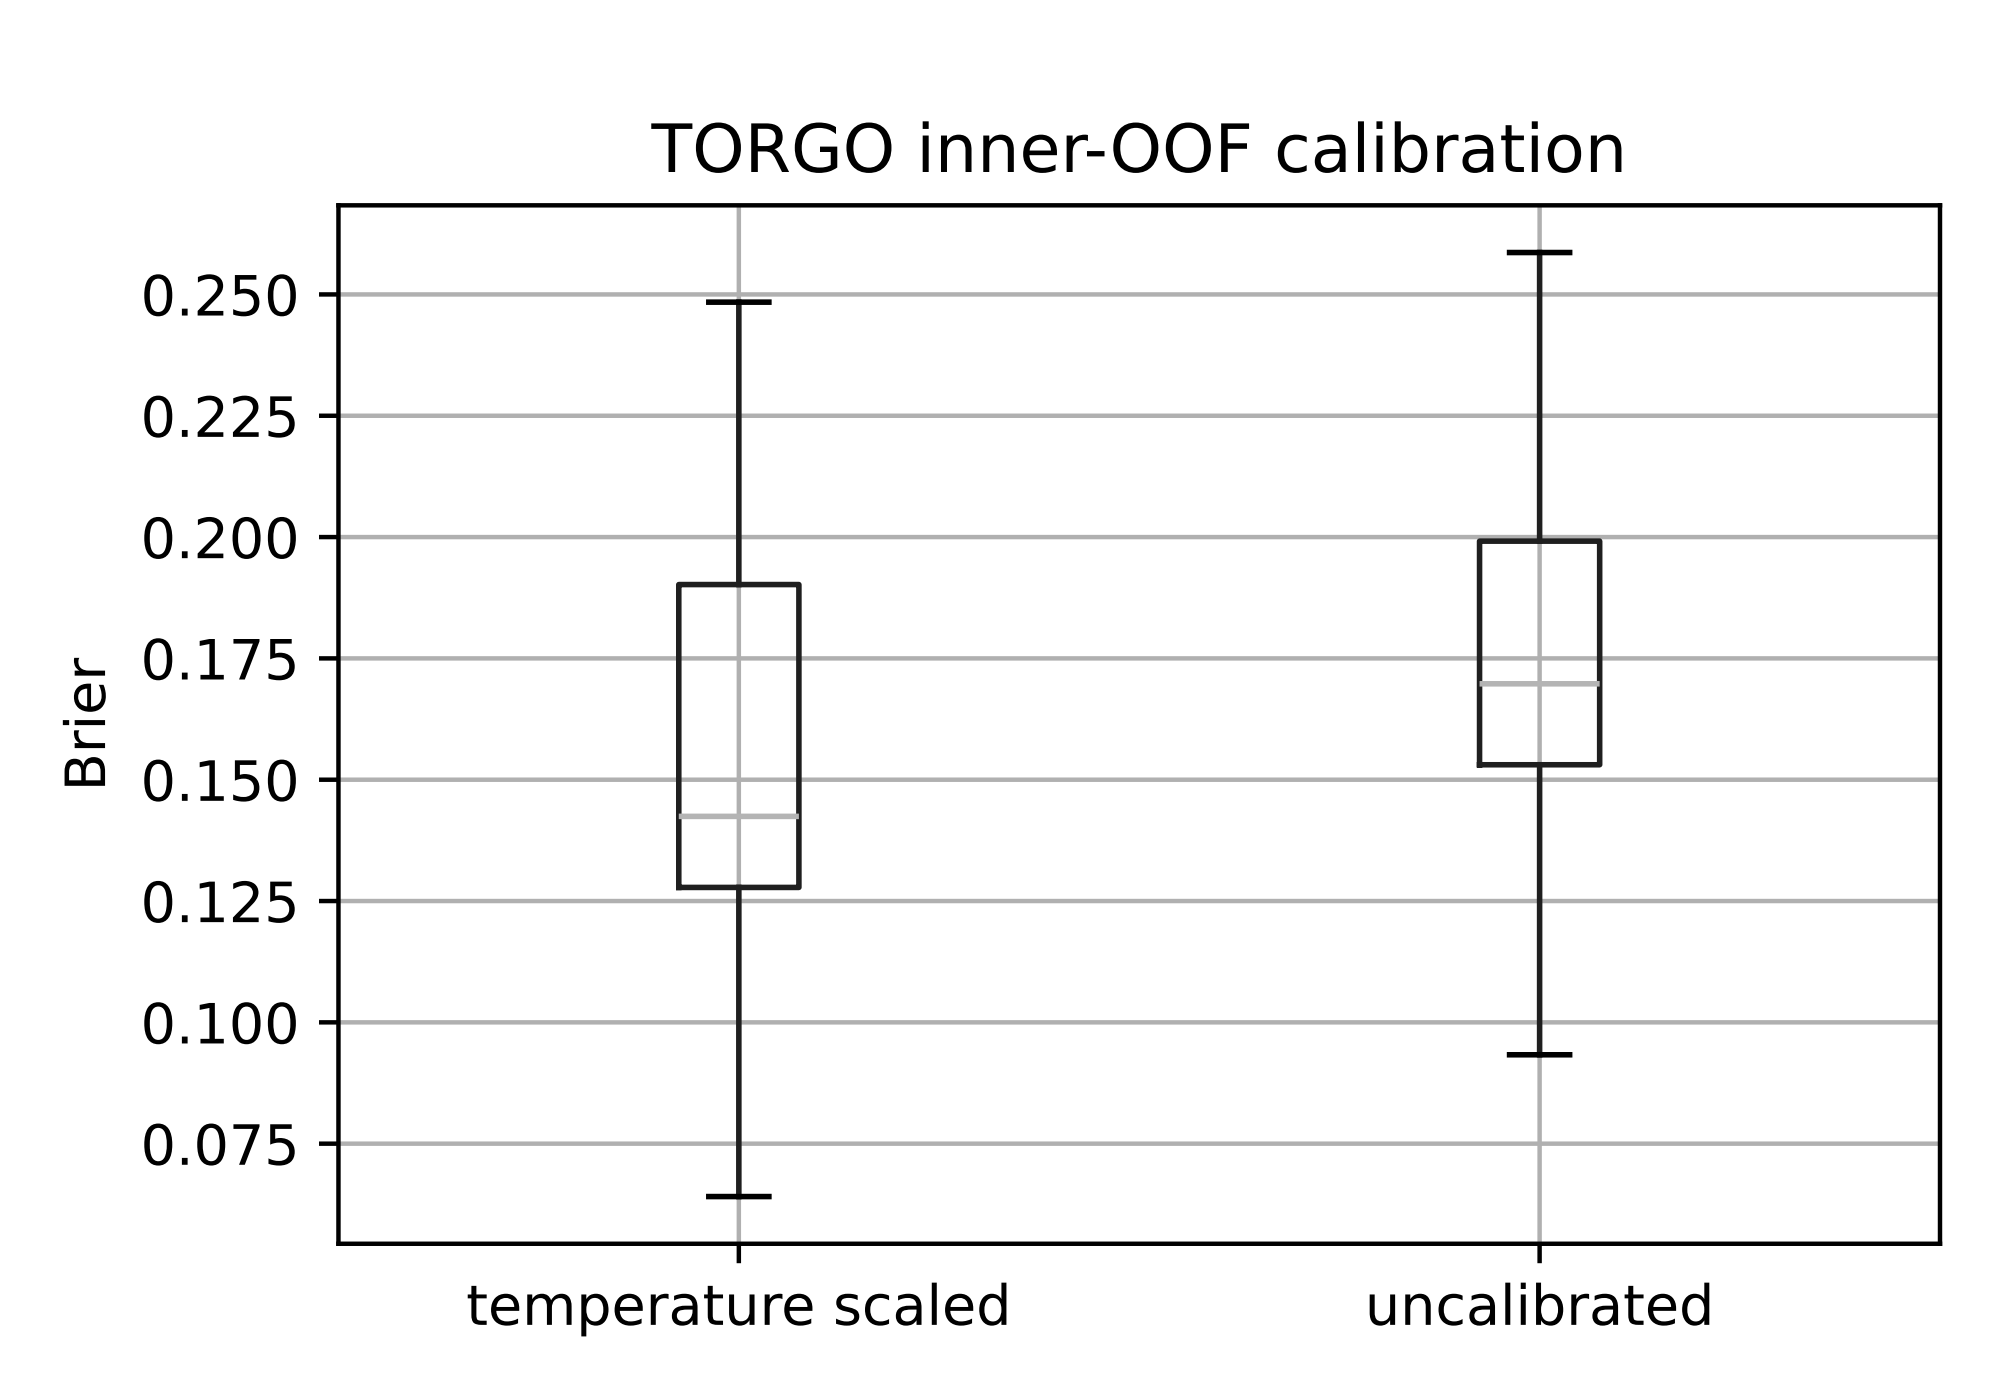
TORGO inner-OOF calibration
Brier
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
temperature scaled
uncalibrated