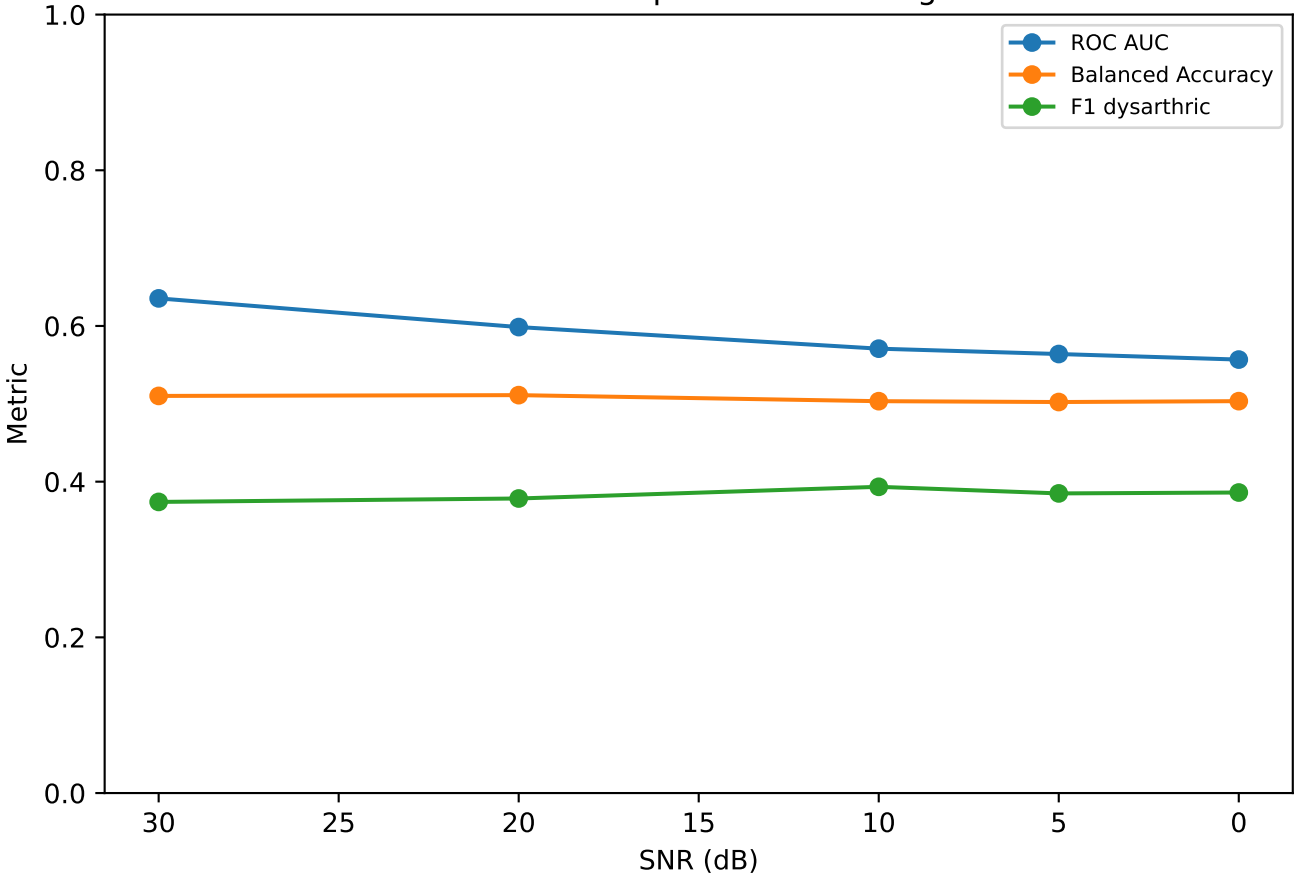
TORGO held-out speaker noise diagnostic
ROC AUC
Balanced Accuracy
F1 dysarthric
Metric
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
30
25
20
15
10
5
0
SNR (dB)