




HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: flattop

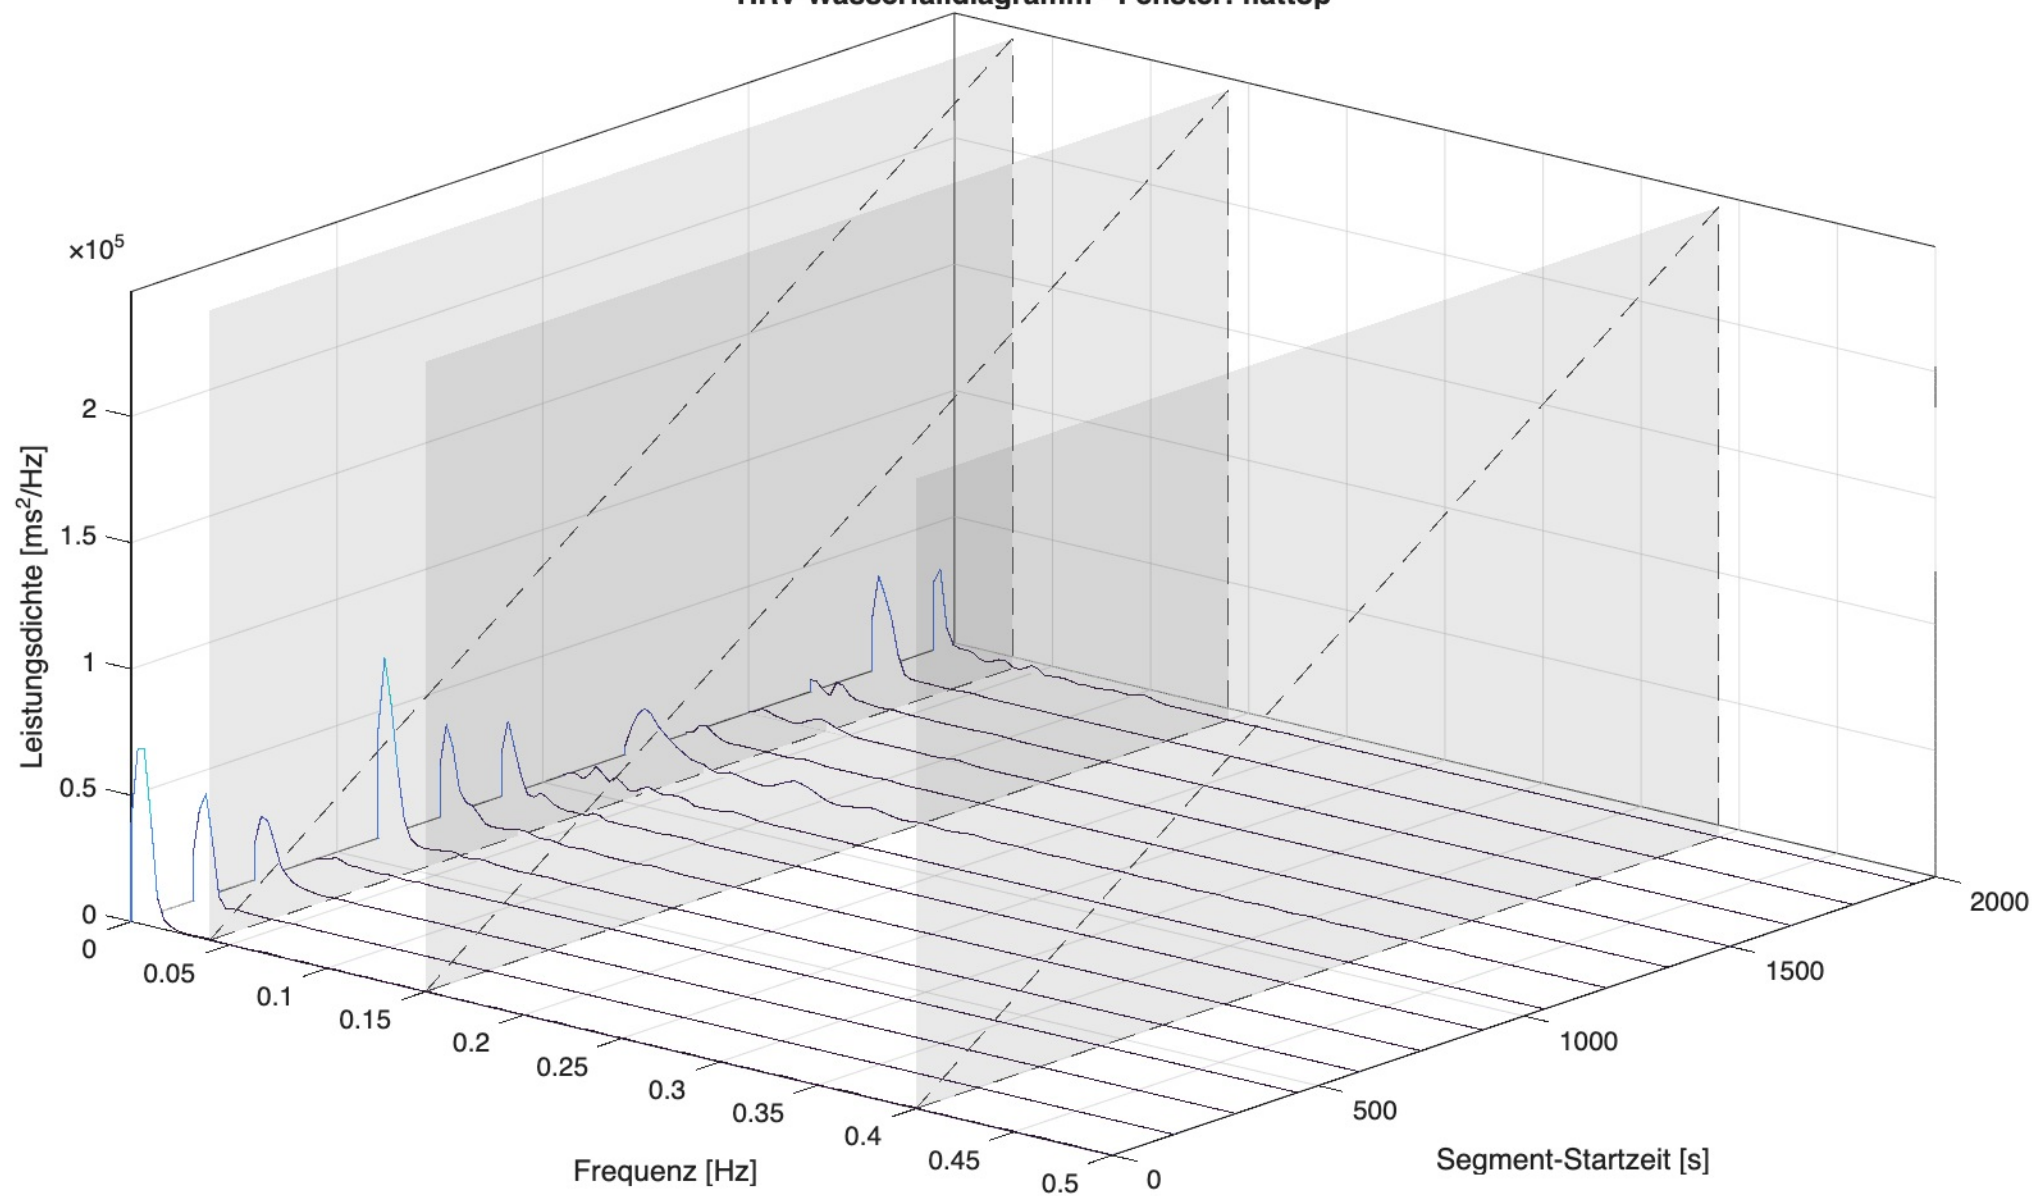


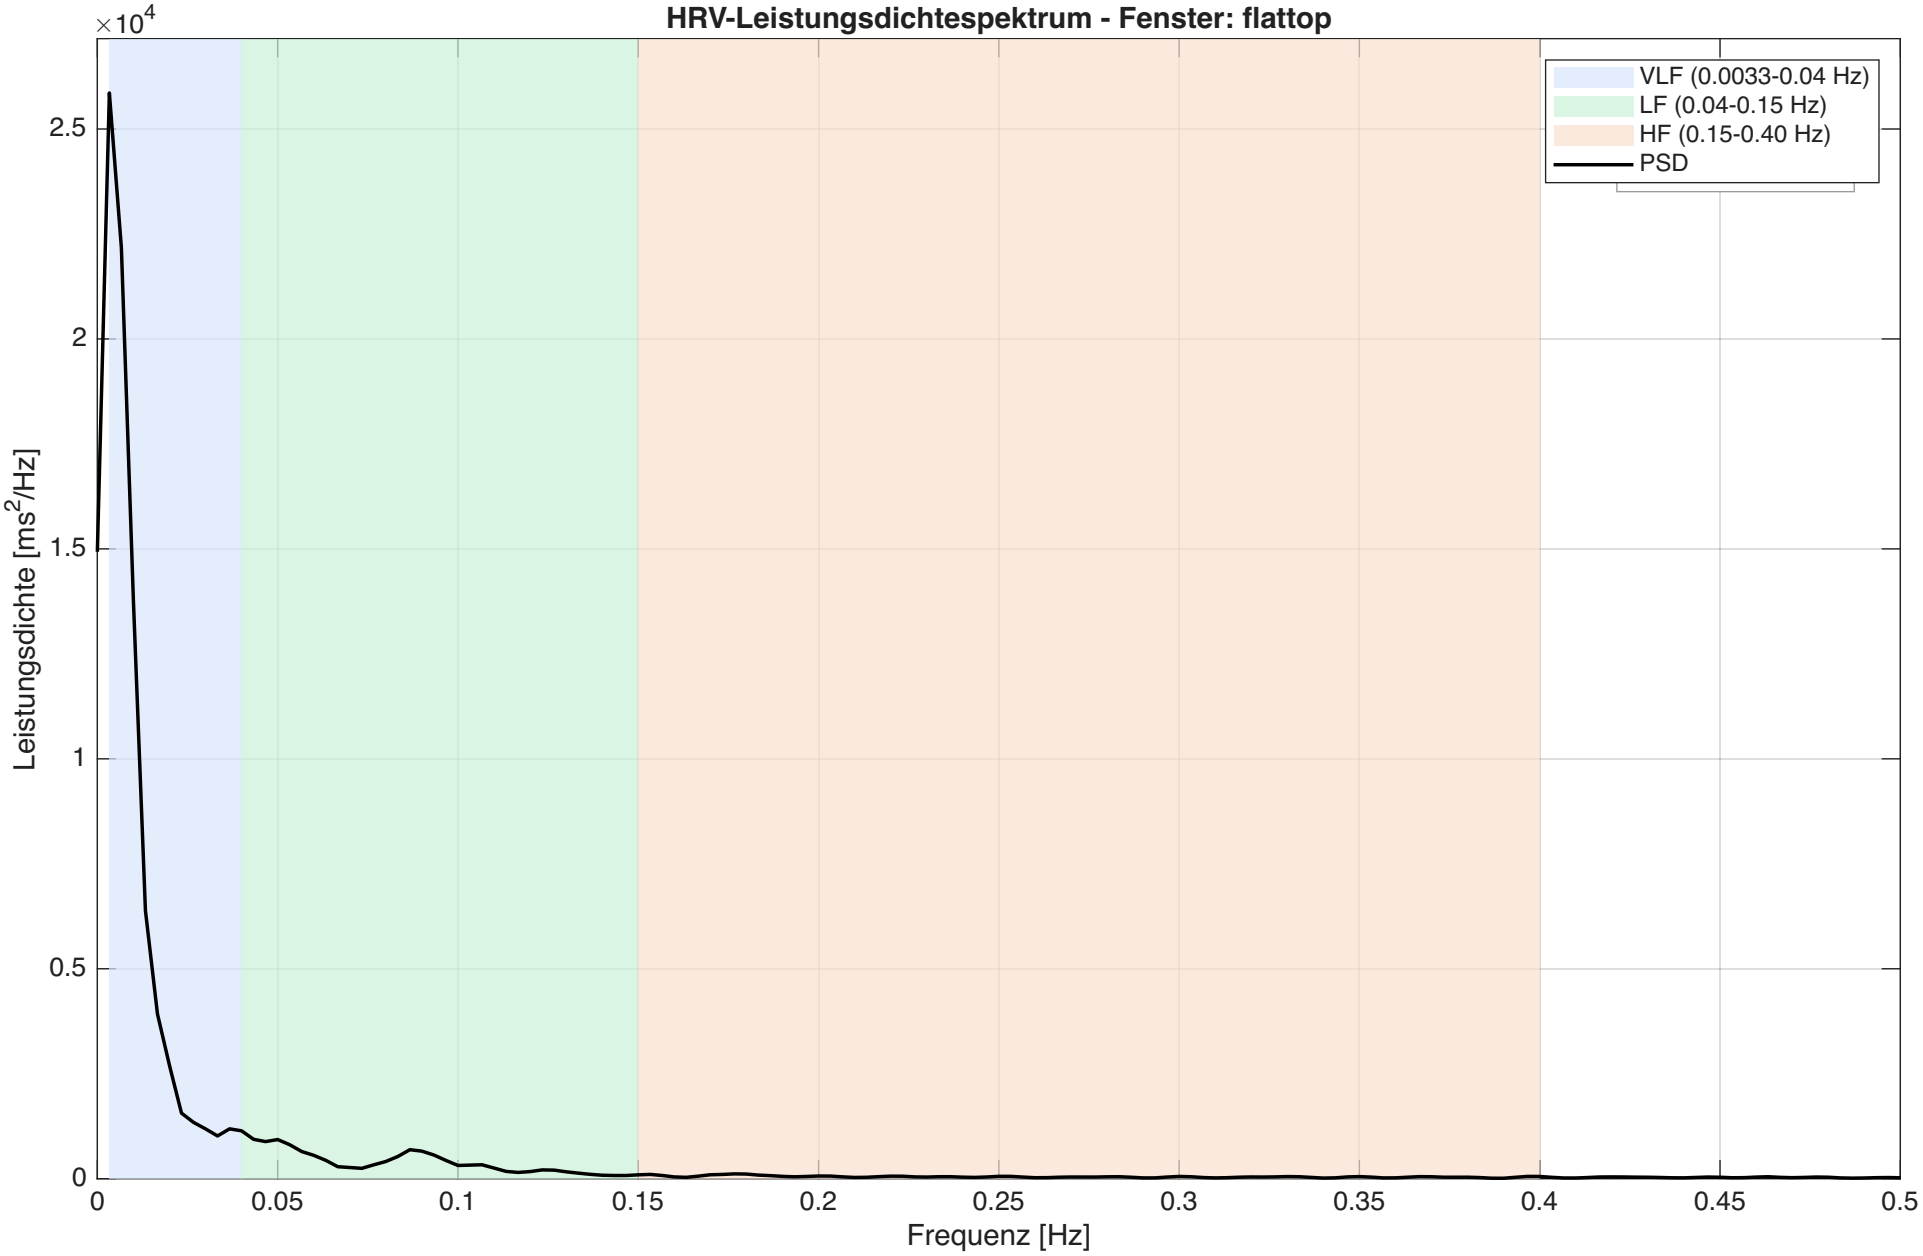


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: kaiser

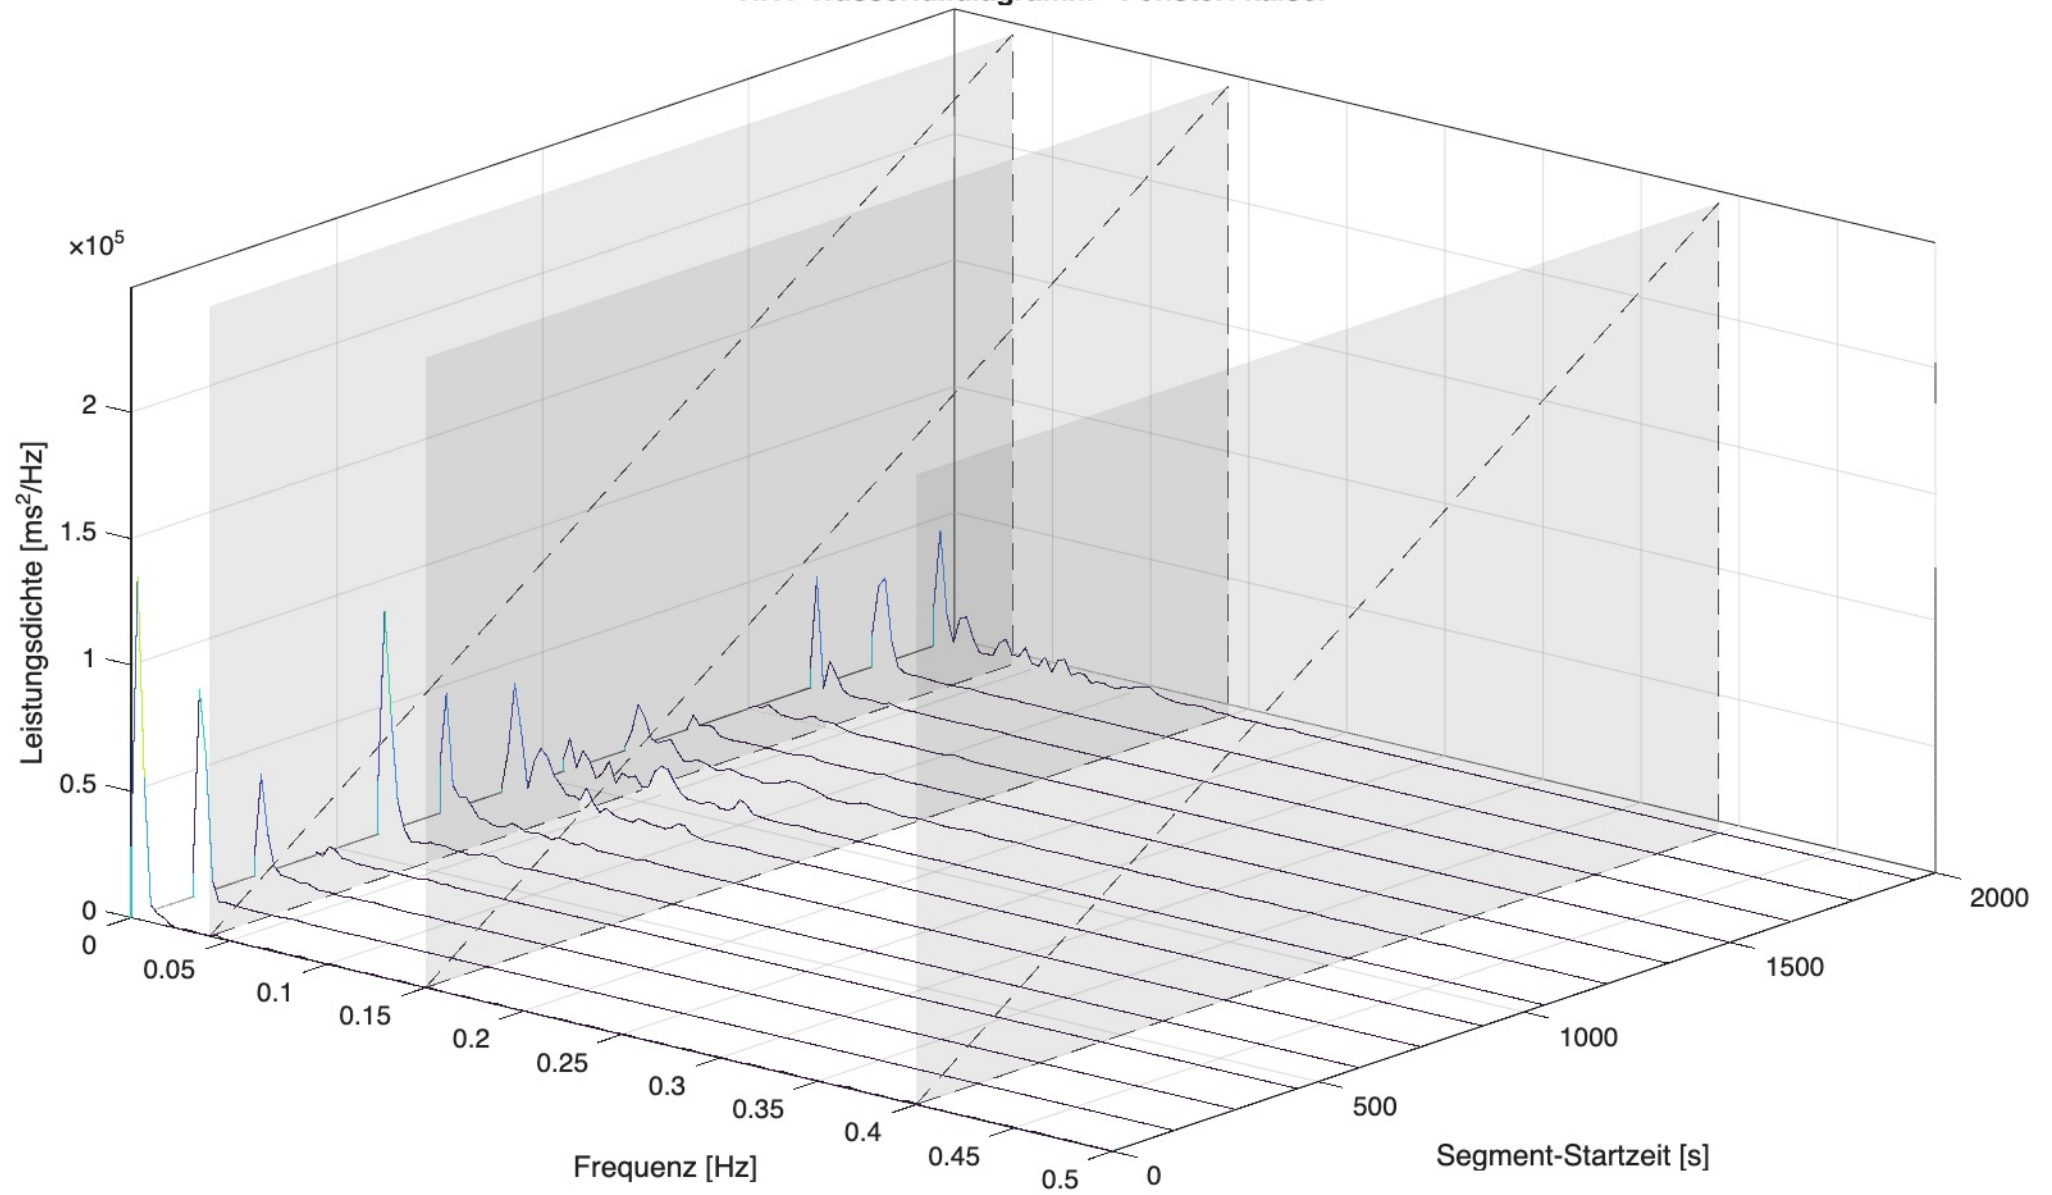


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: kaiser

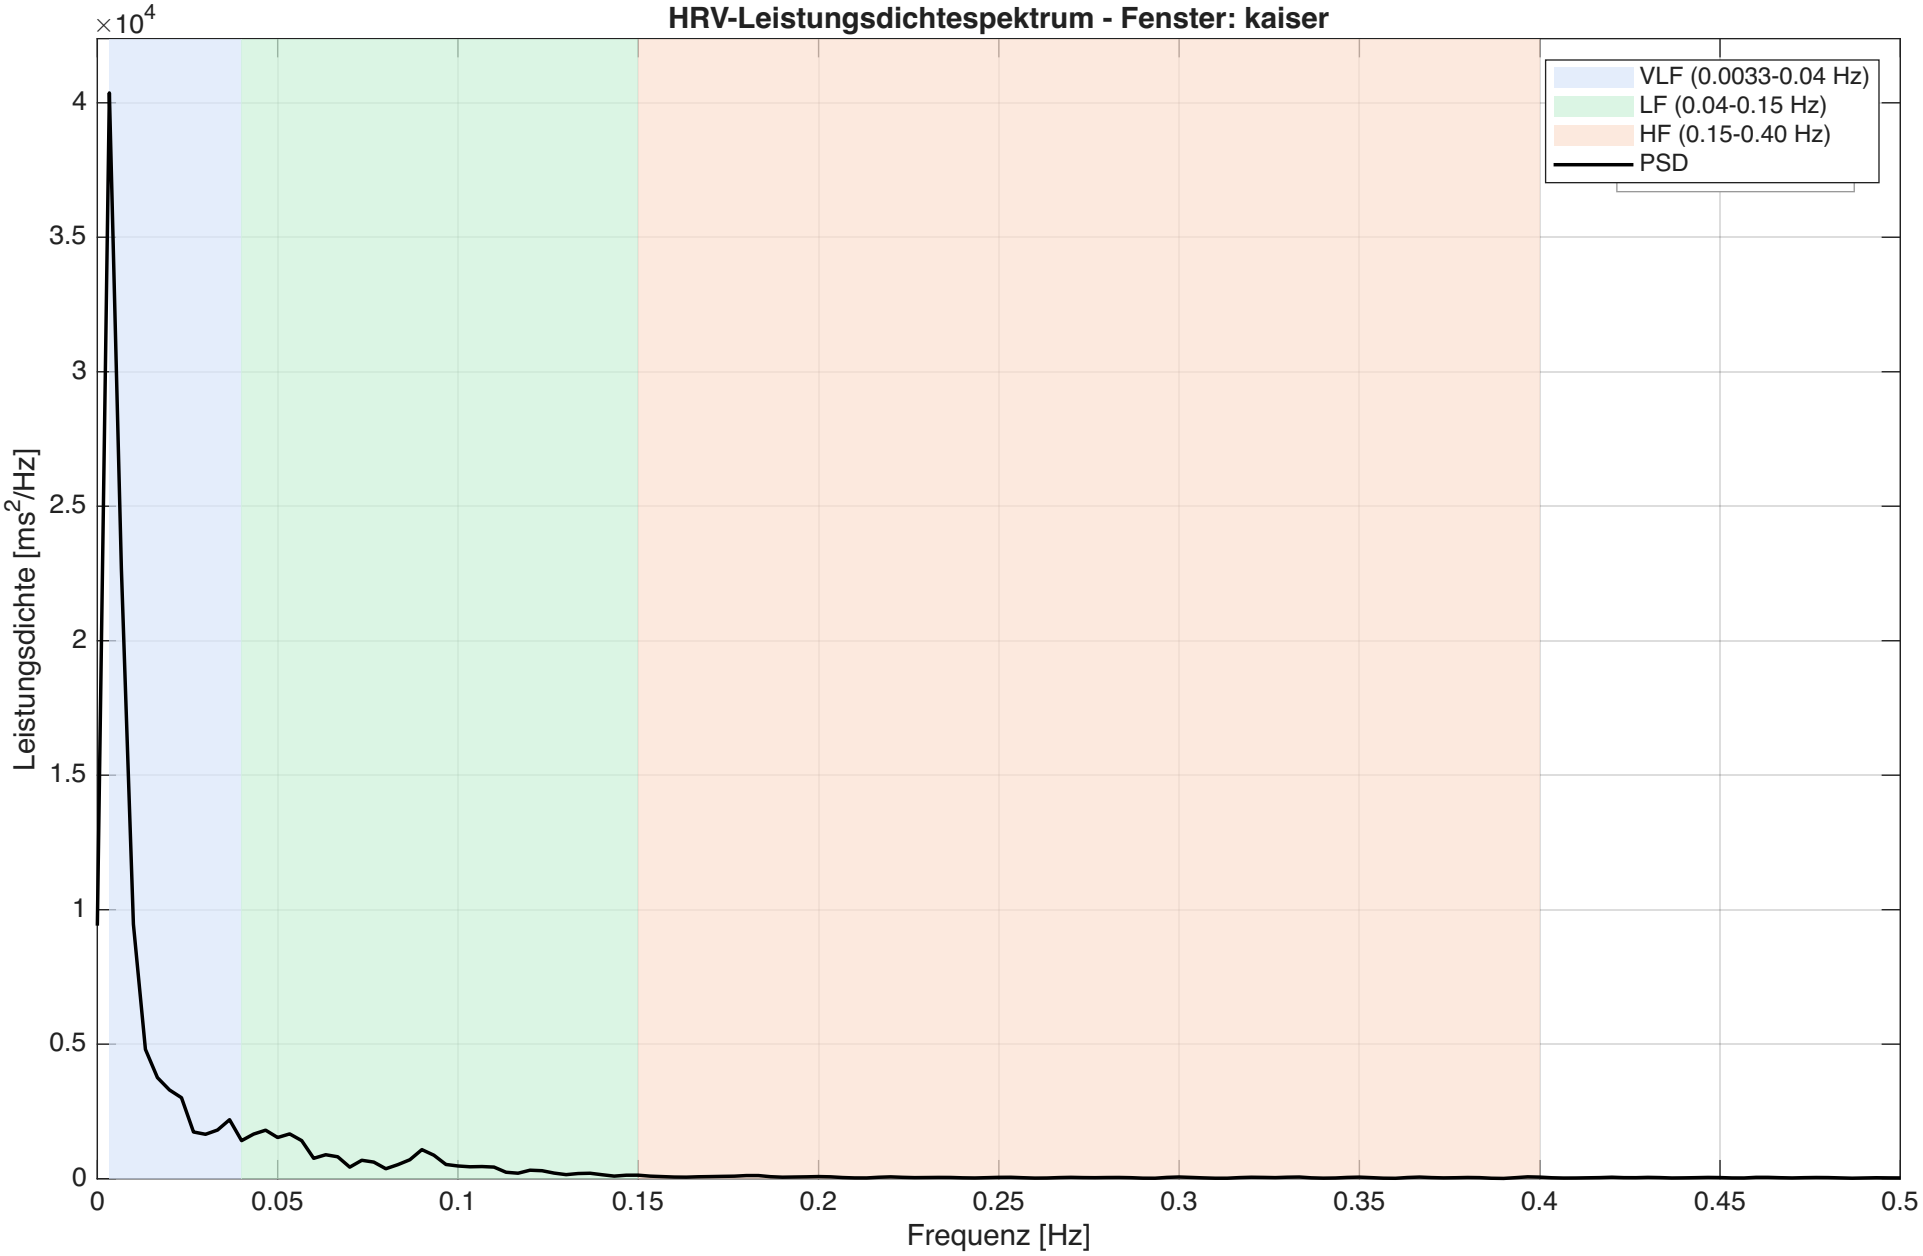


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: blackman

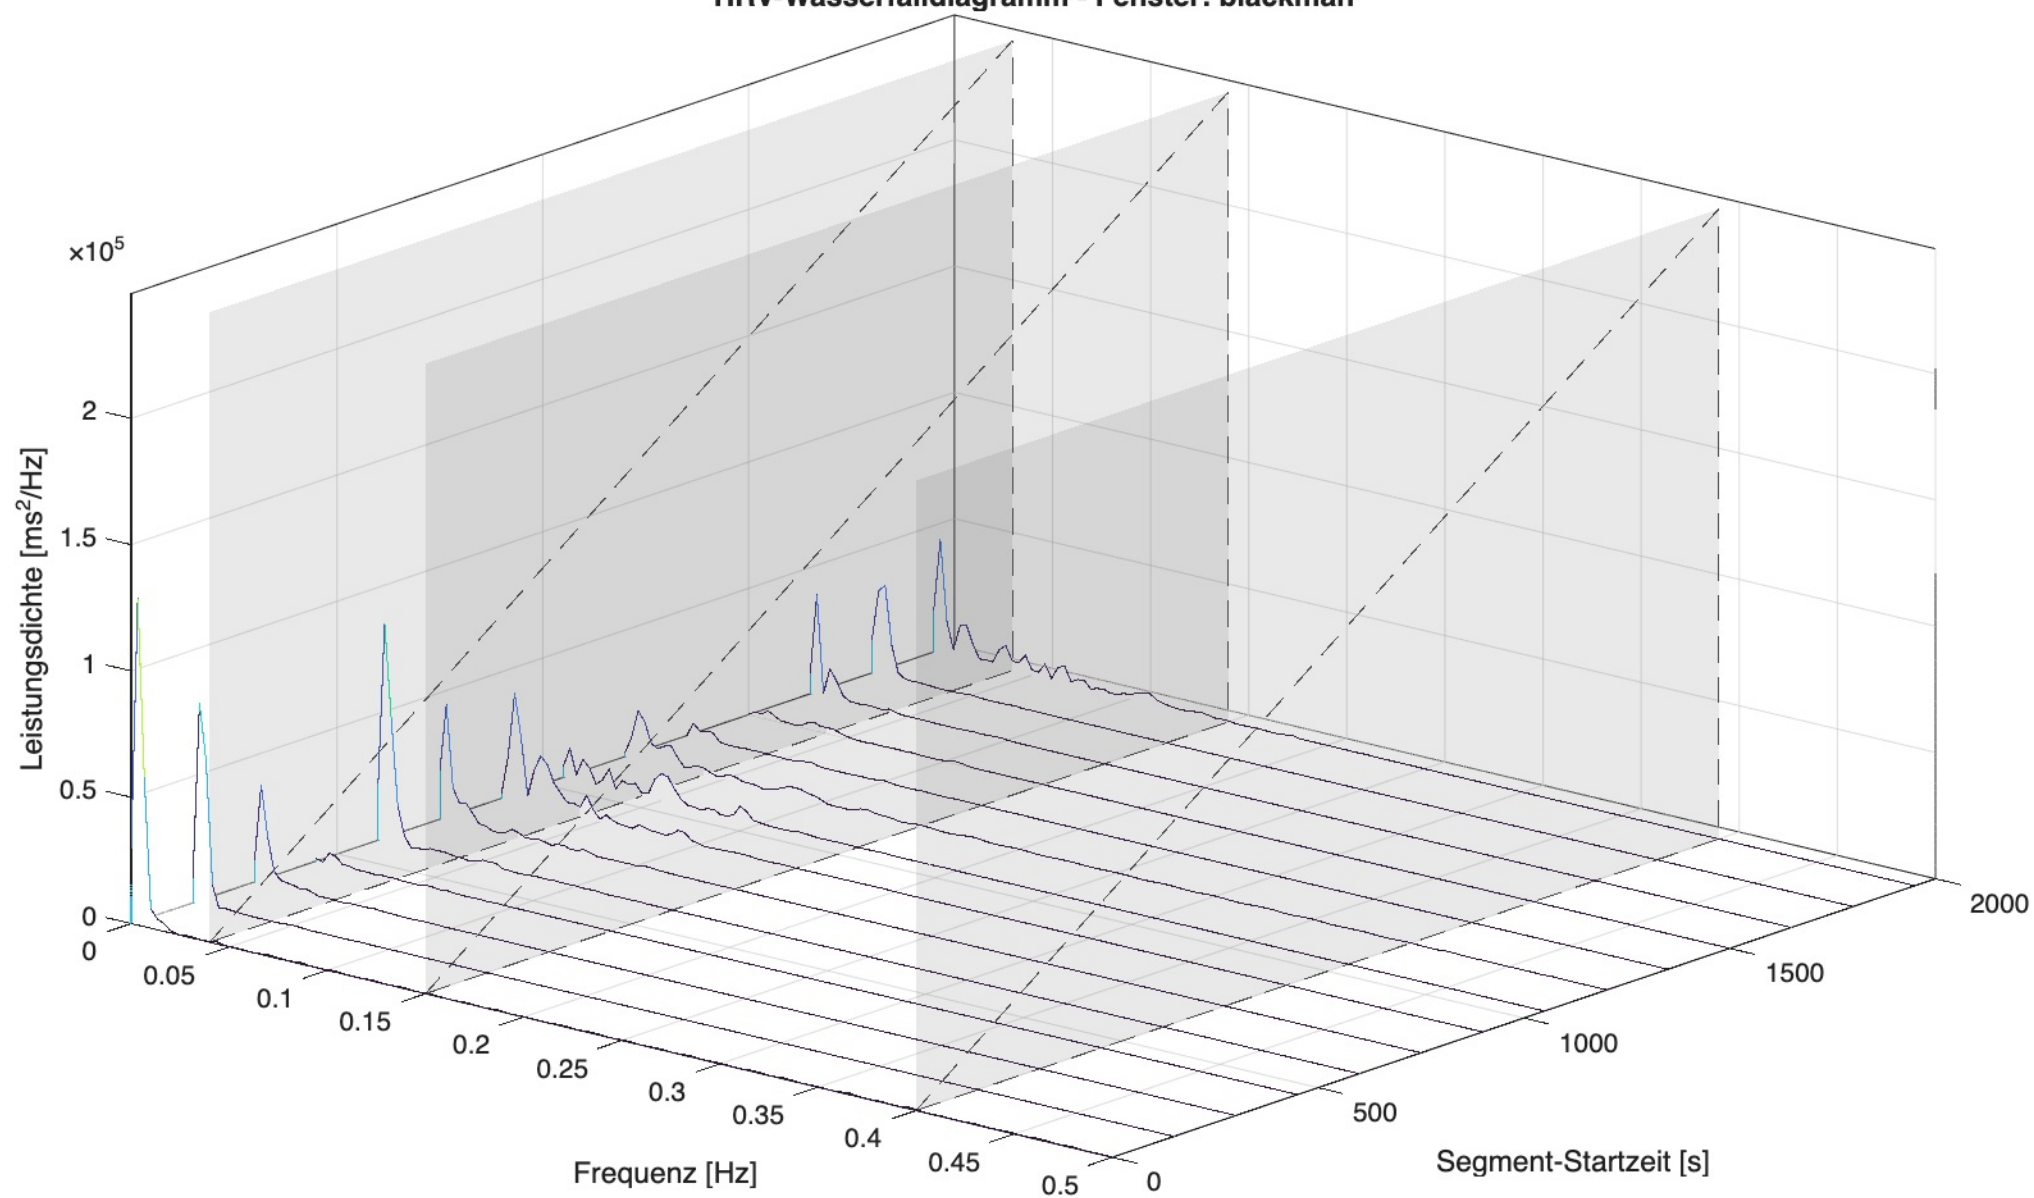


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: blackman

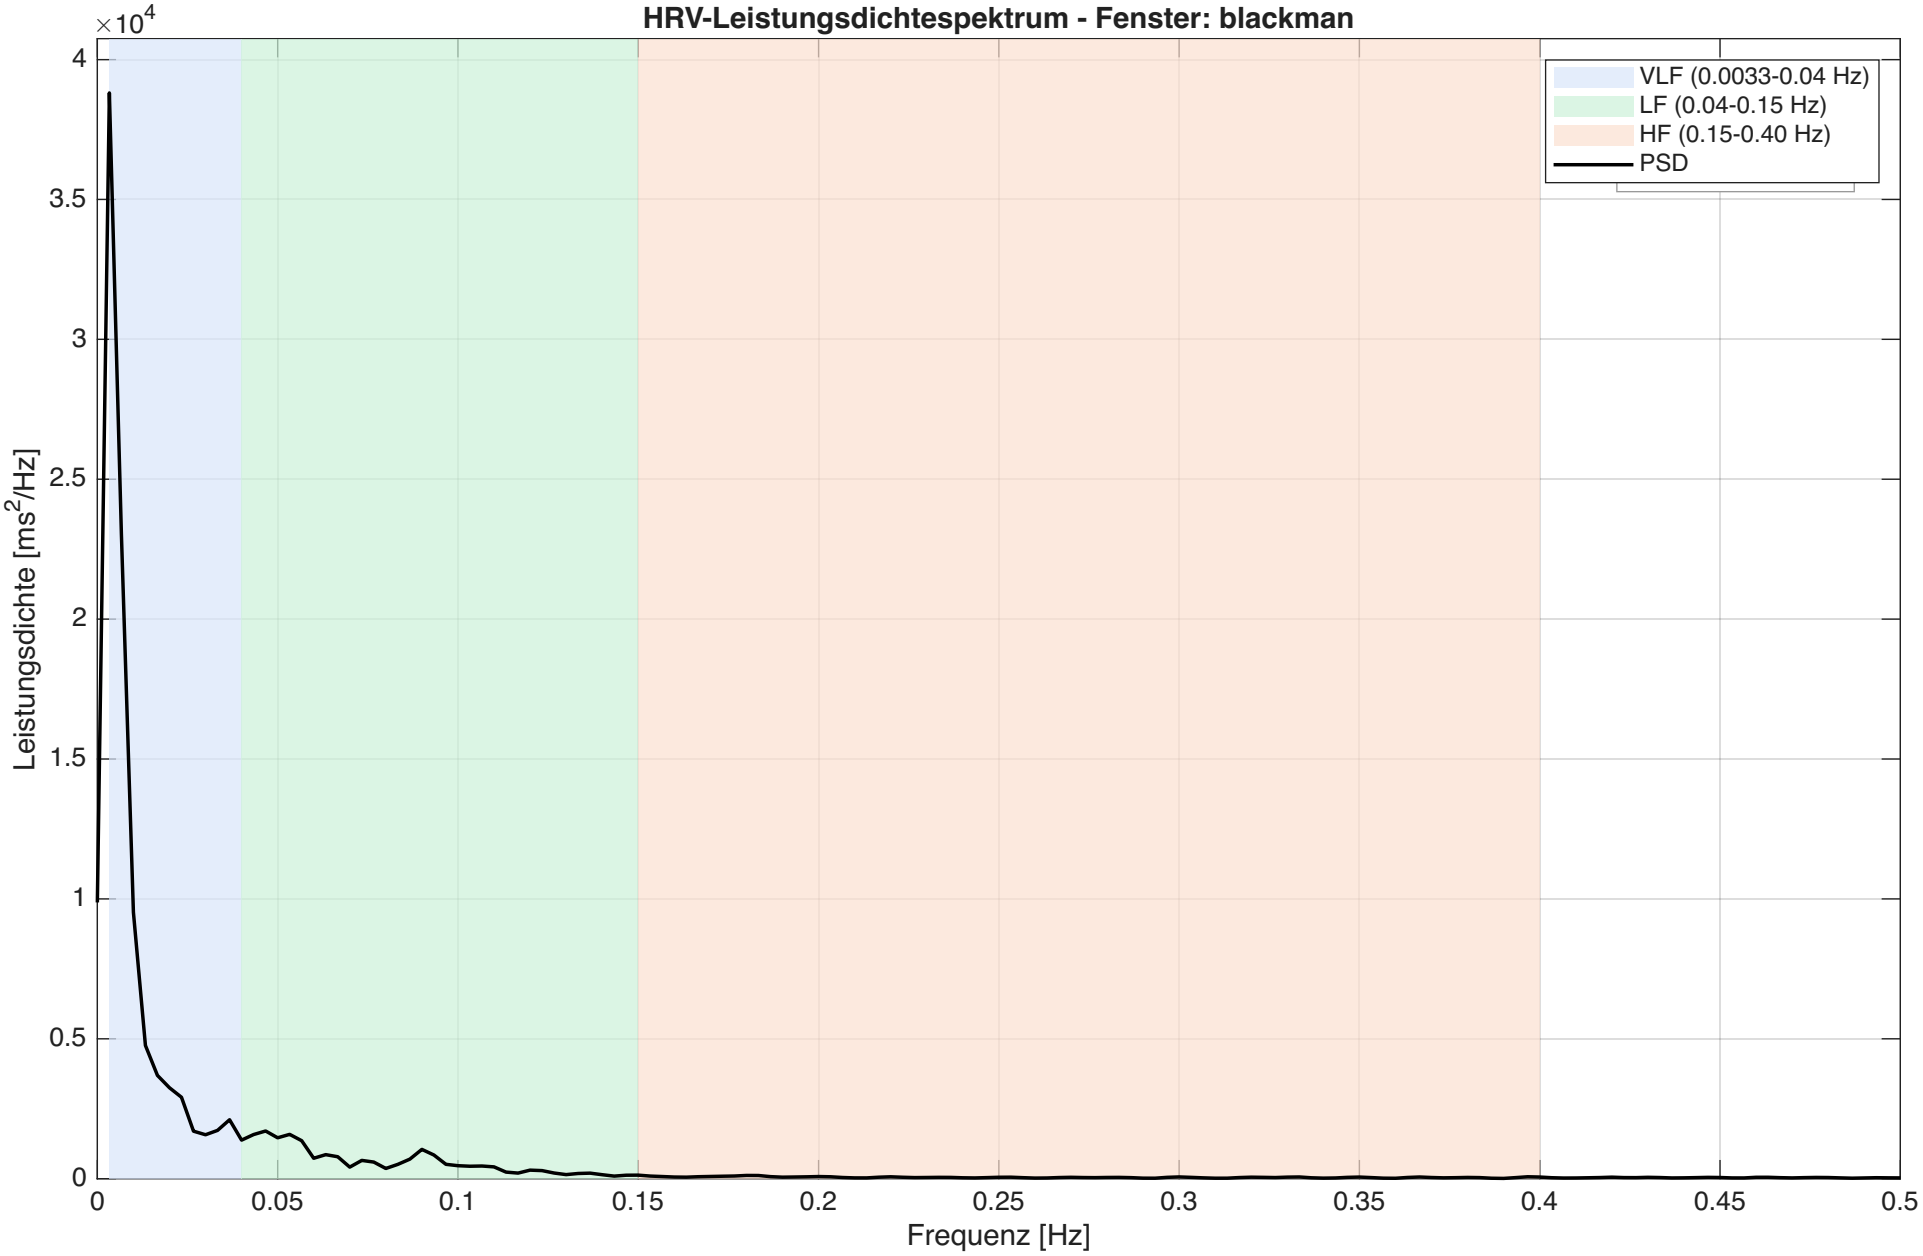


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: hamming

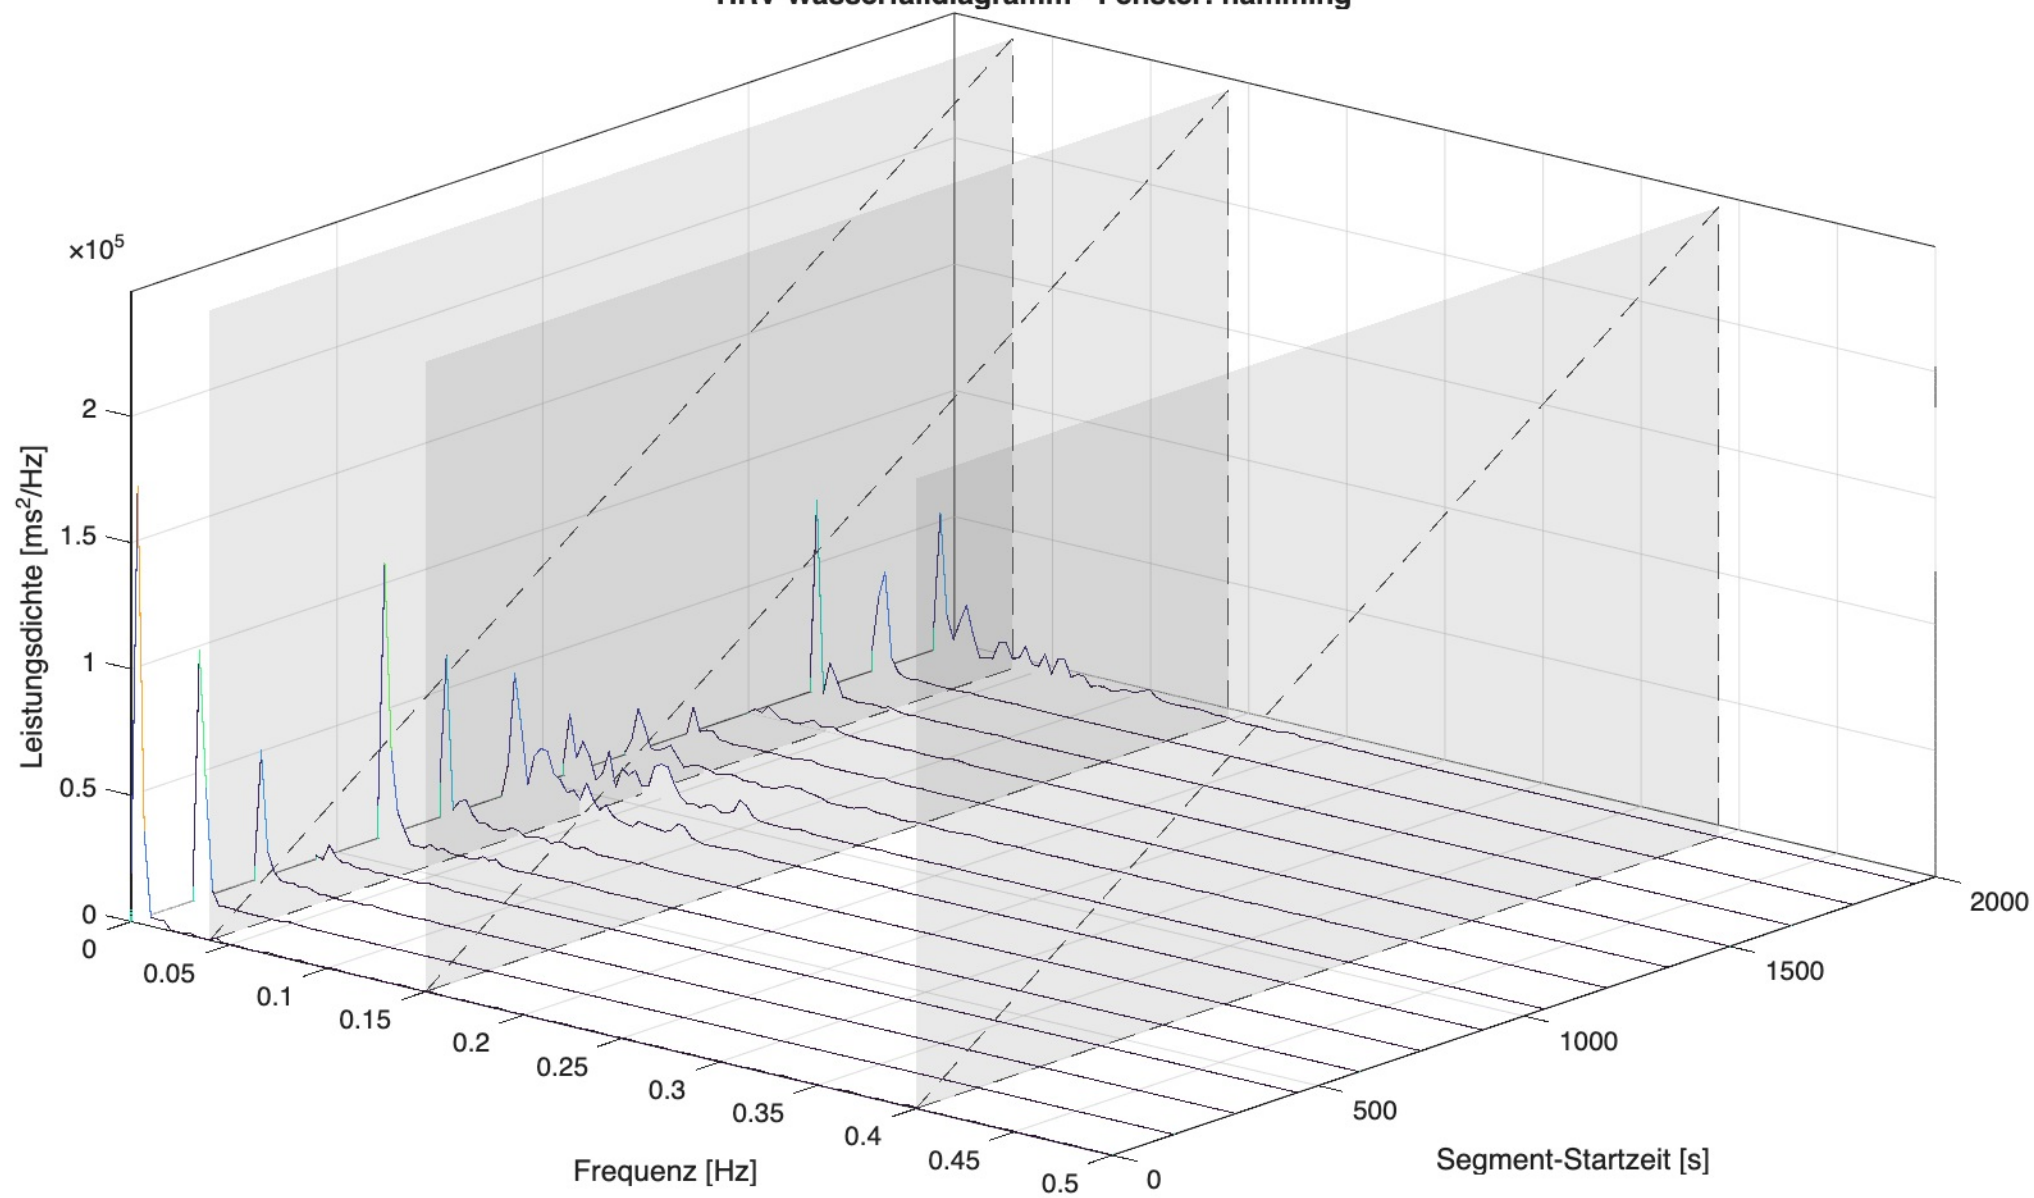


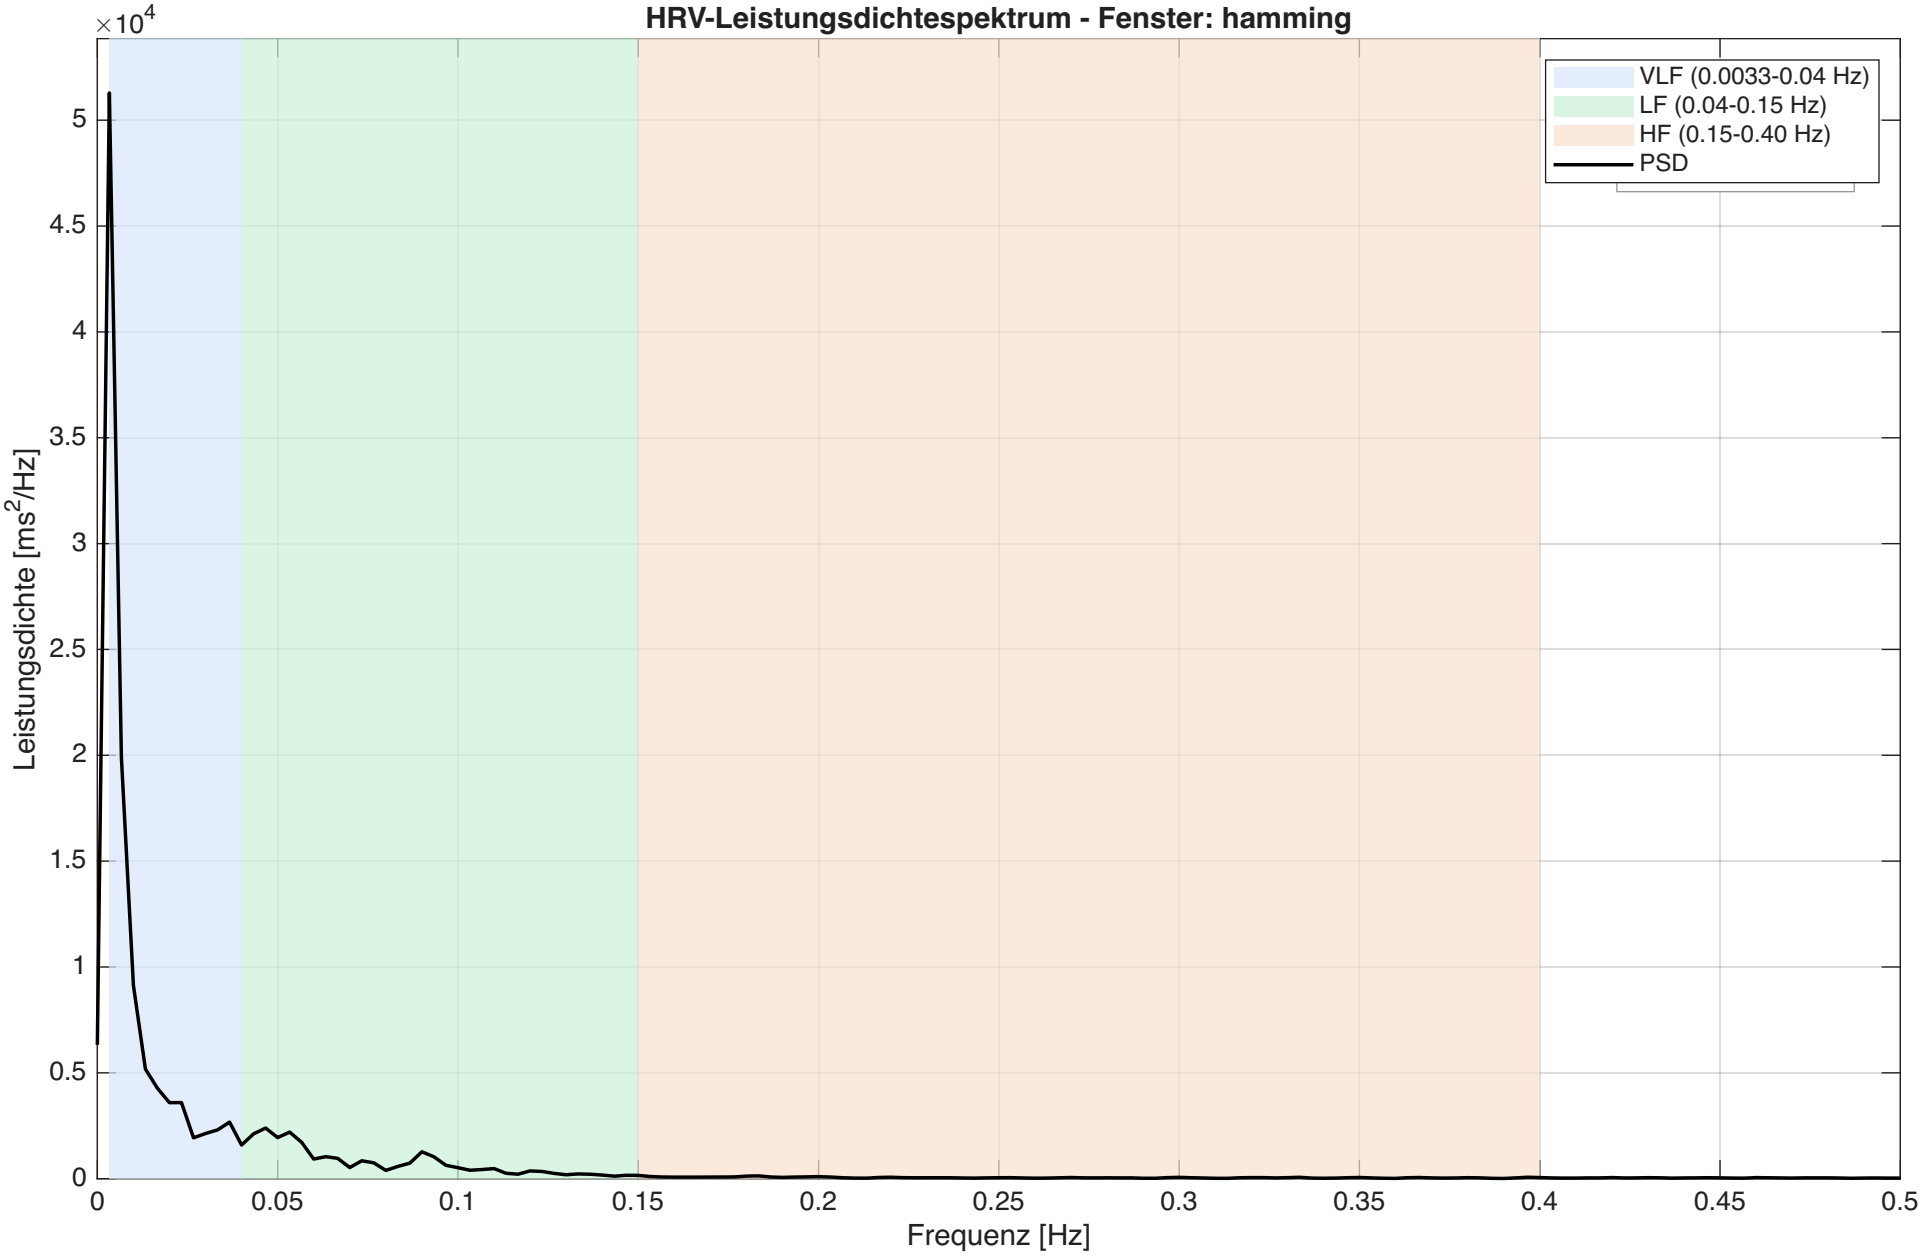


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: hann

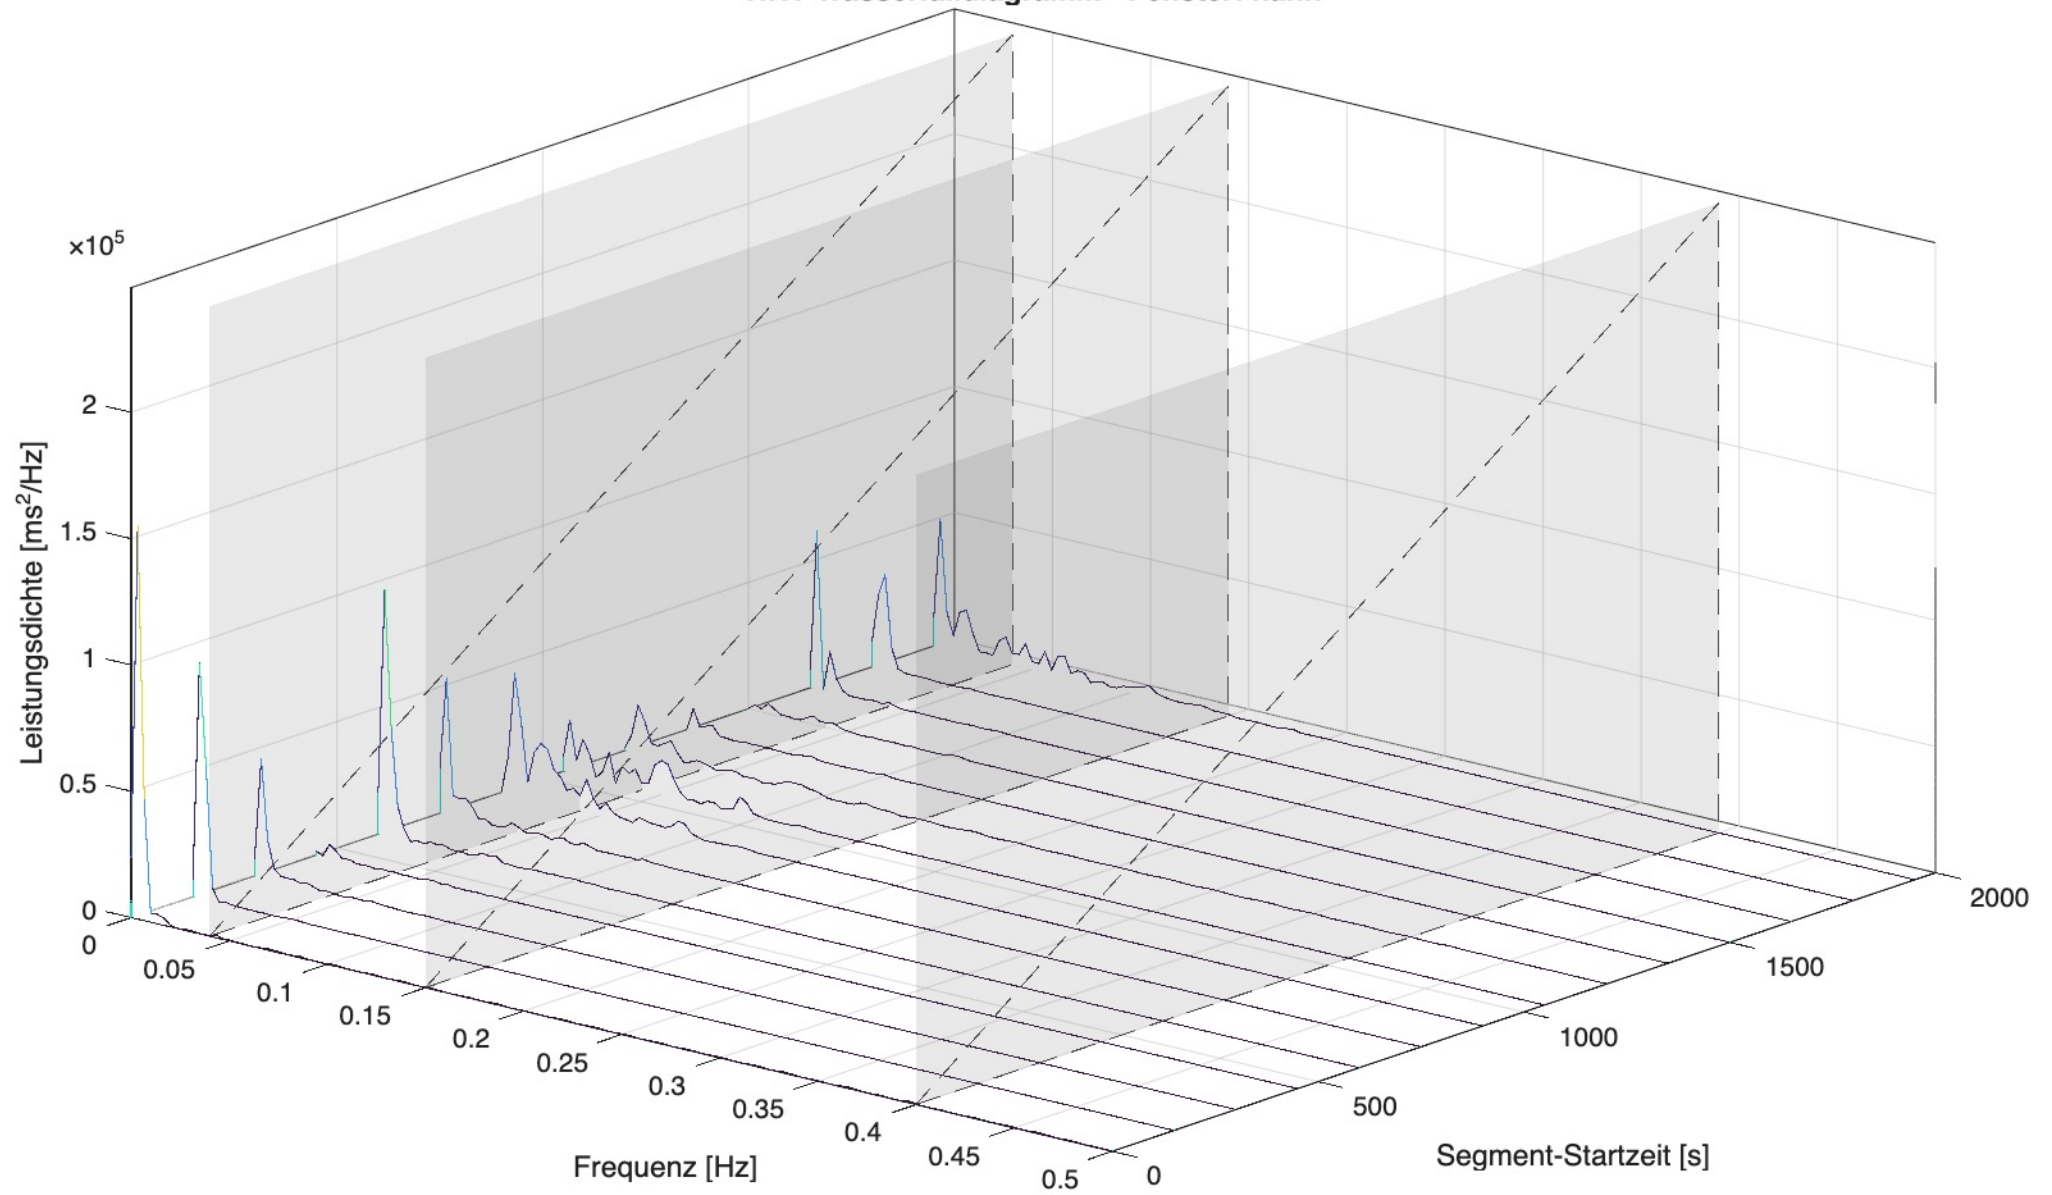


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: hann

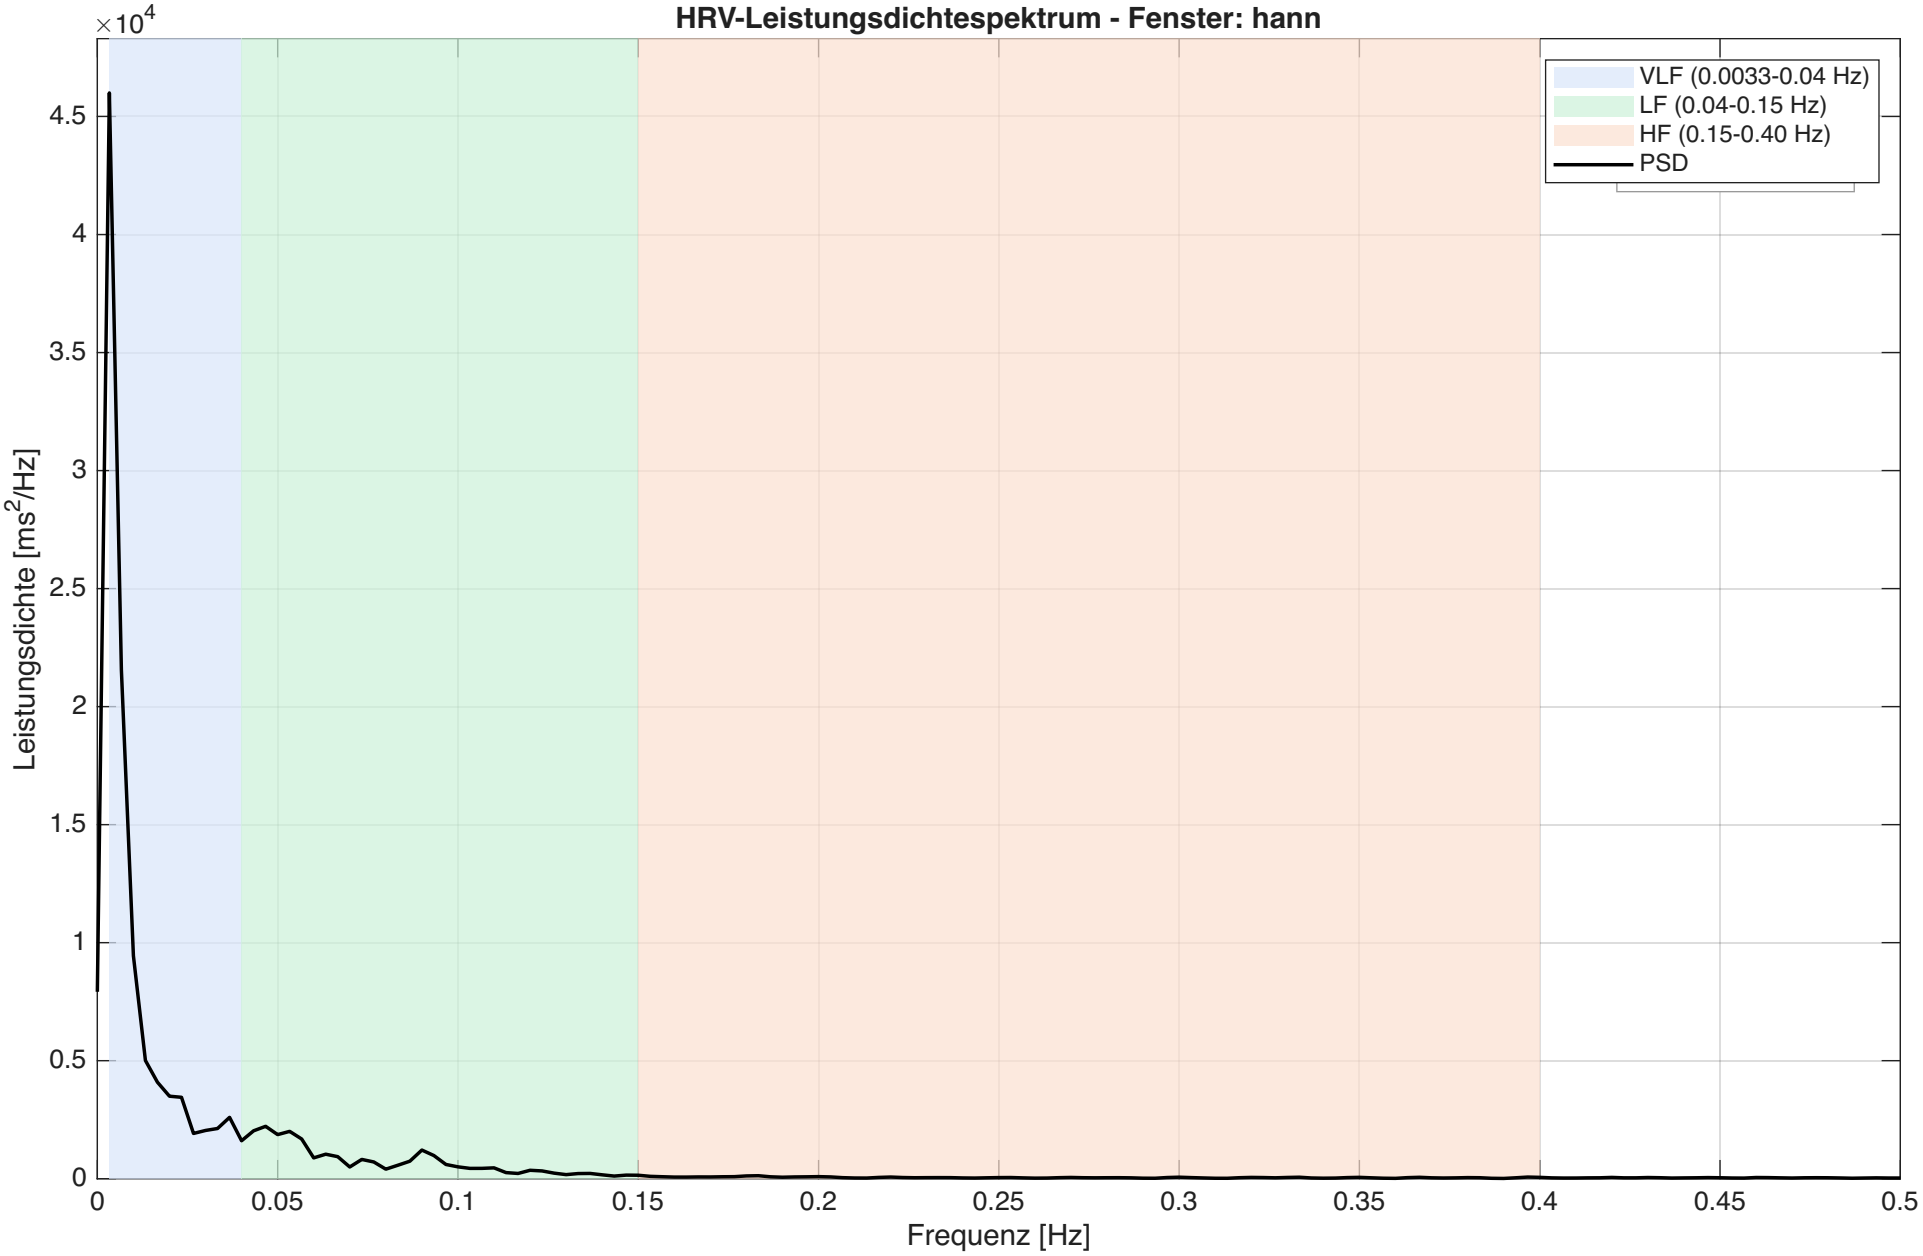


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: rect

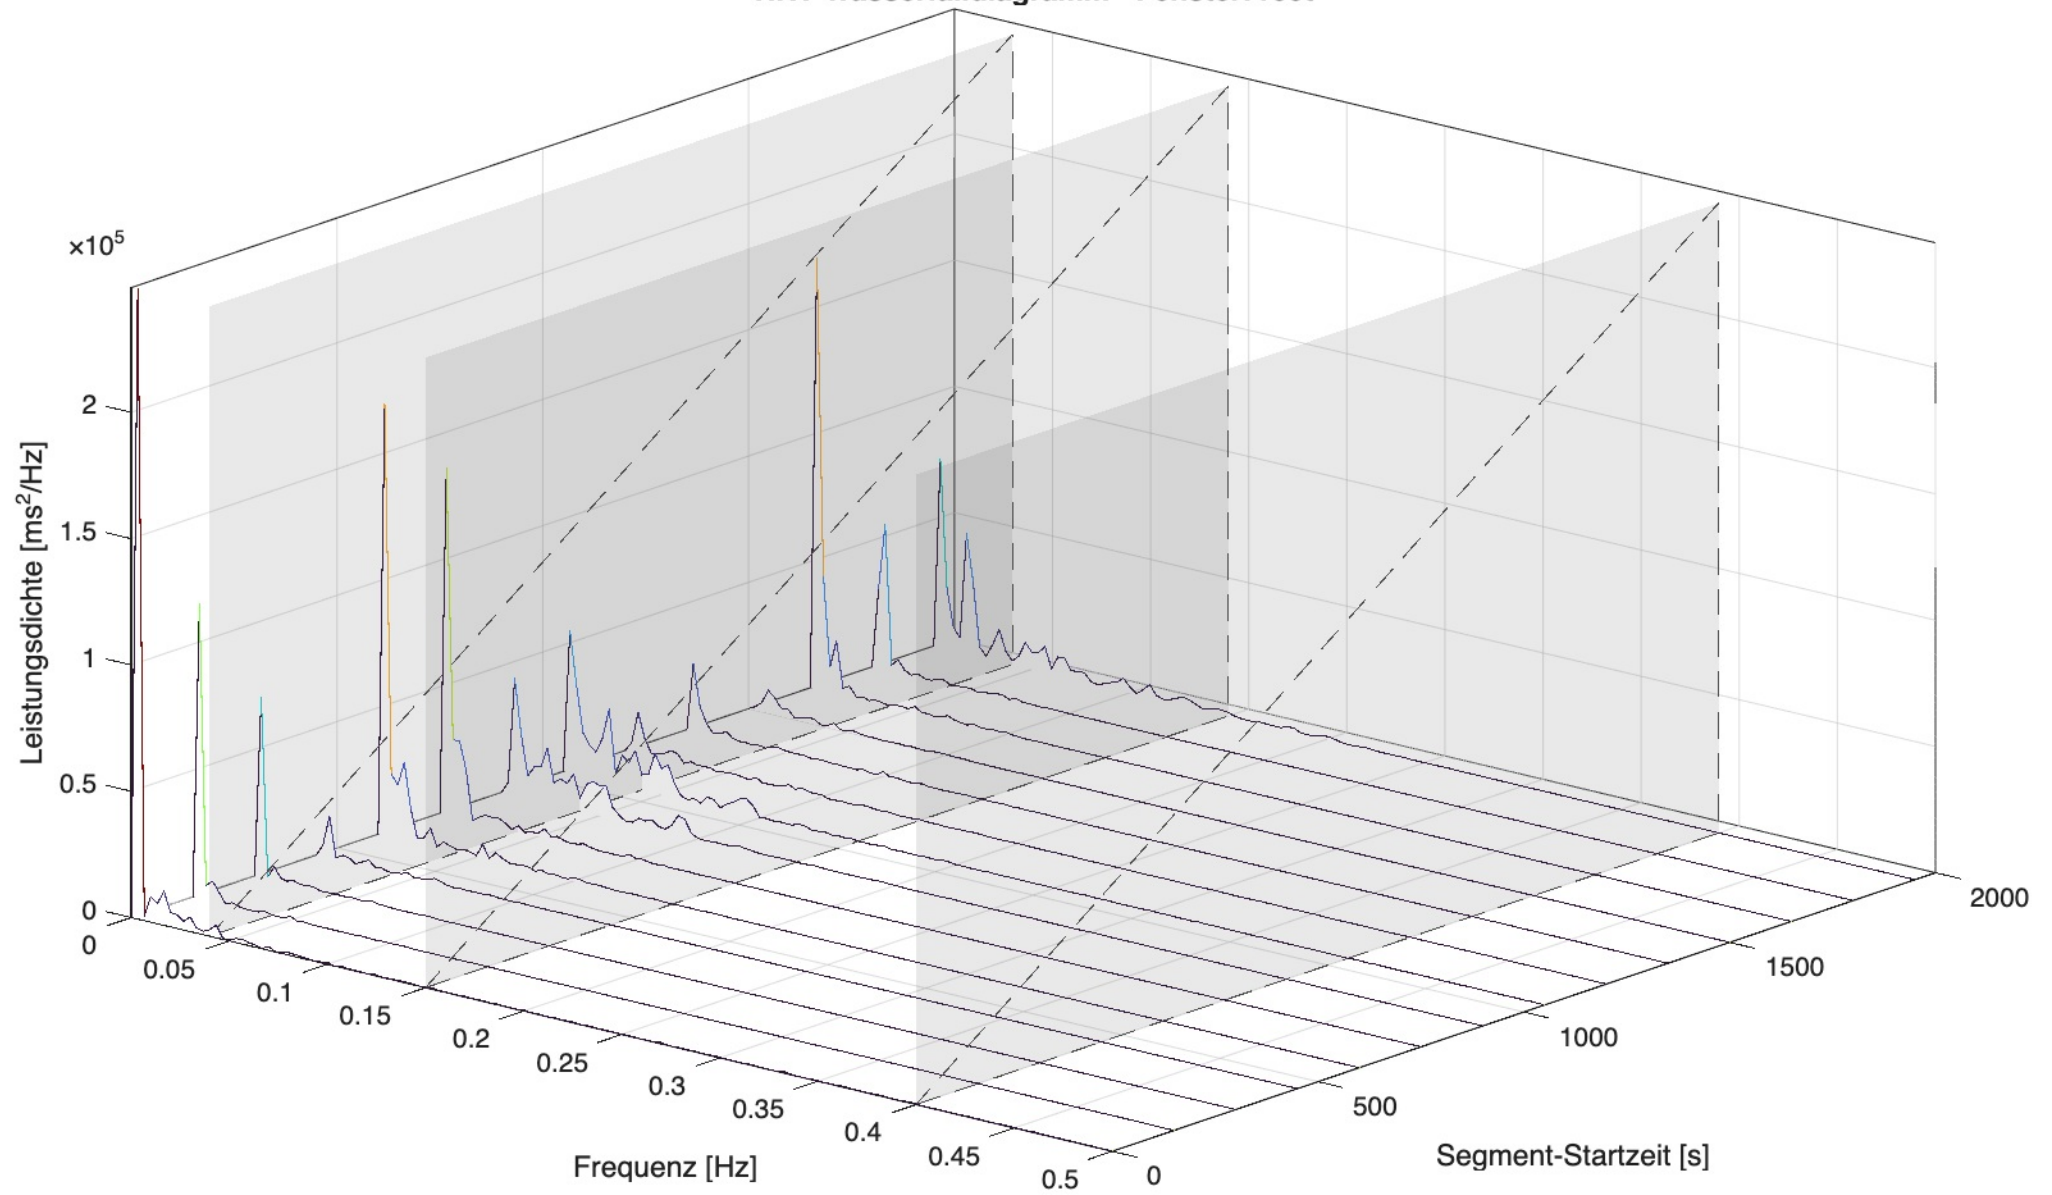


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: rect

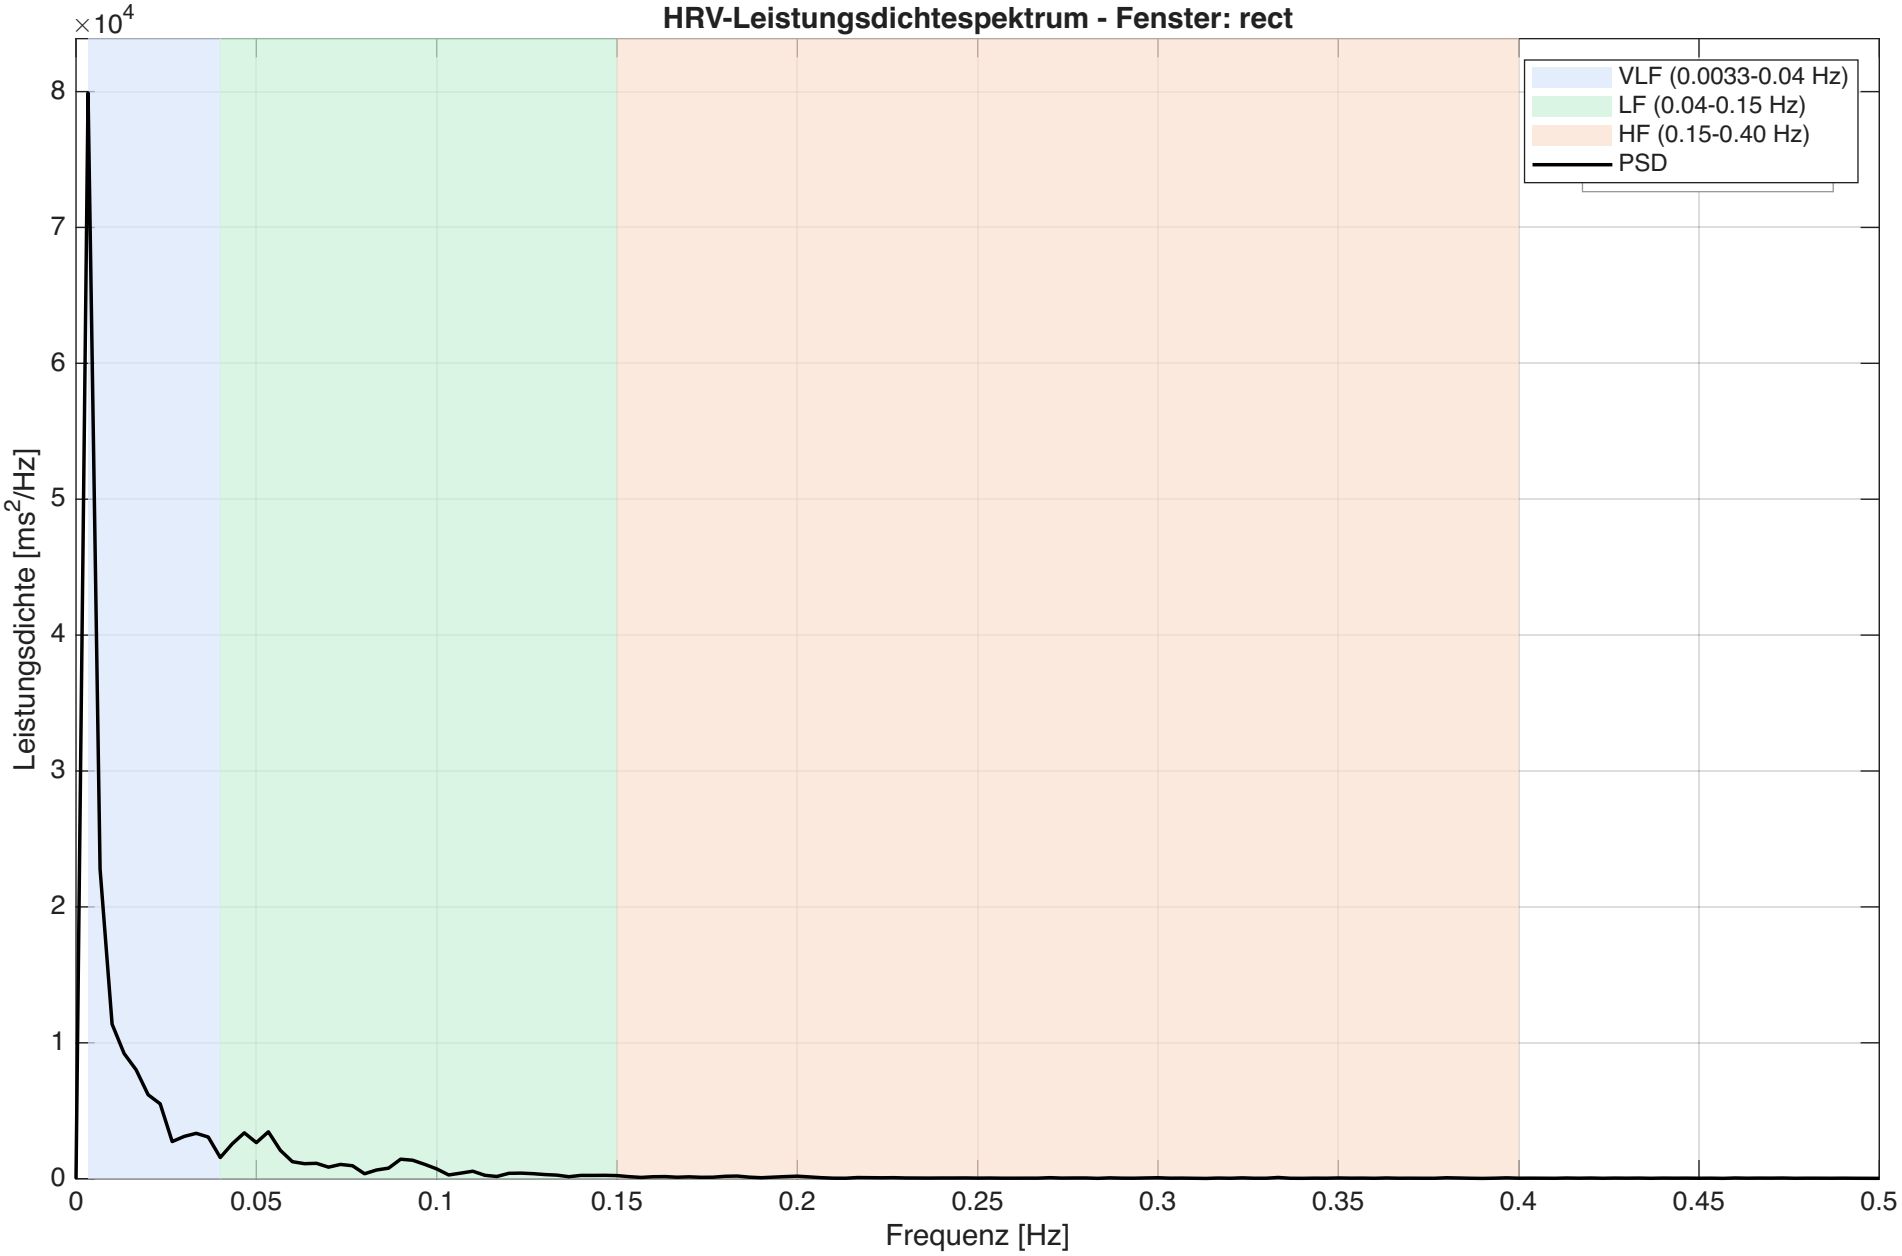


Ueberlagerte HRV-Spektren (logarithmisch) - Leakage-Vergleich

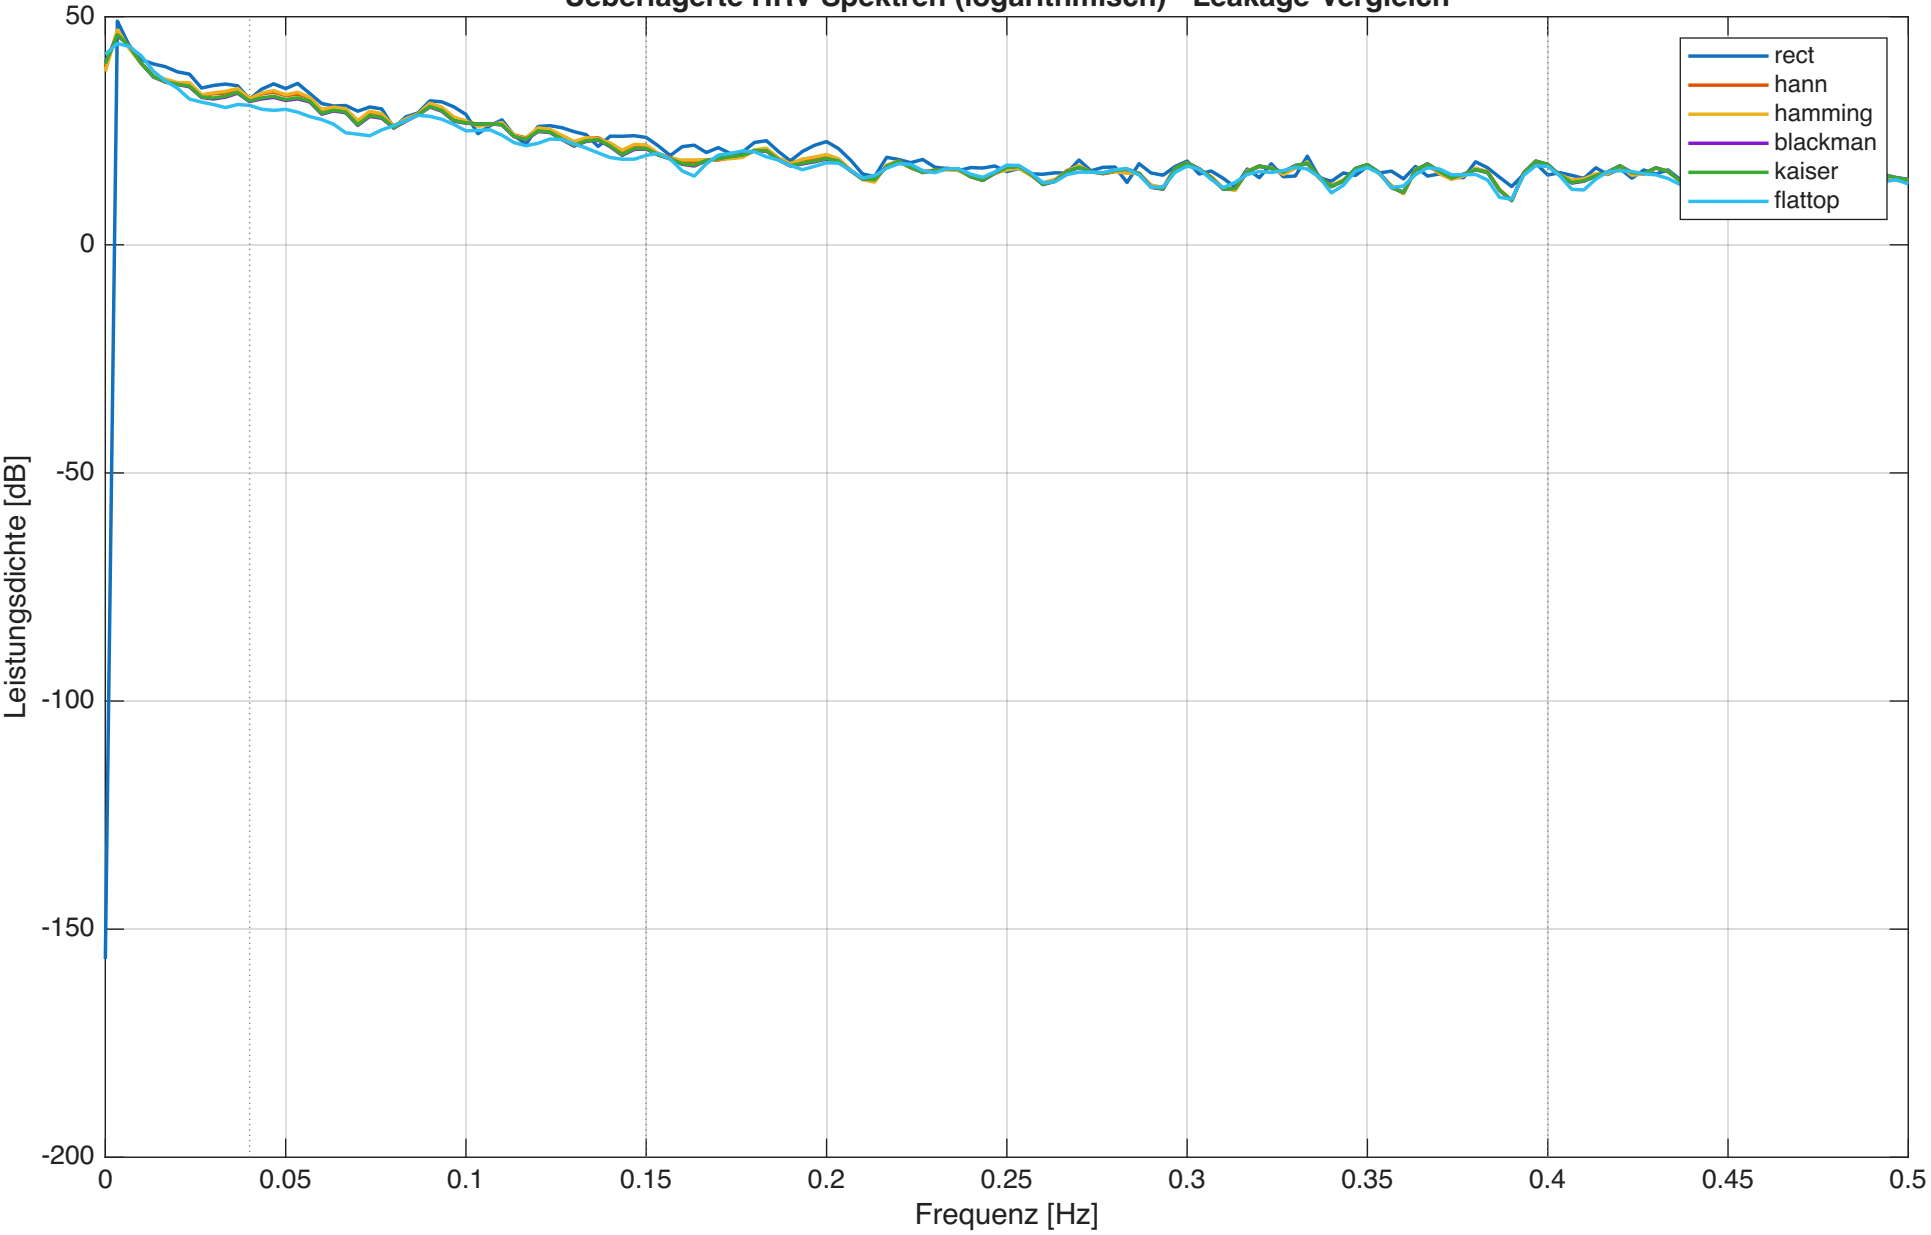


Ueberlagerte HRV-Spektren (linear)

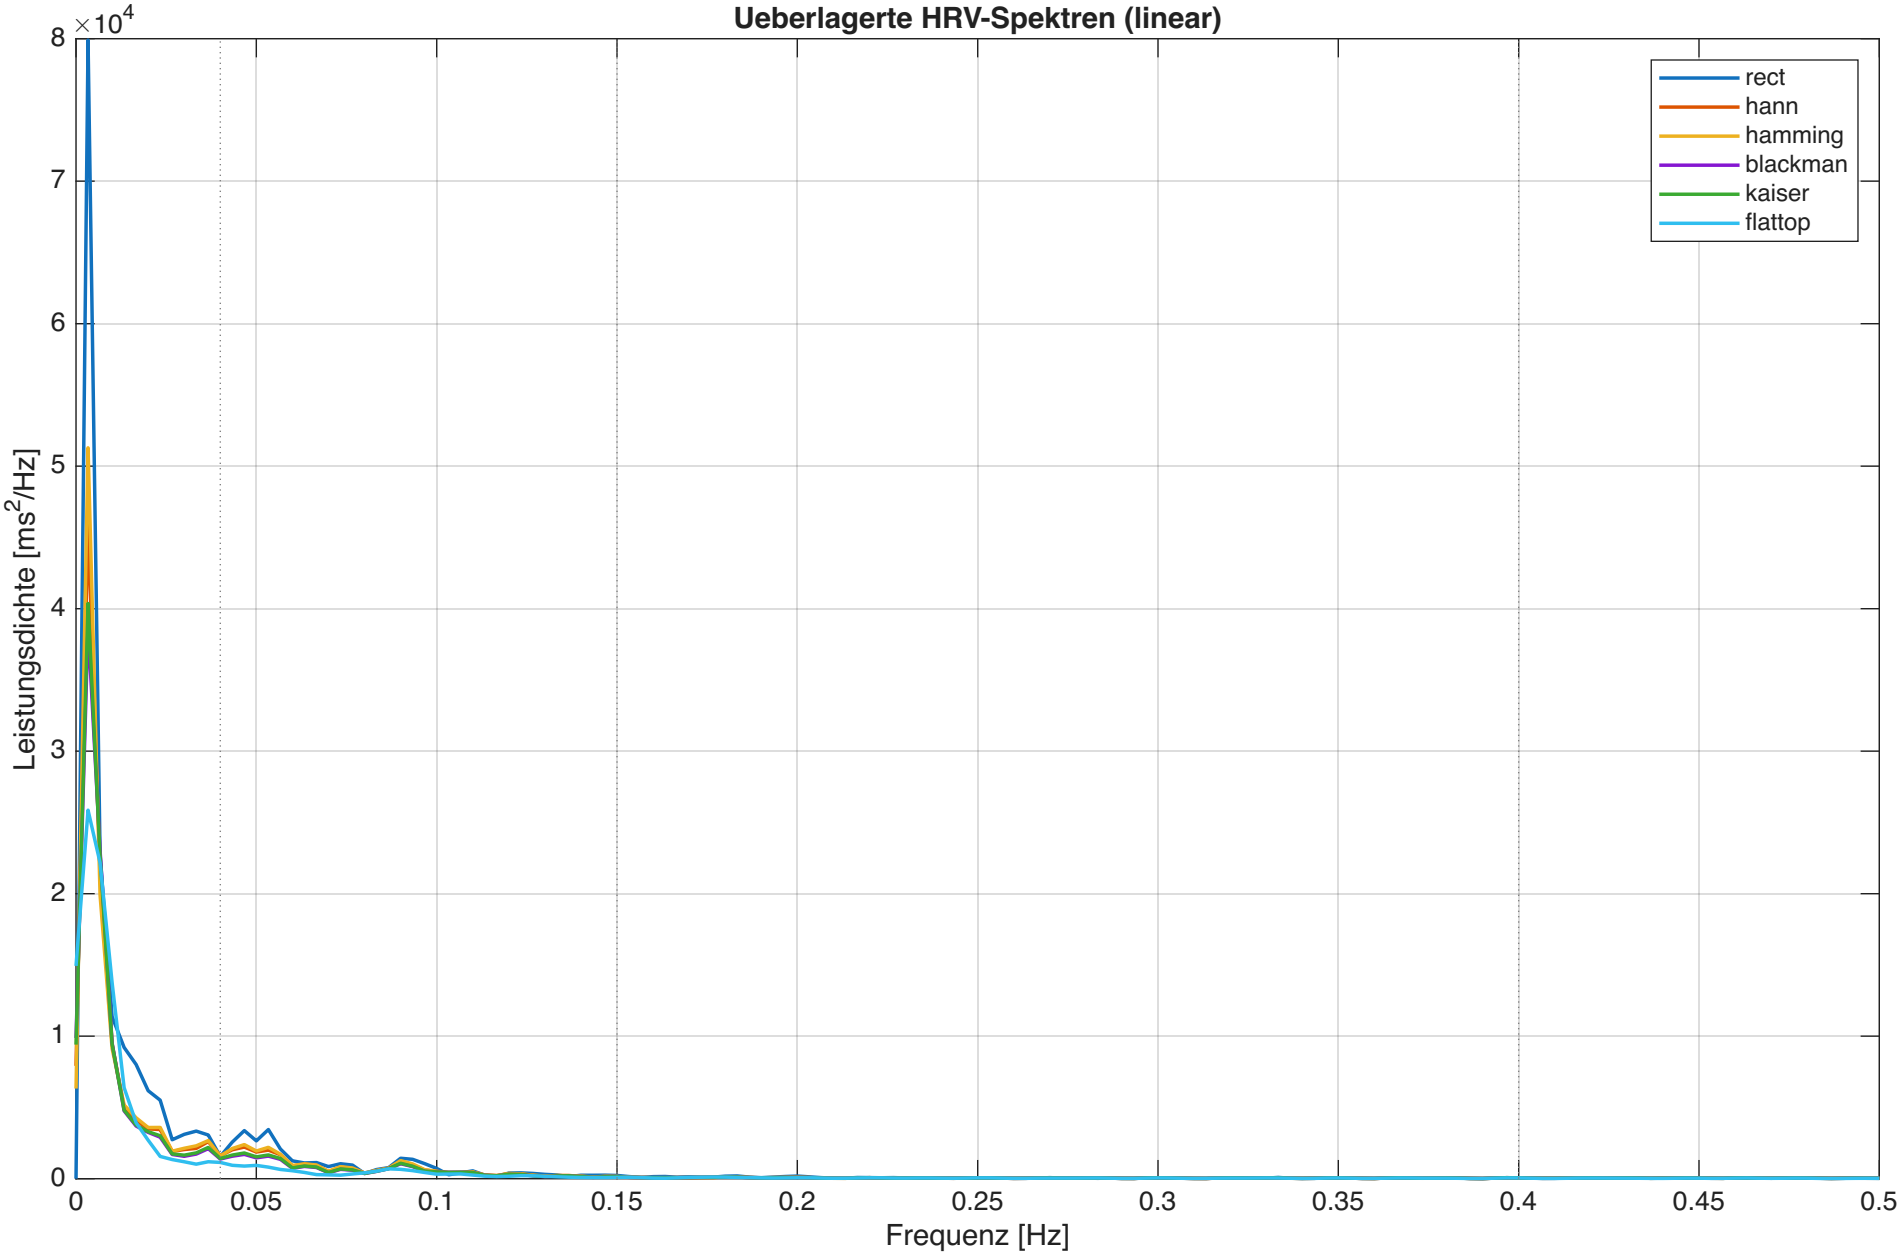


Fensterfunktionen - Zeitbereich

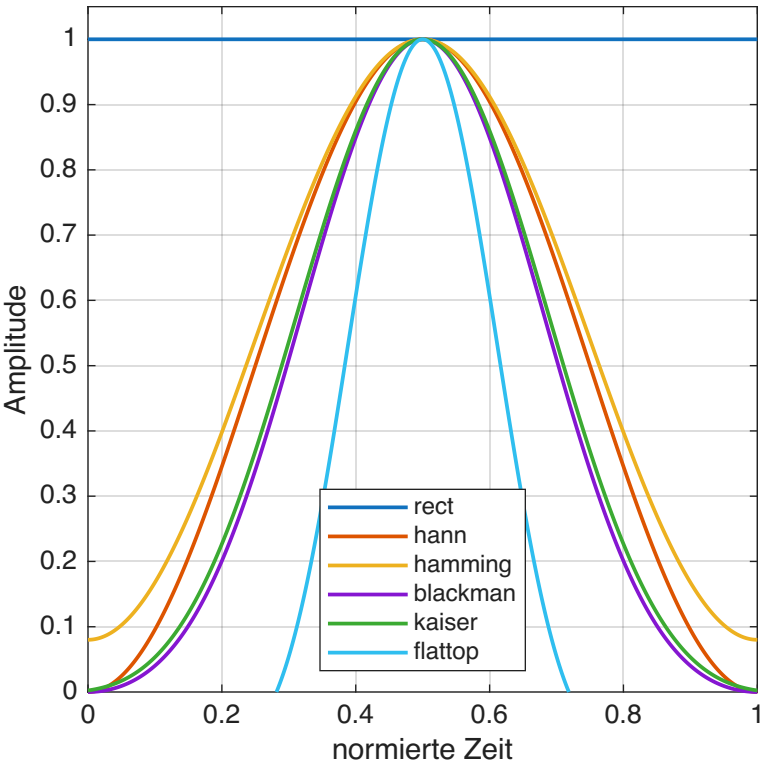


Fensterfunktionen - Frequenzgang

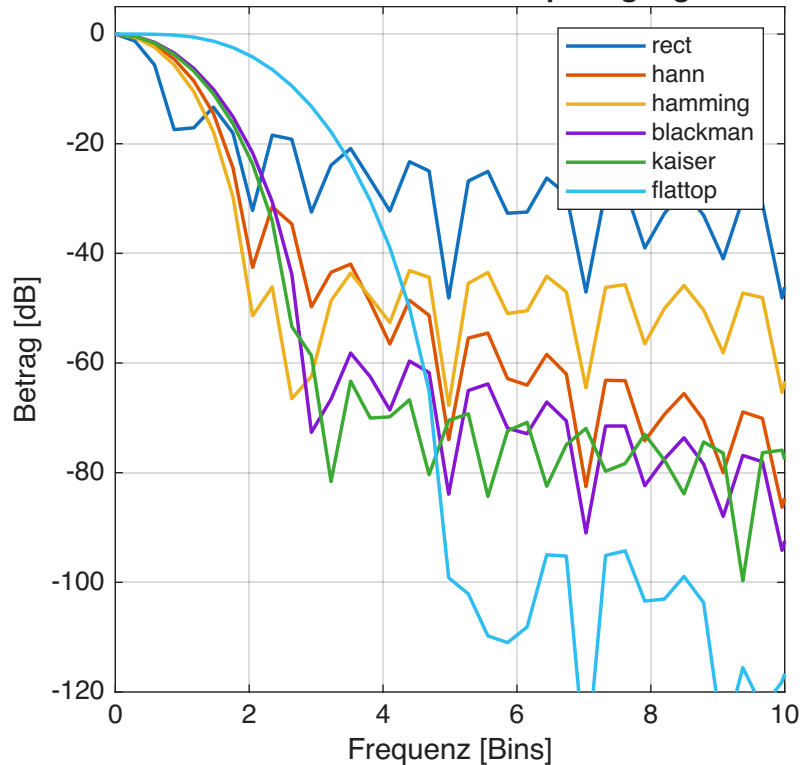


Tachogramm (RR-Intervalle) - 29 Artefakte korrigiert

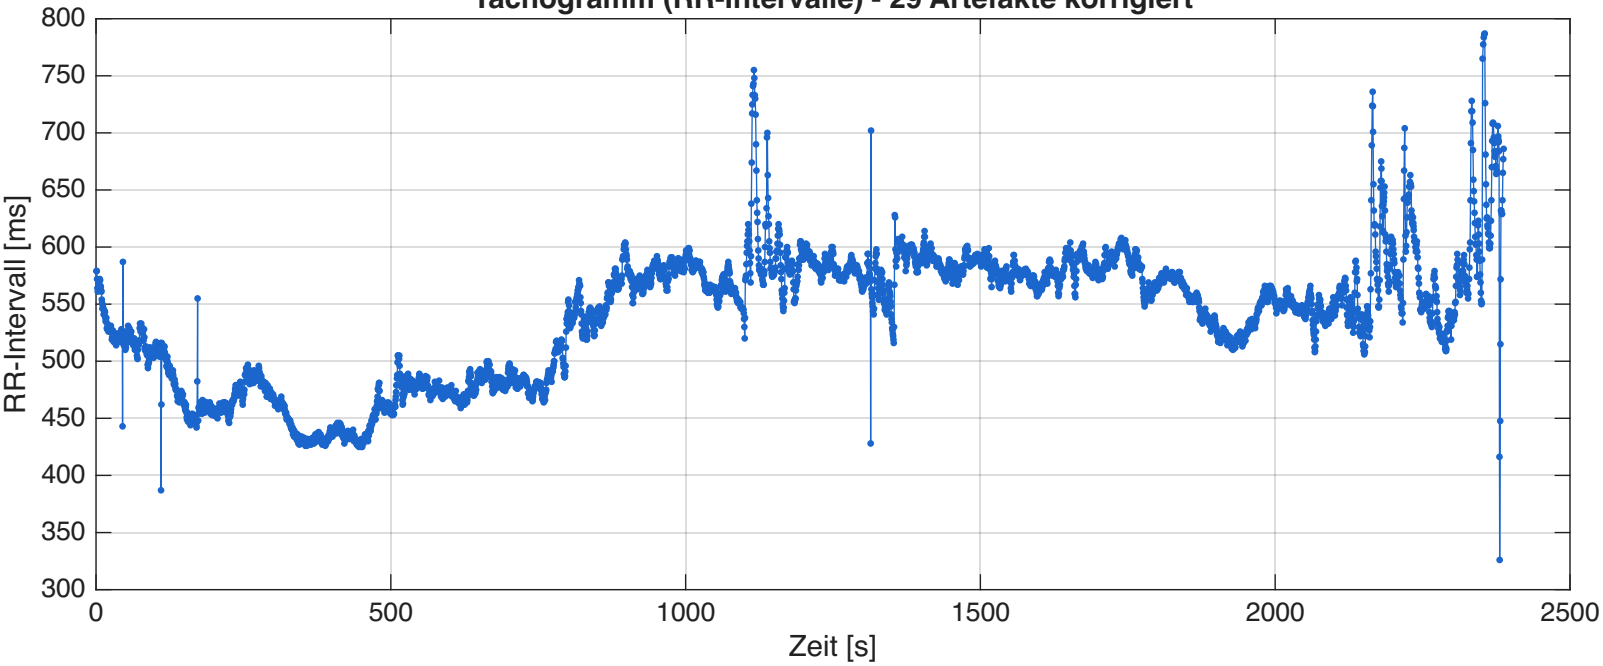


Erkannte R-Zacken (erste 10 s)

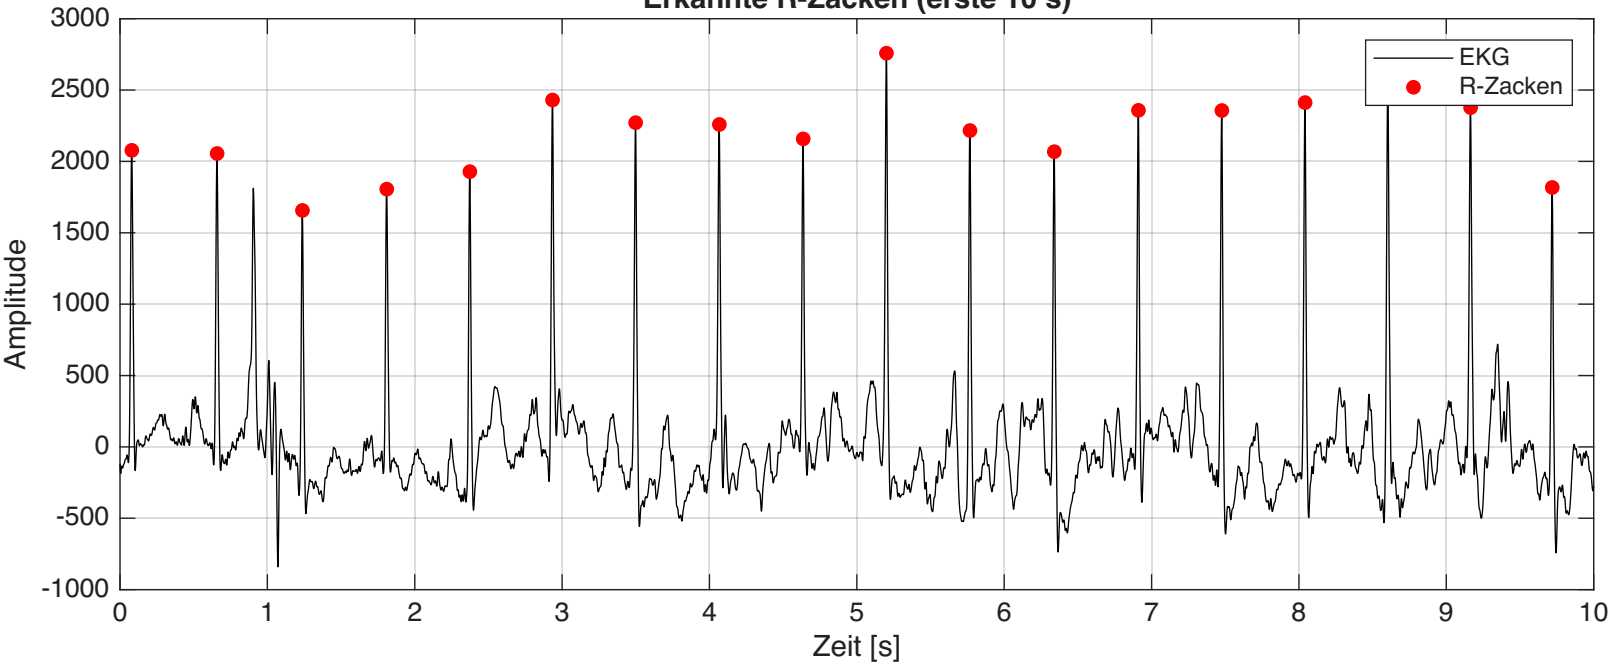


EKG - Rohsignal (Ausschnitt 10-20 s)

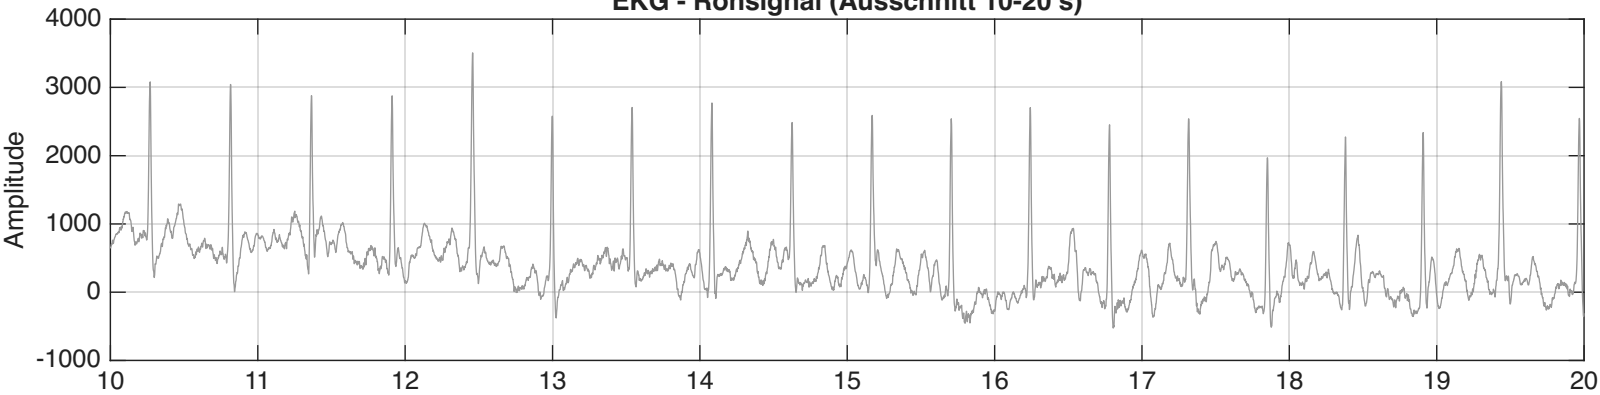


EKG - nach Vorverarbeitung (Ausschnitt 10-20 s)

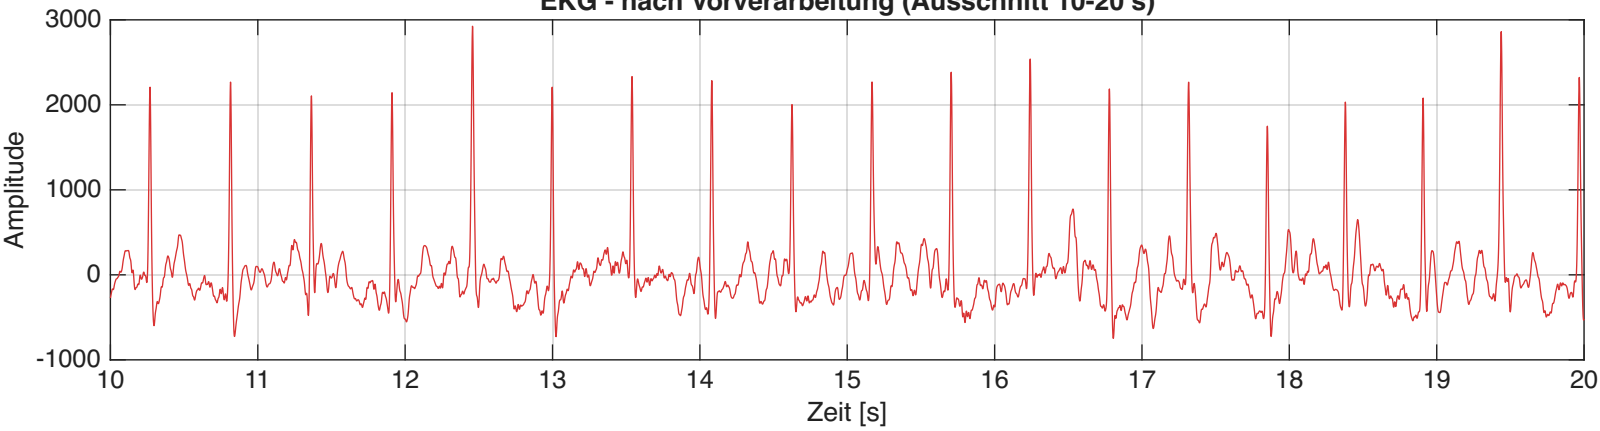


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: flattop

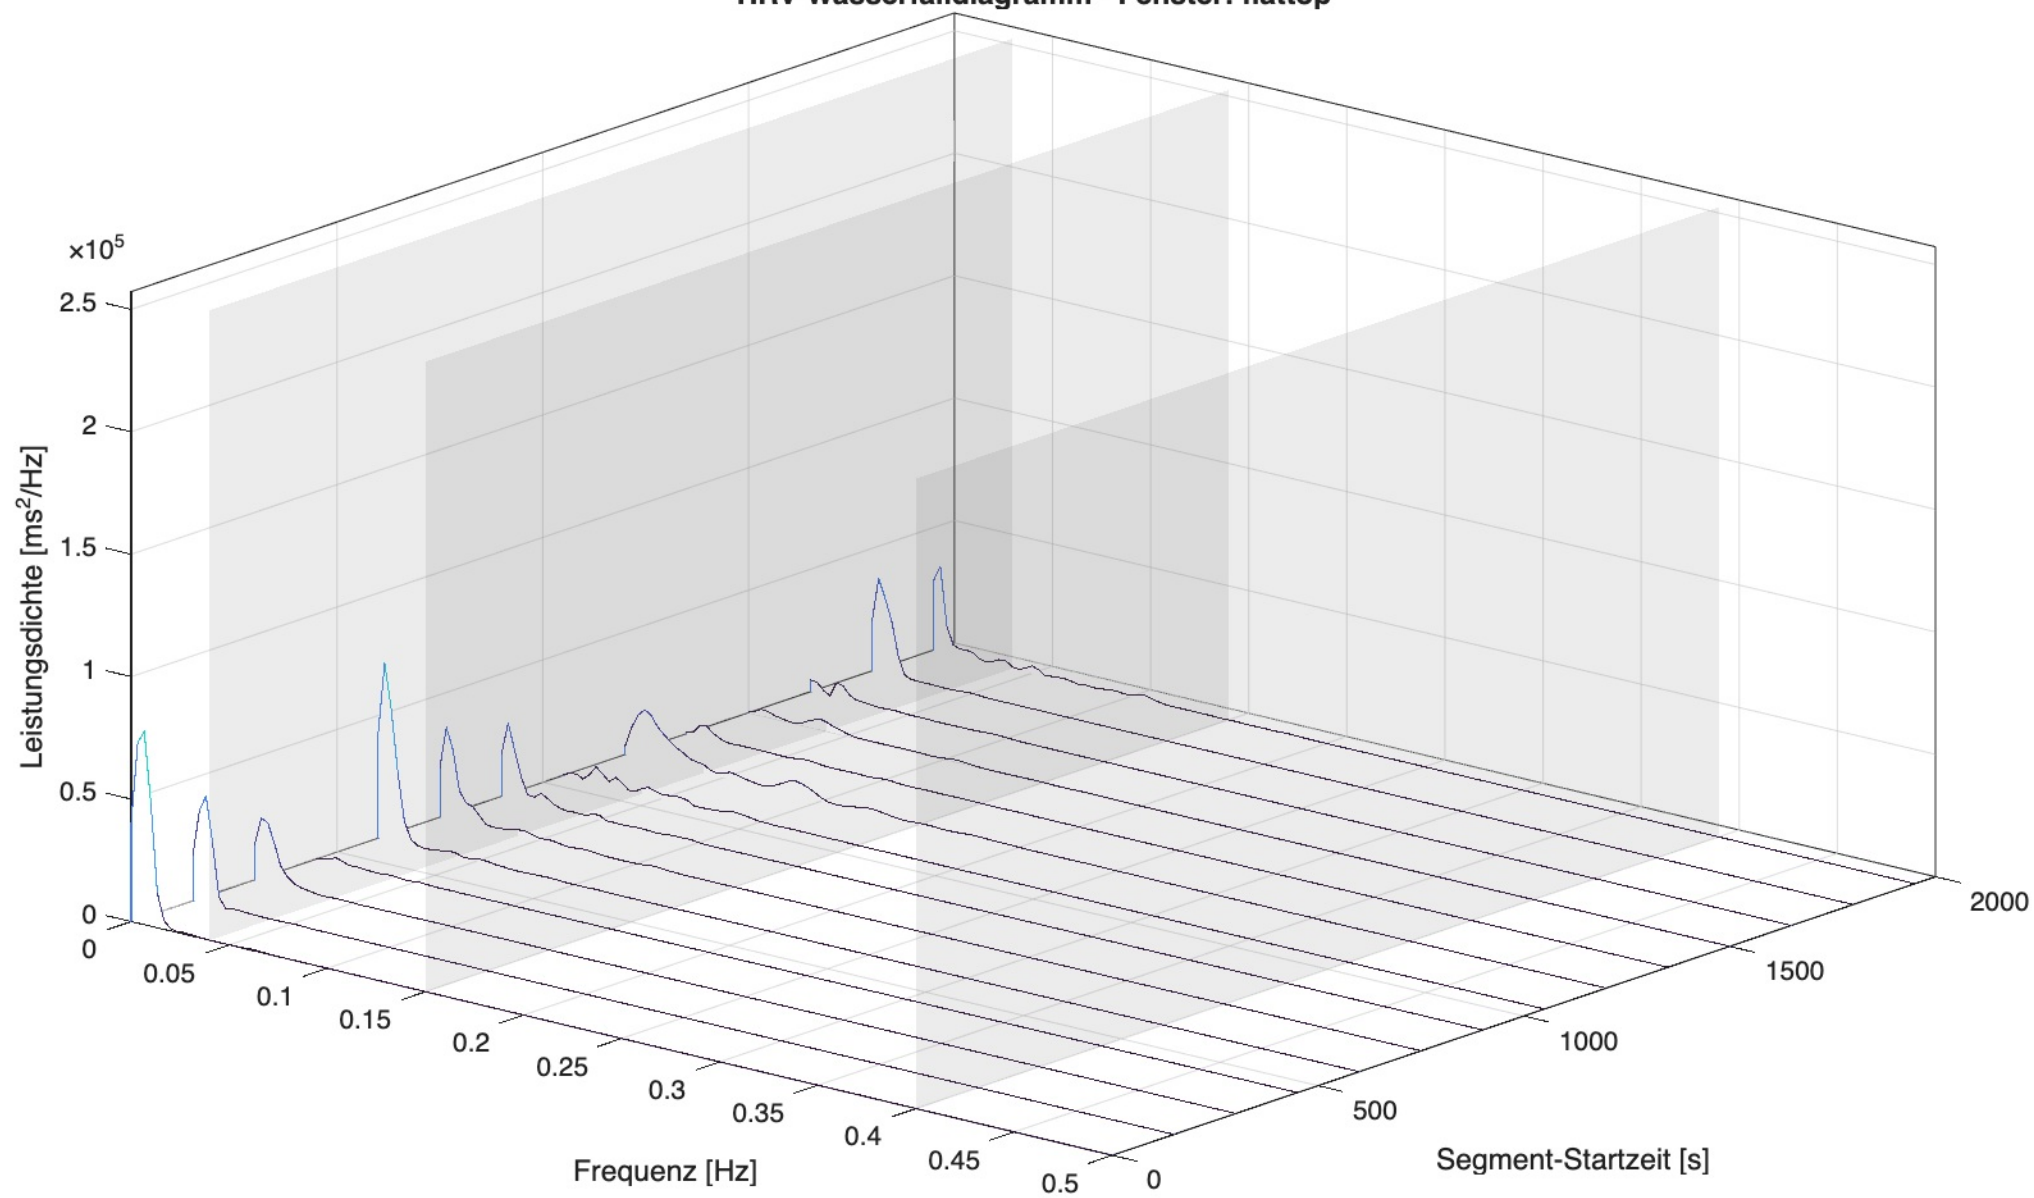


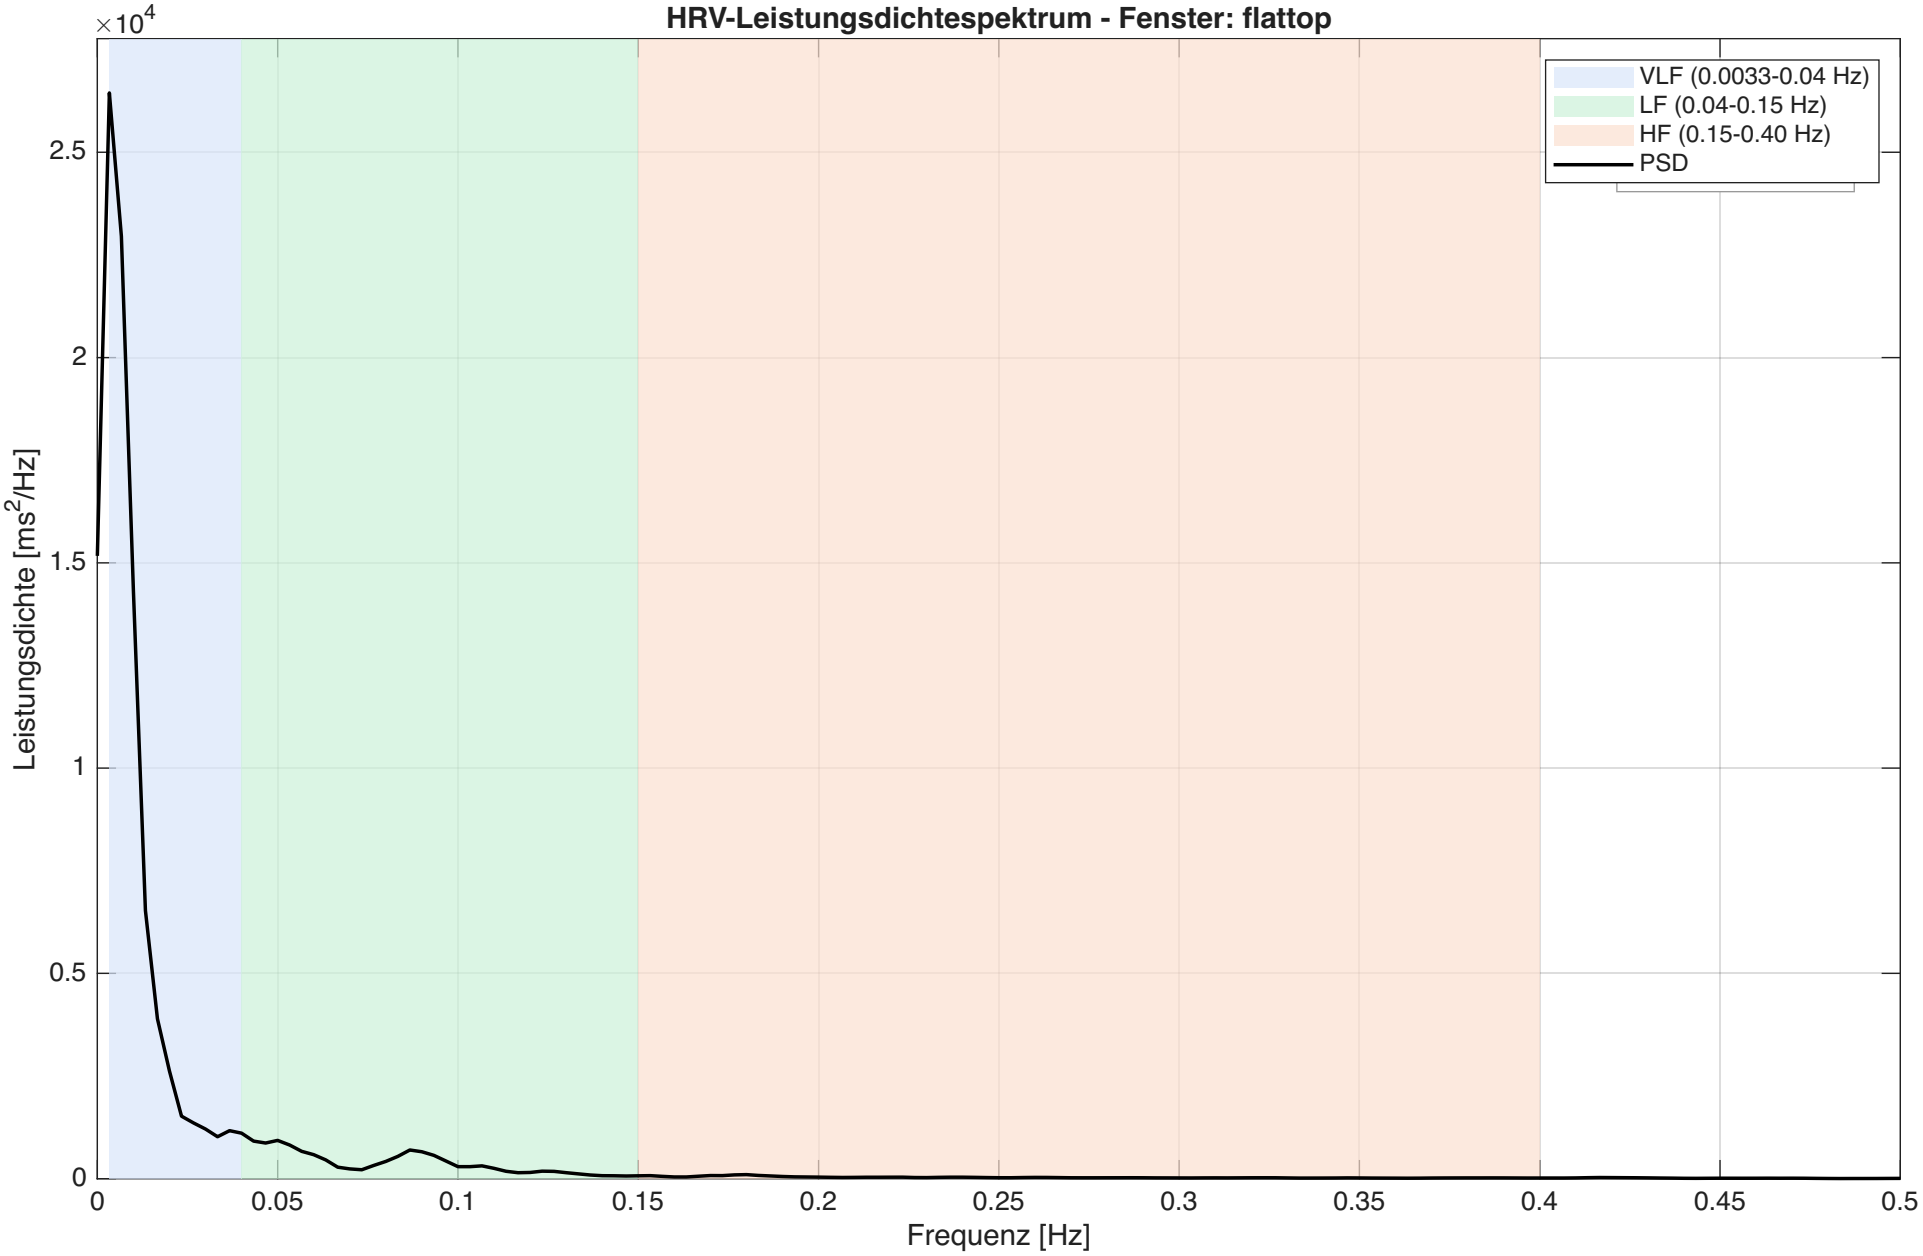


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: kaiser

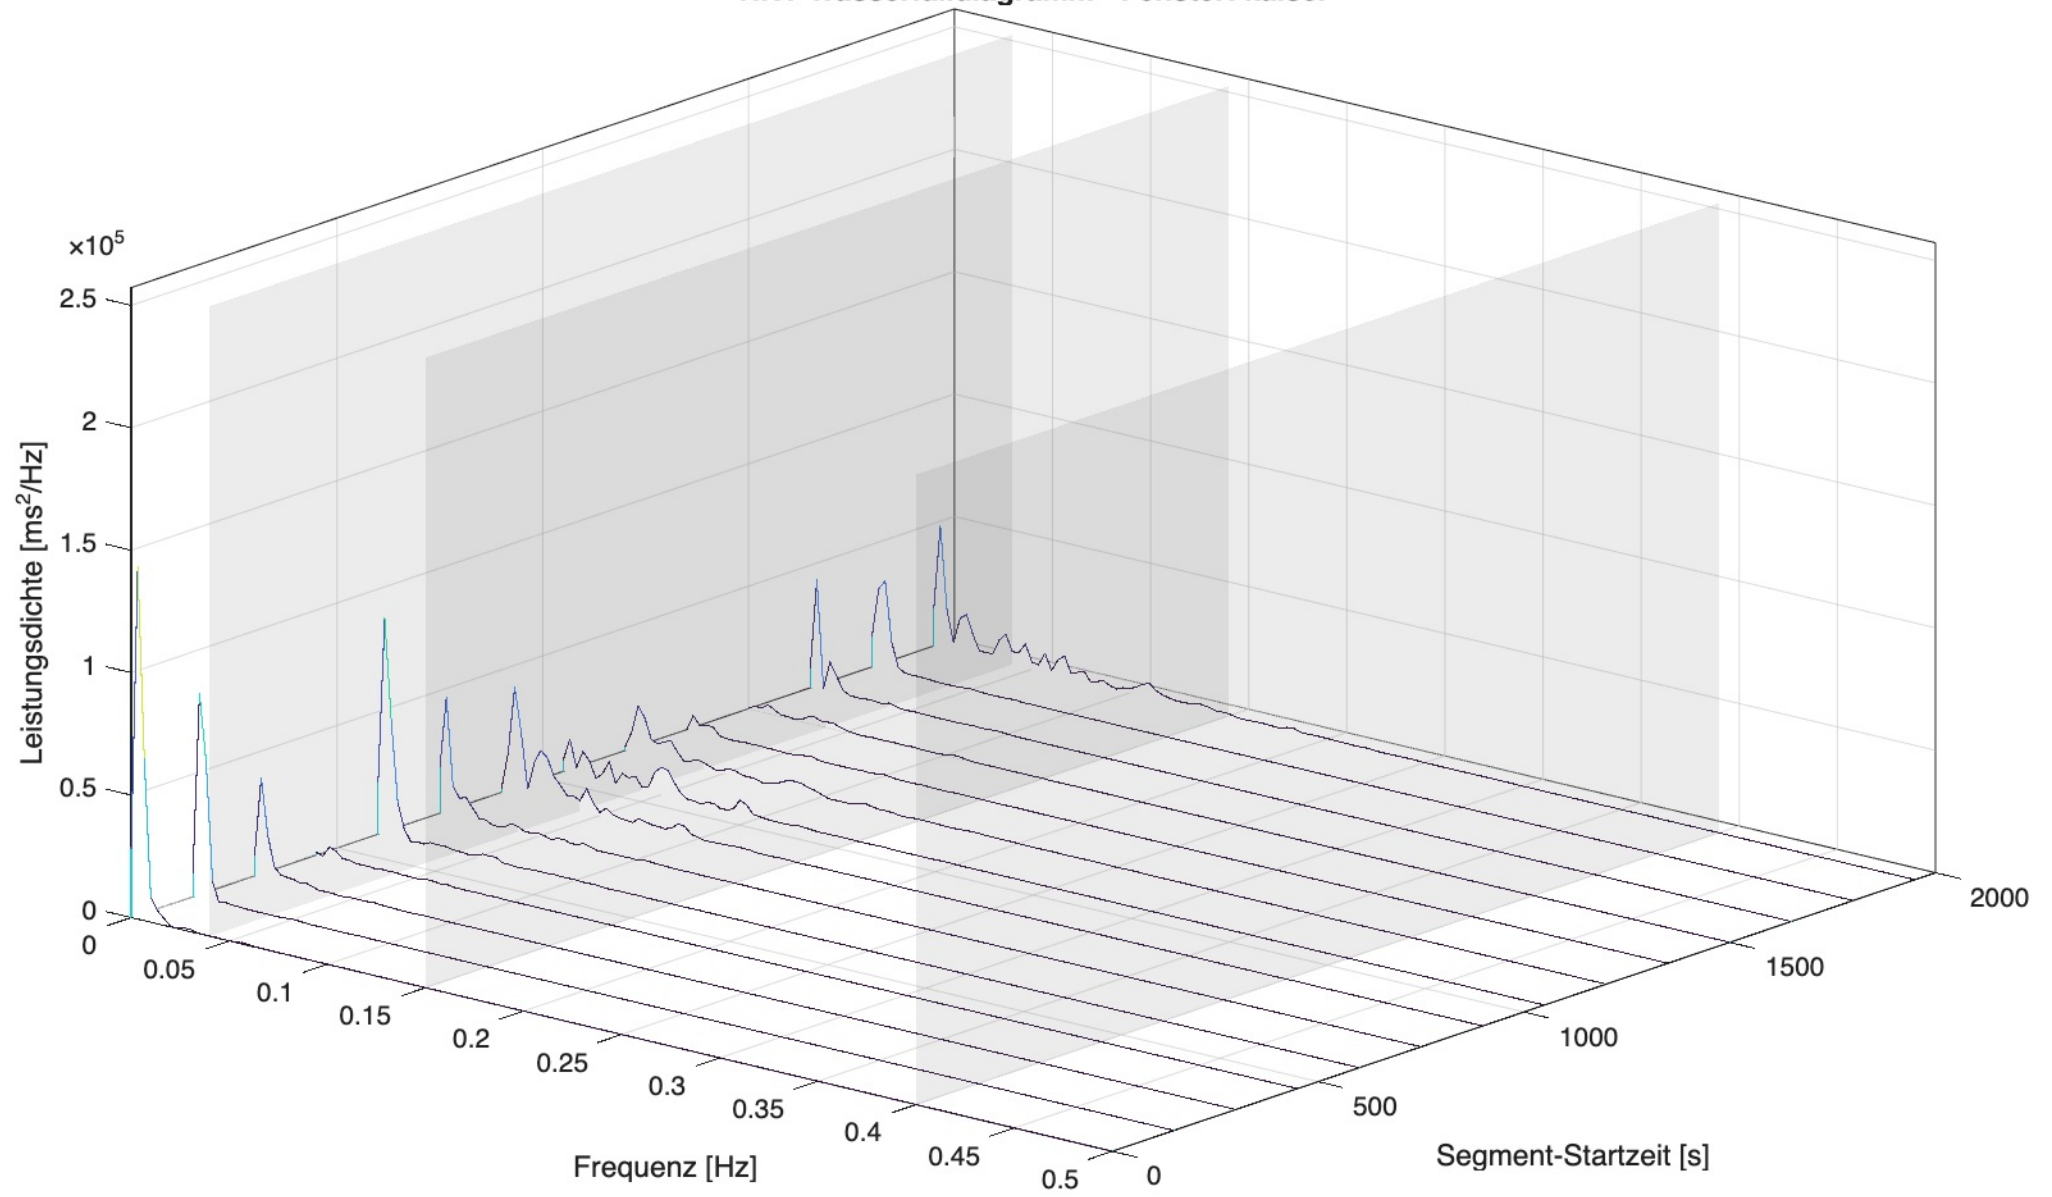


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: kaiser

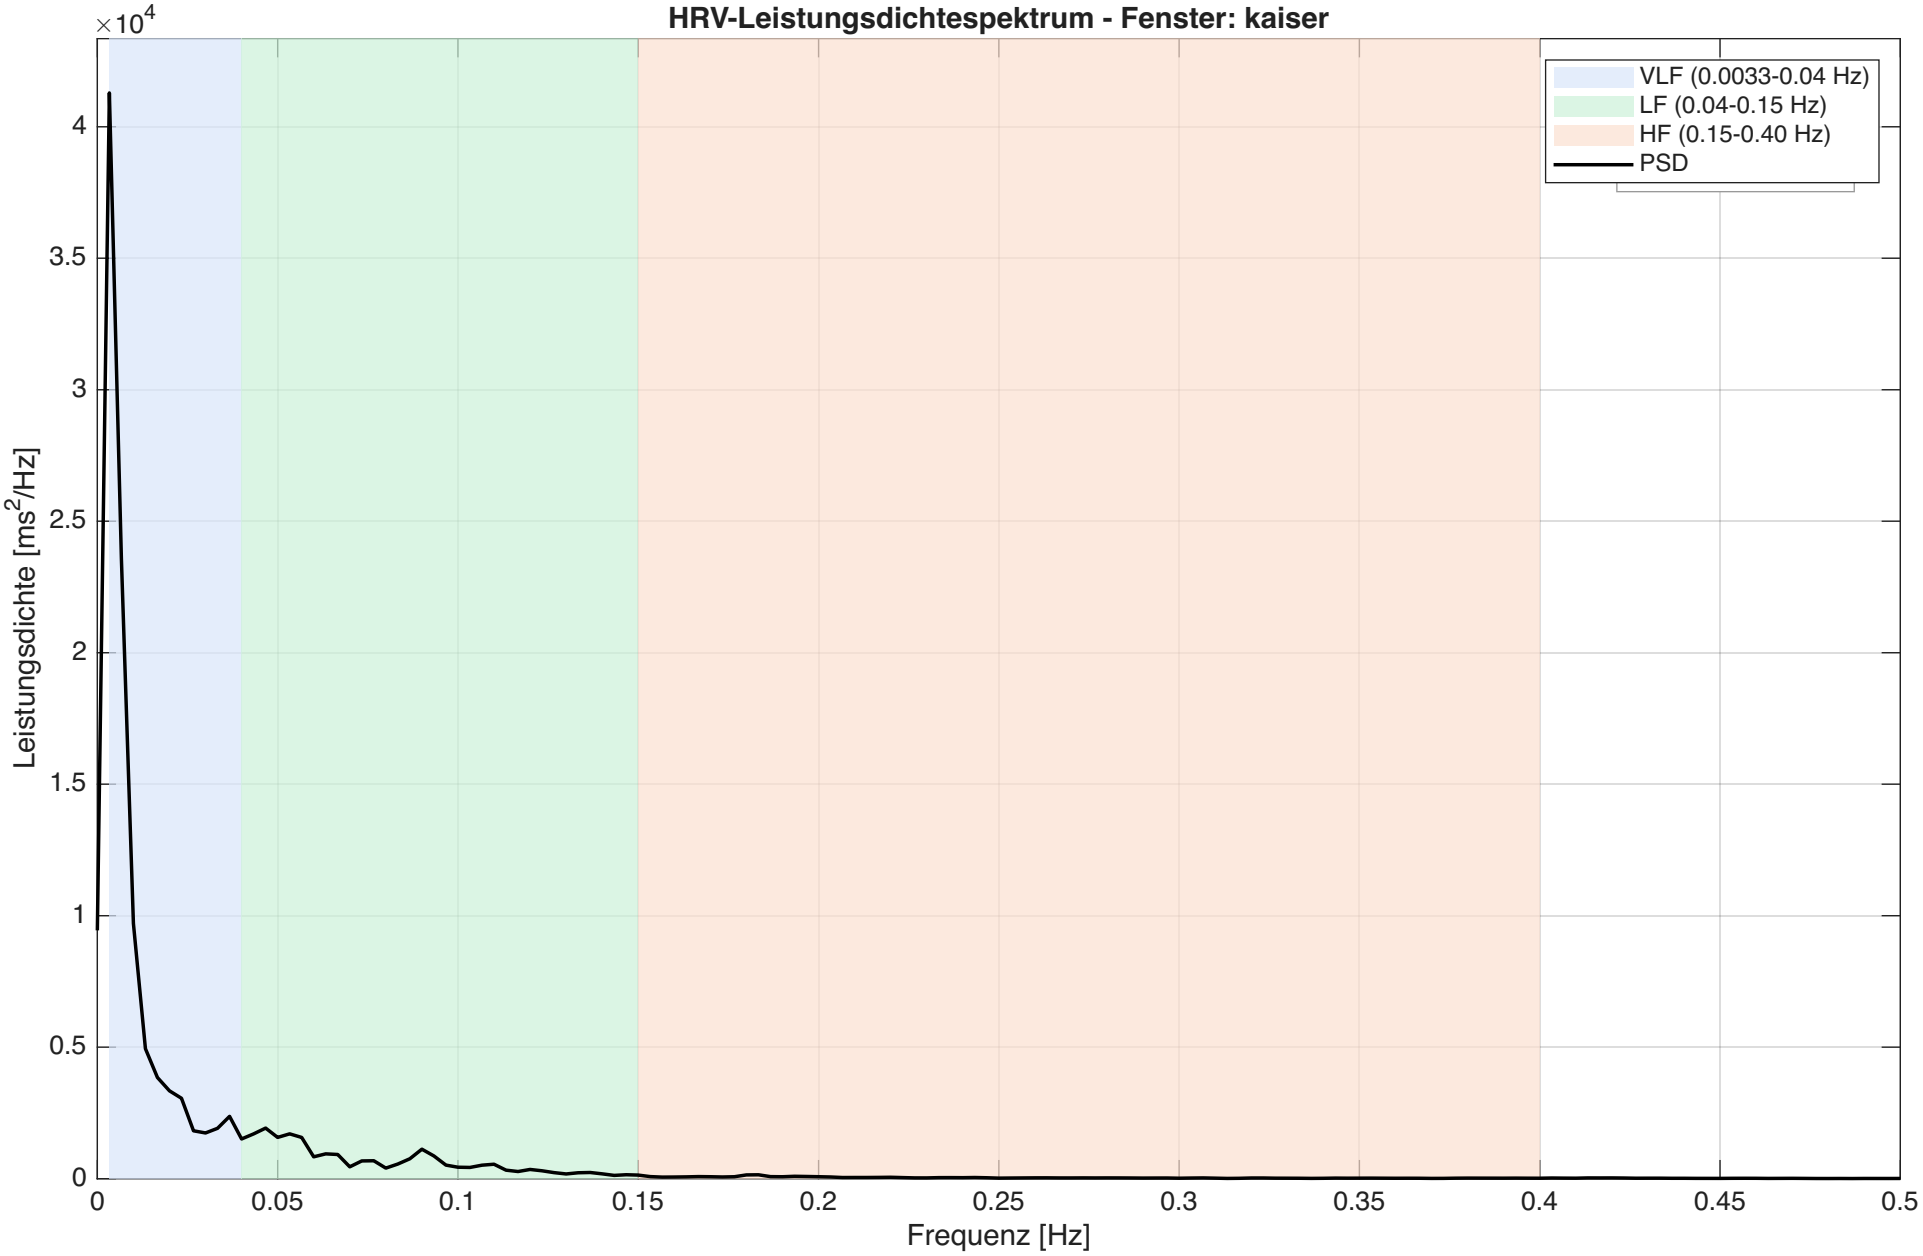


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: blackman

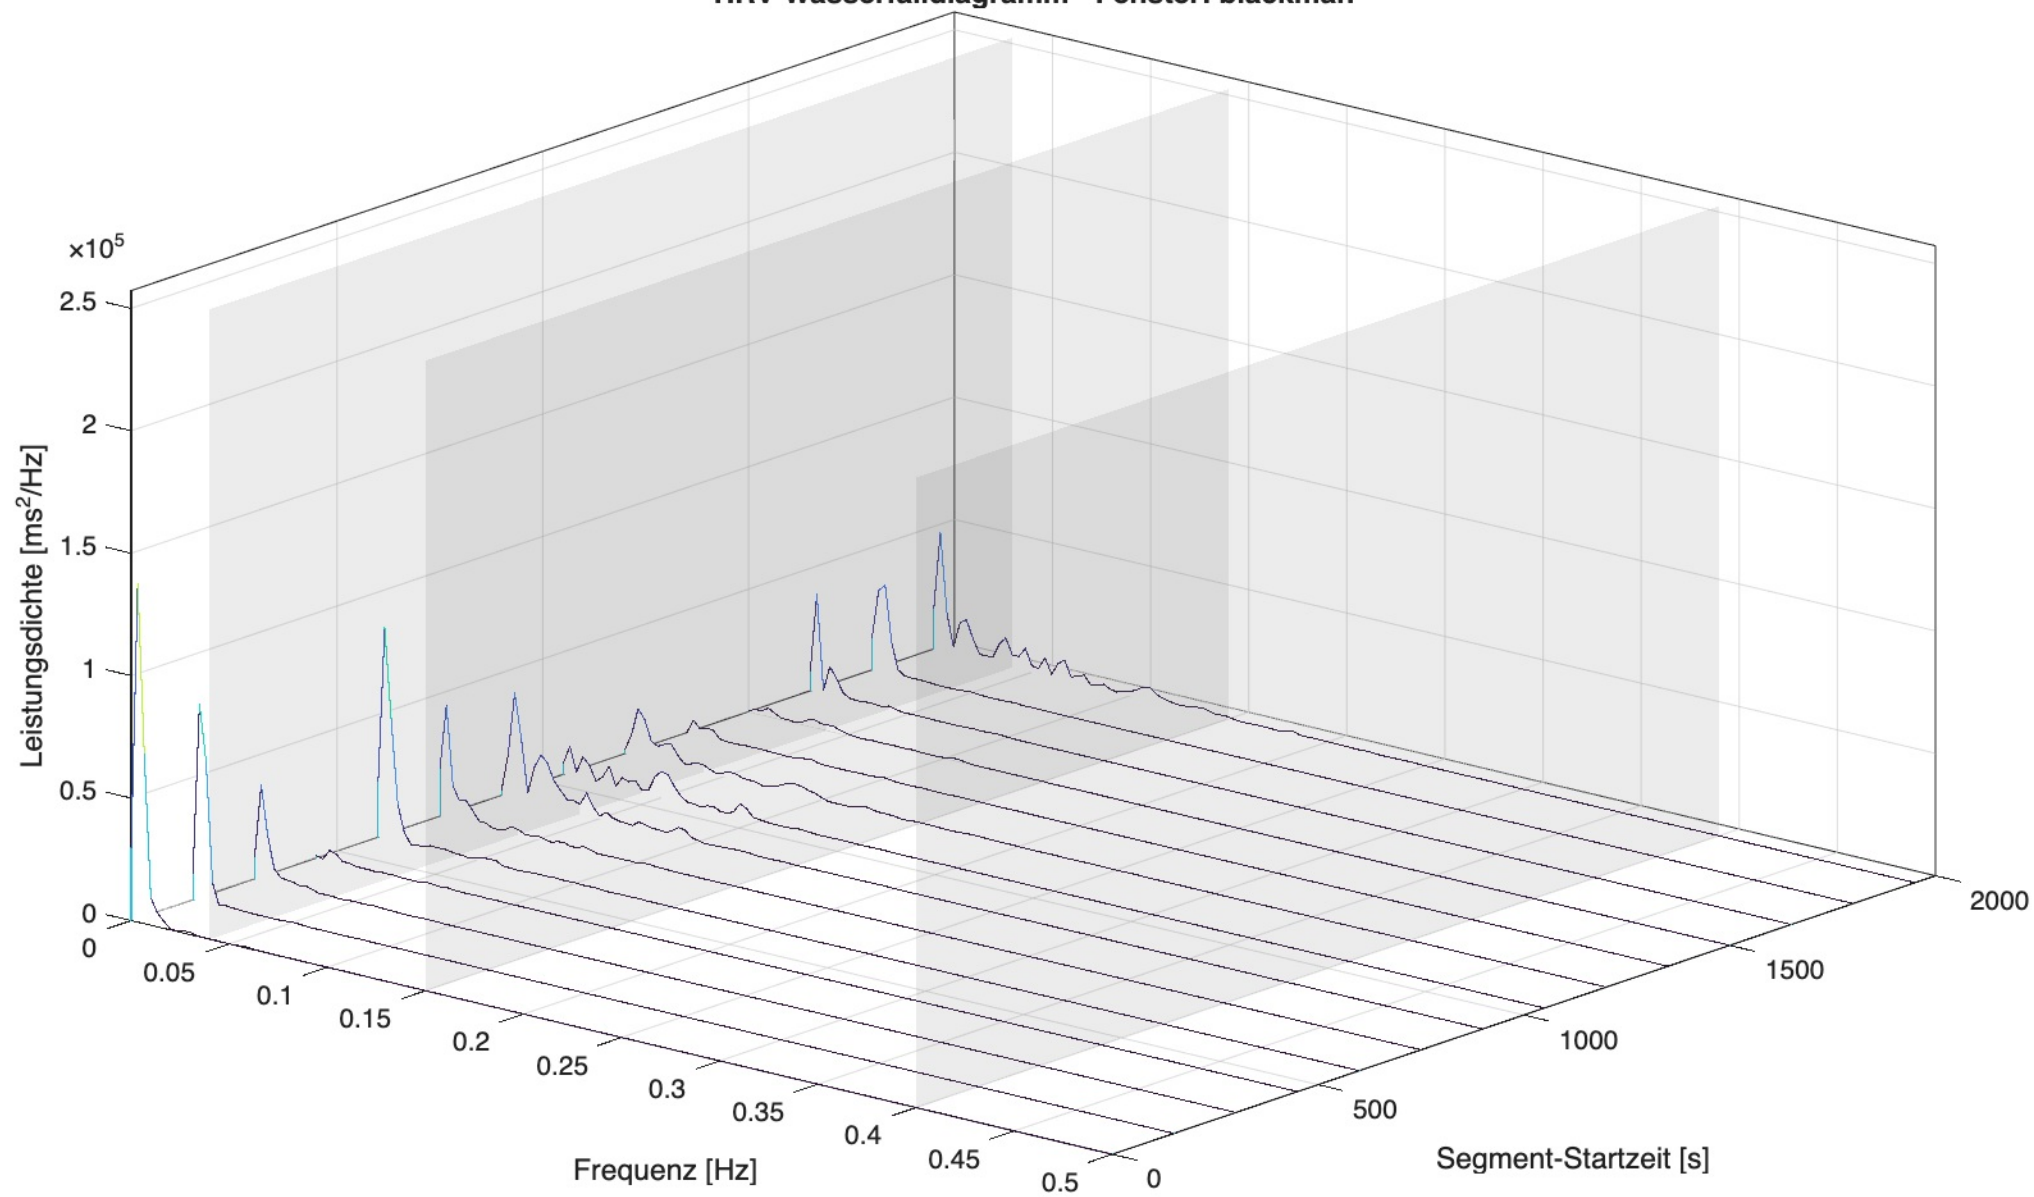


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: blackman

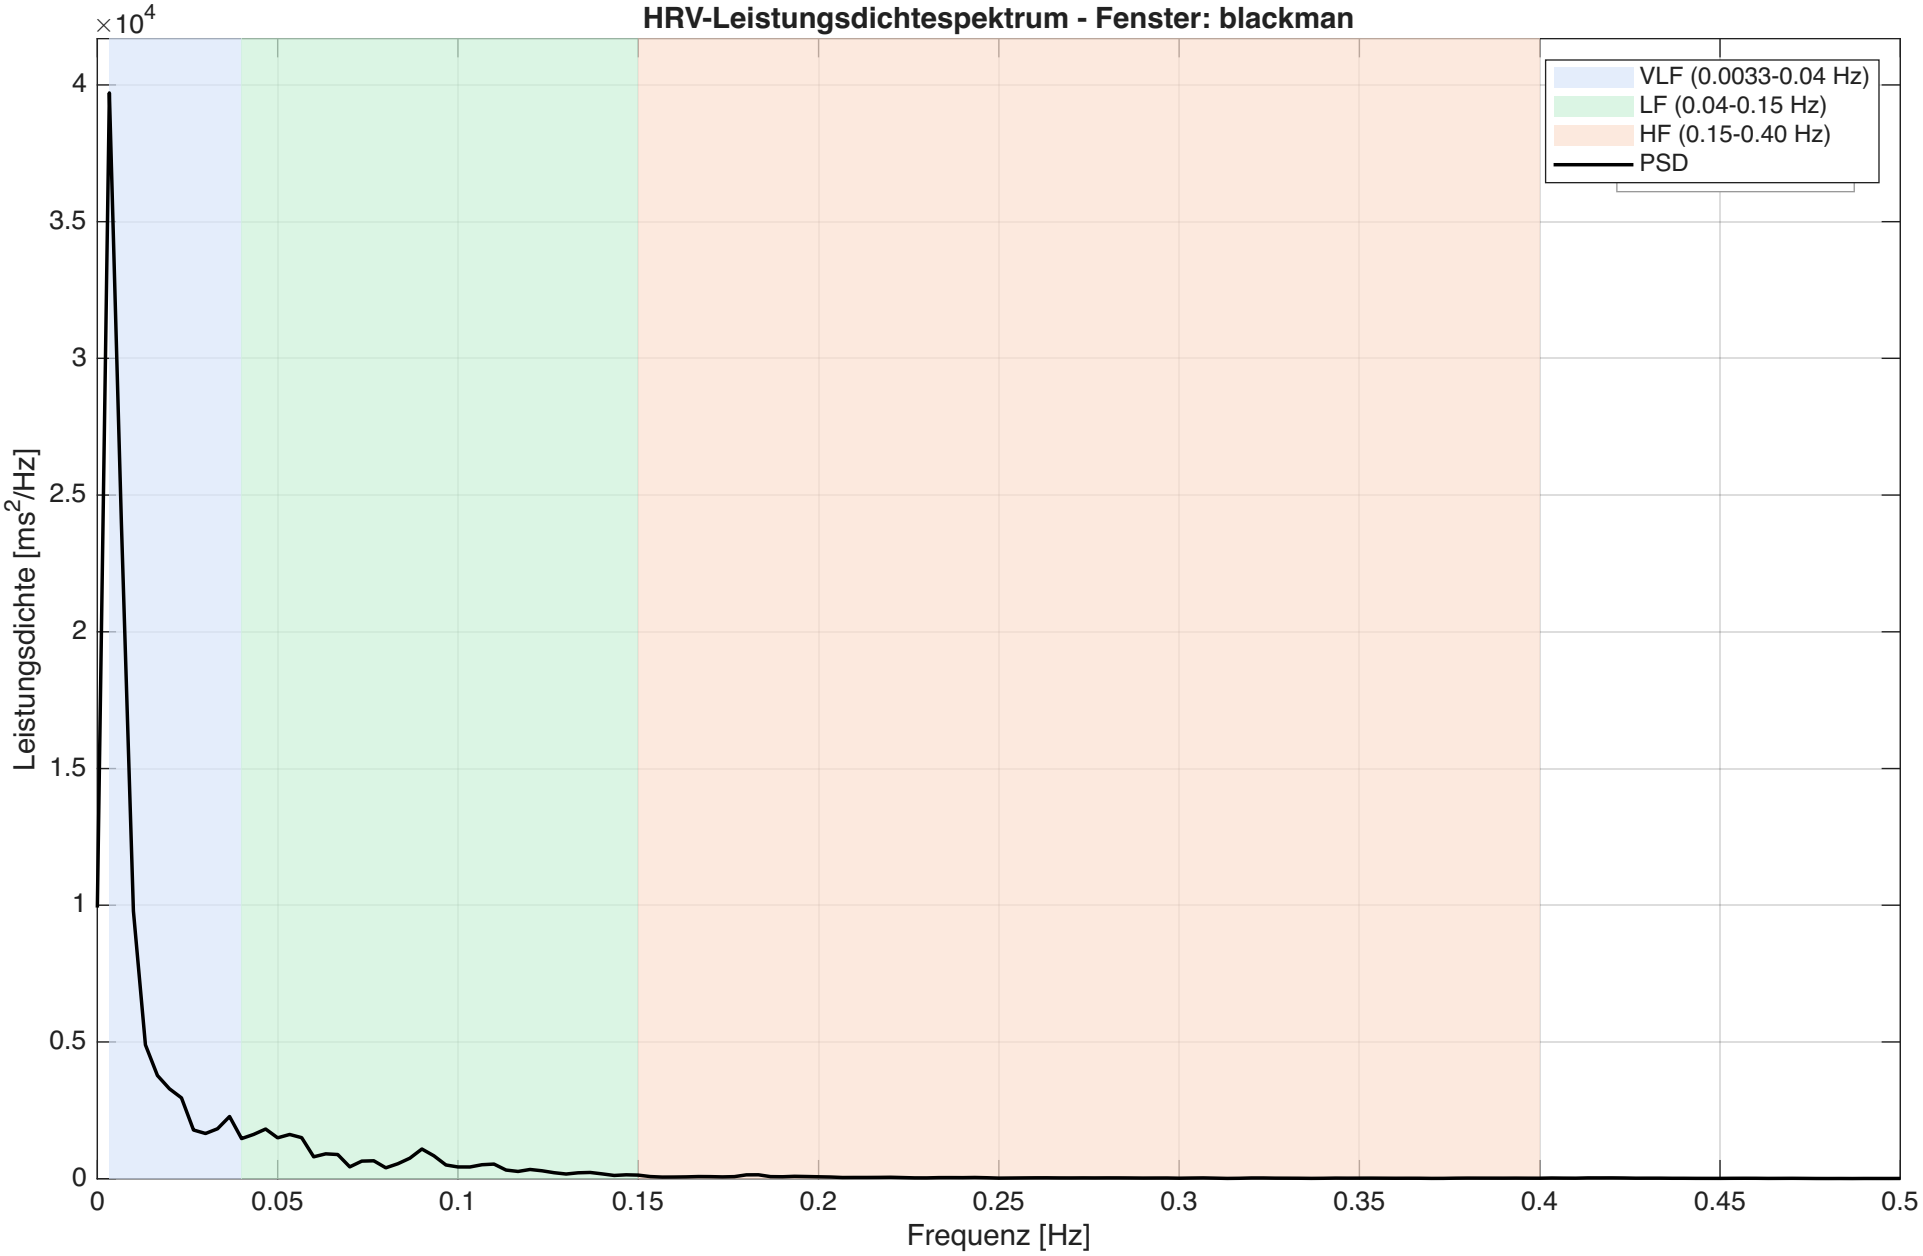


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: hamming

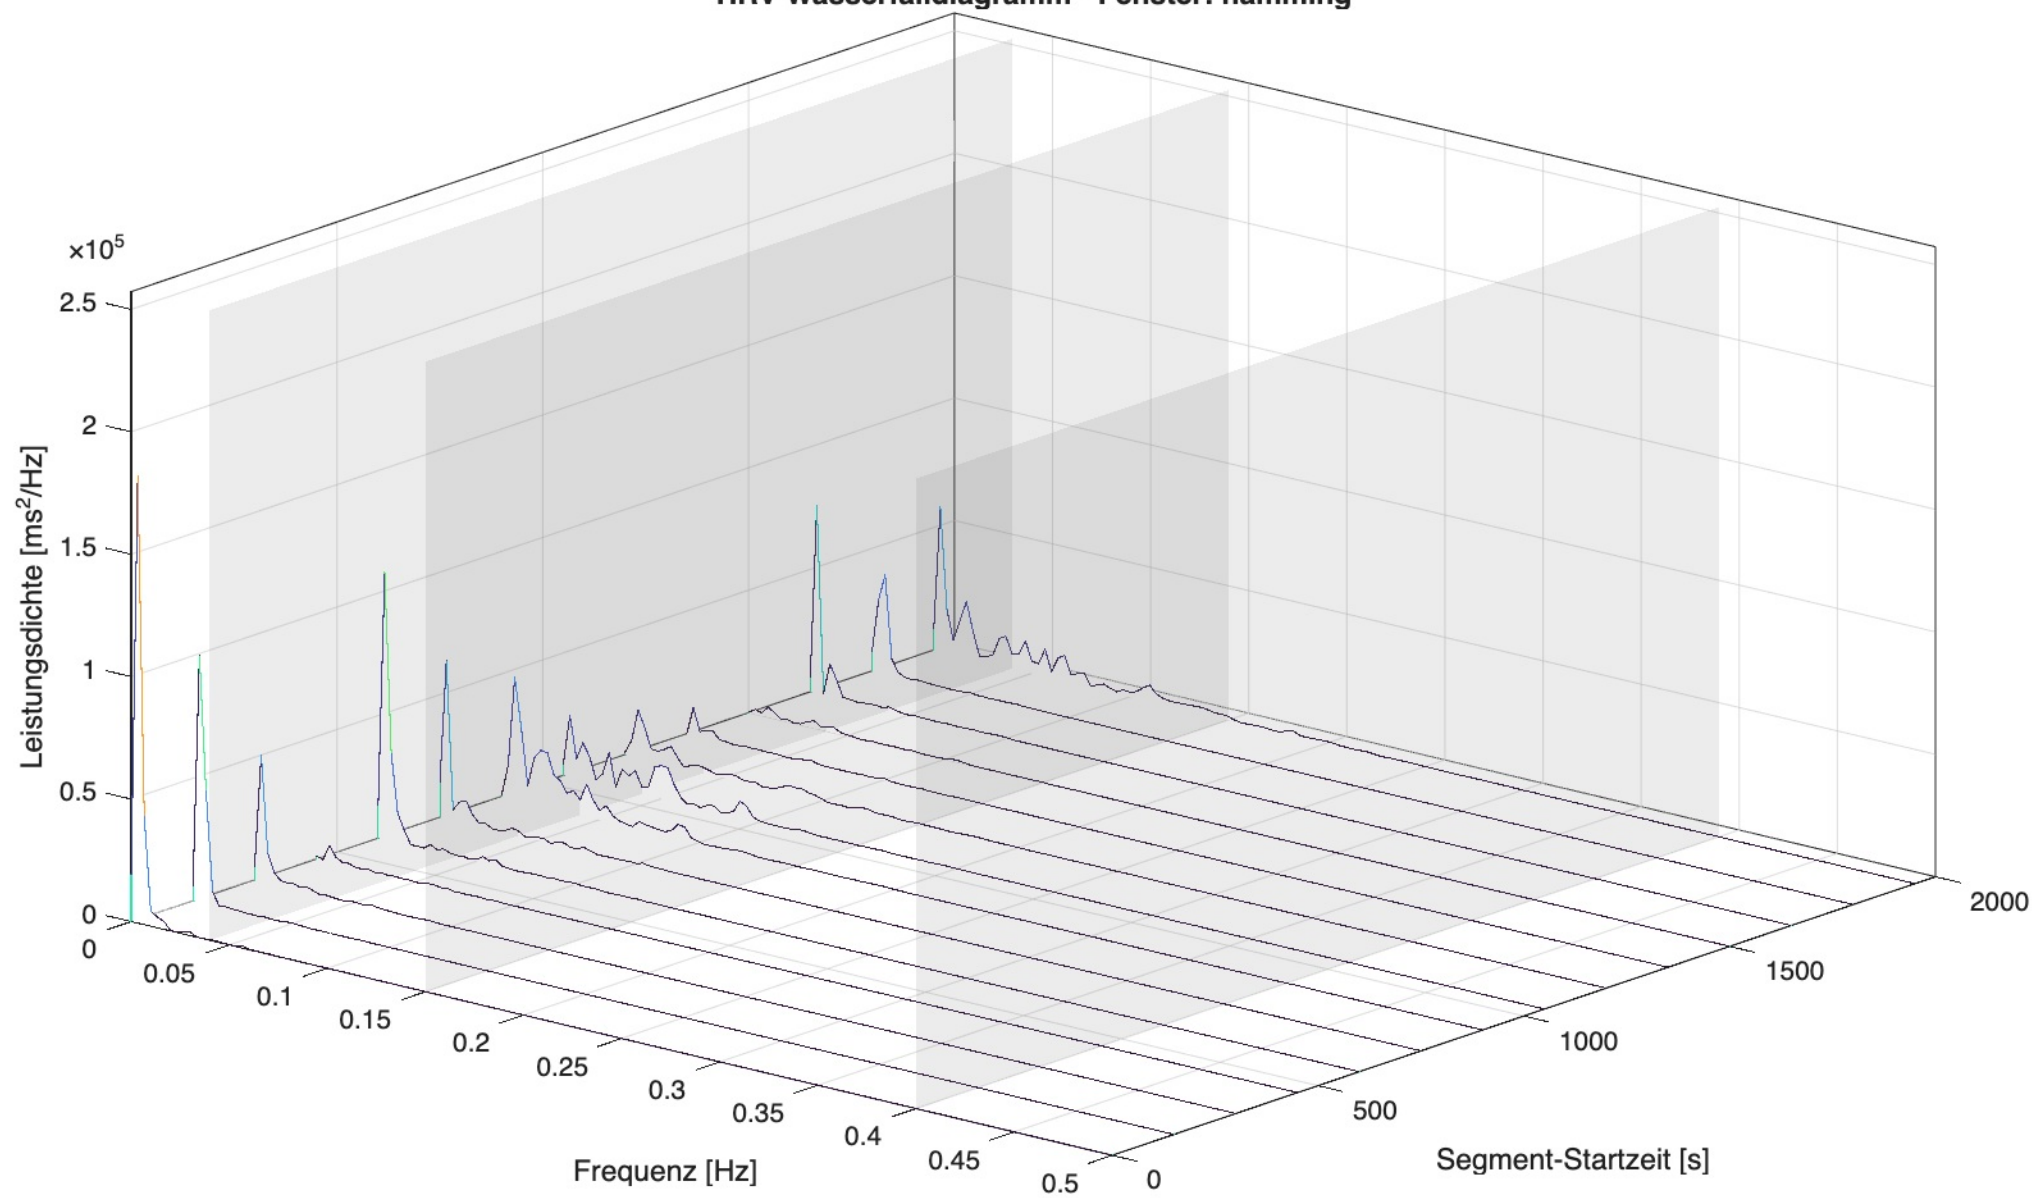


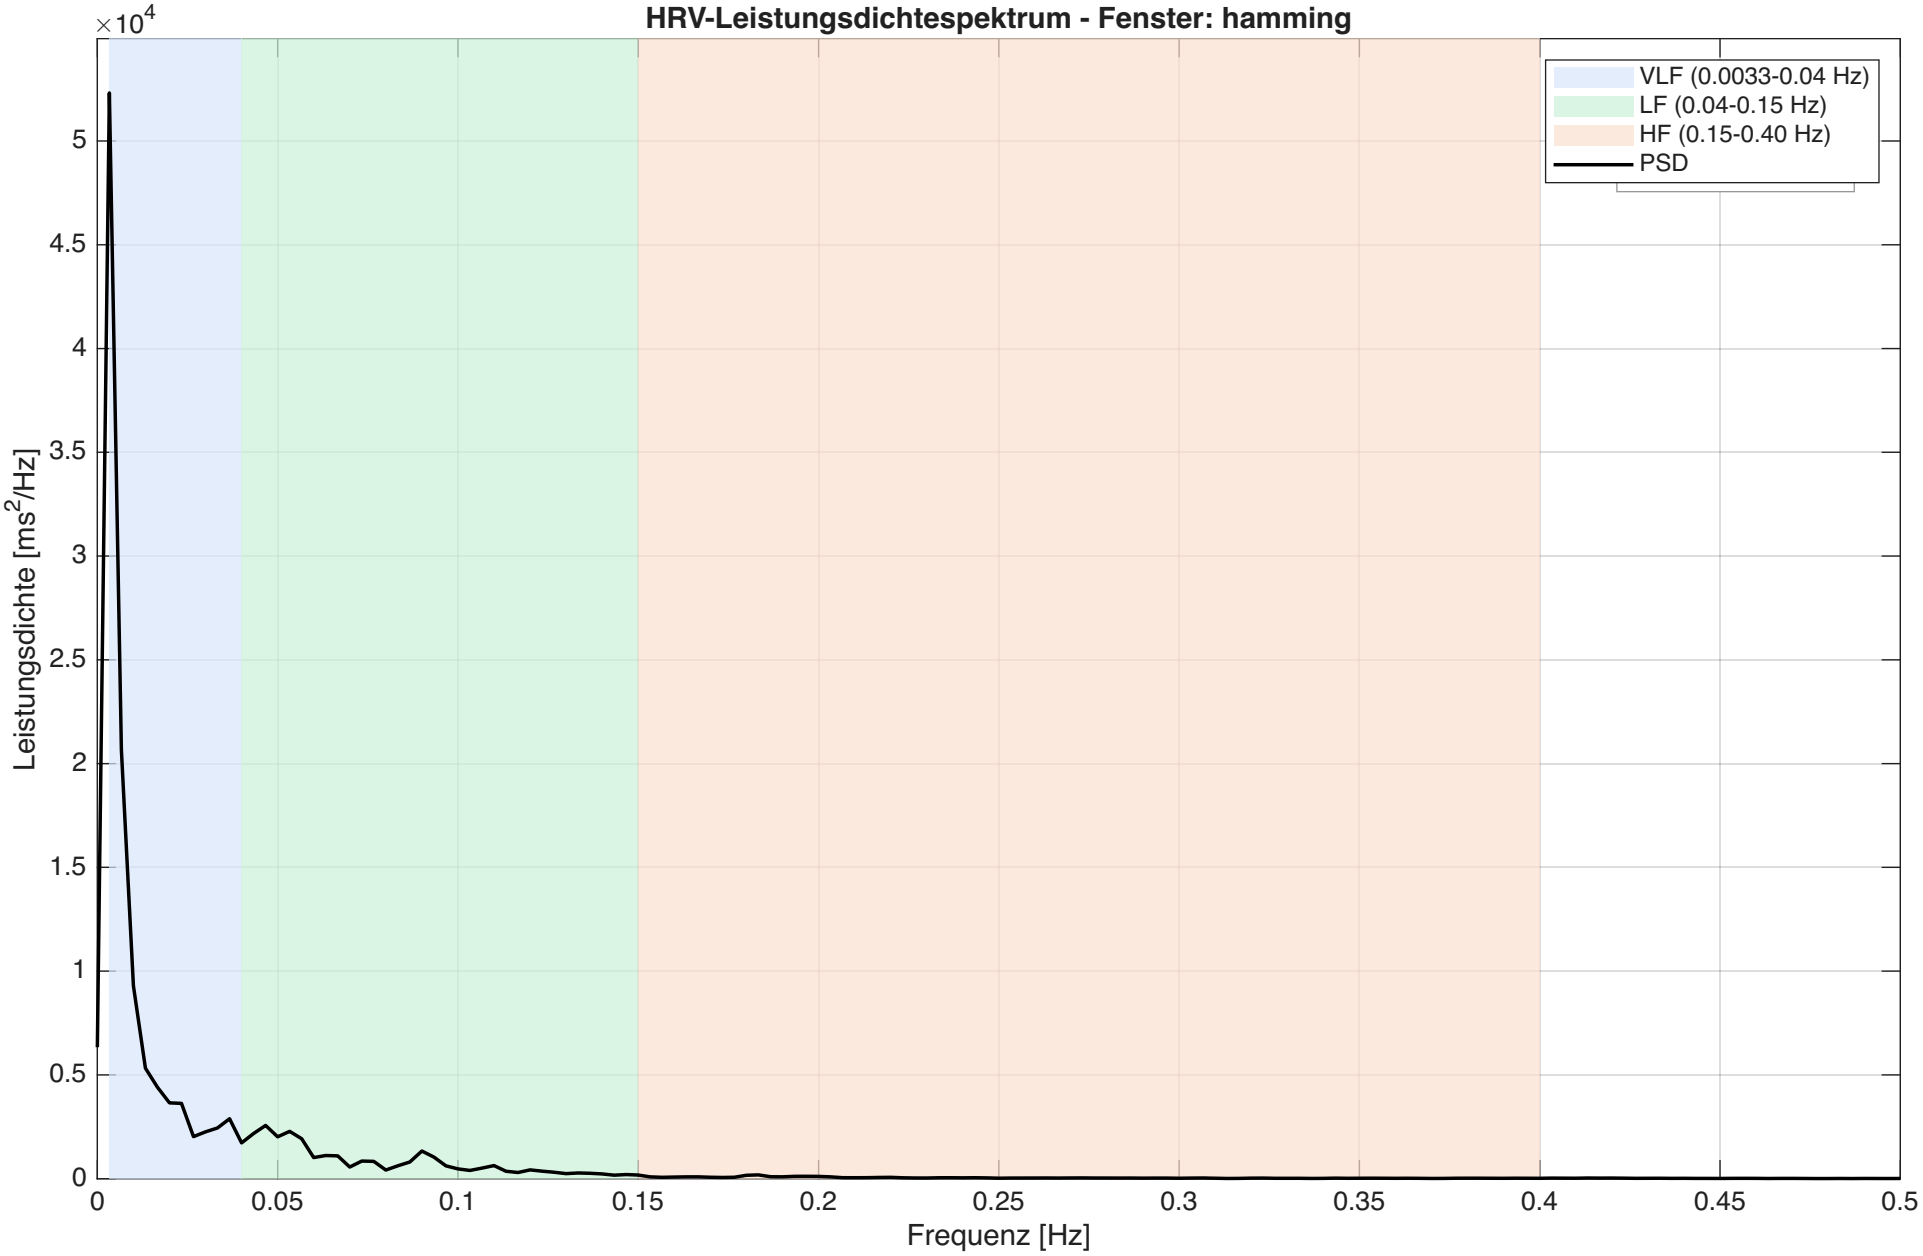


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: hann

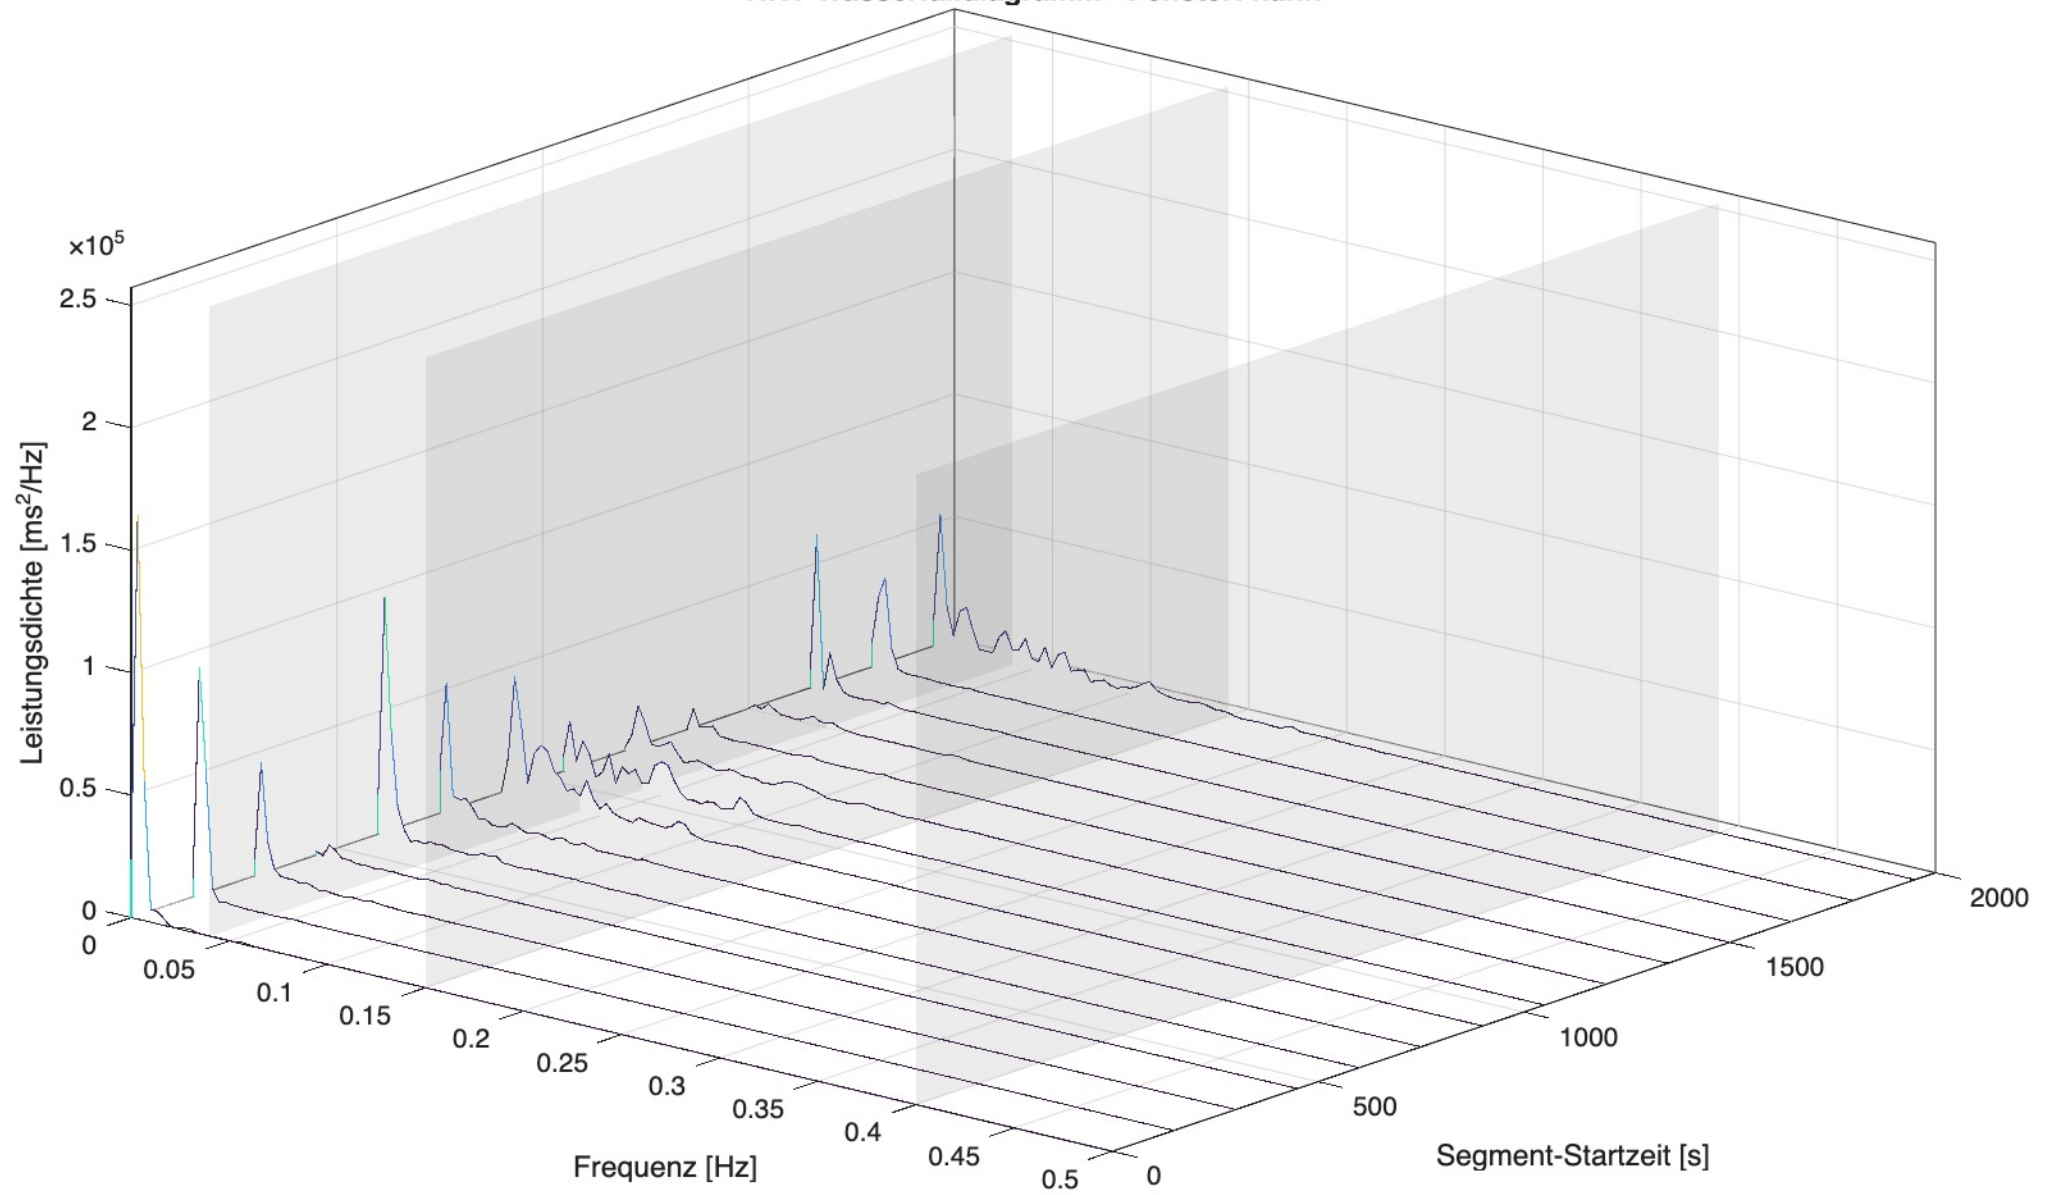


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: hann

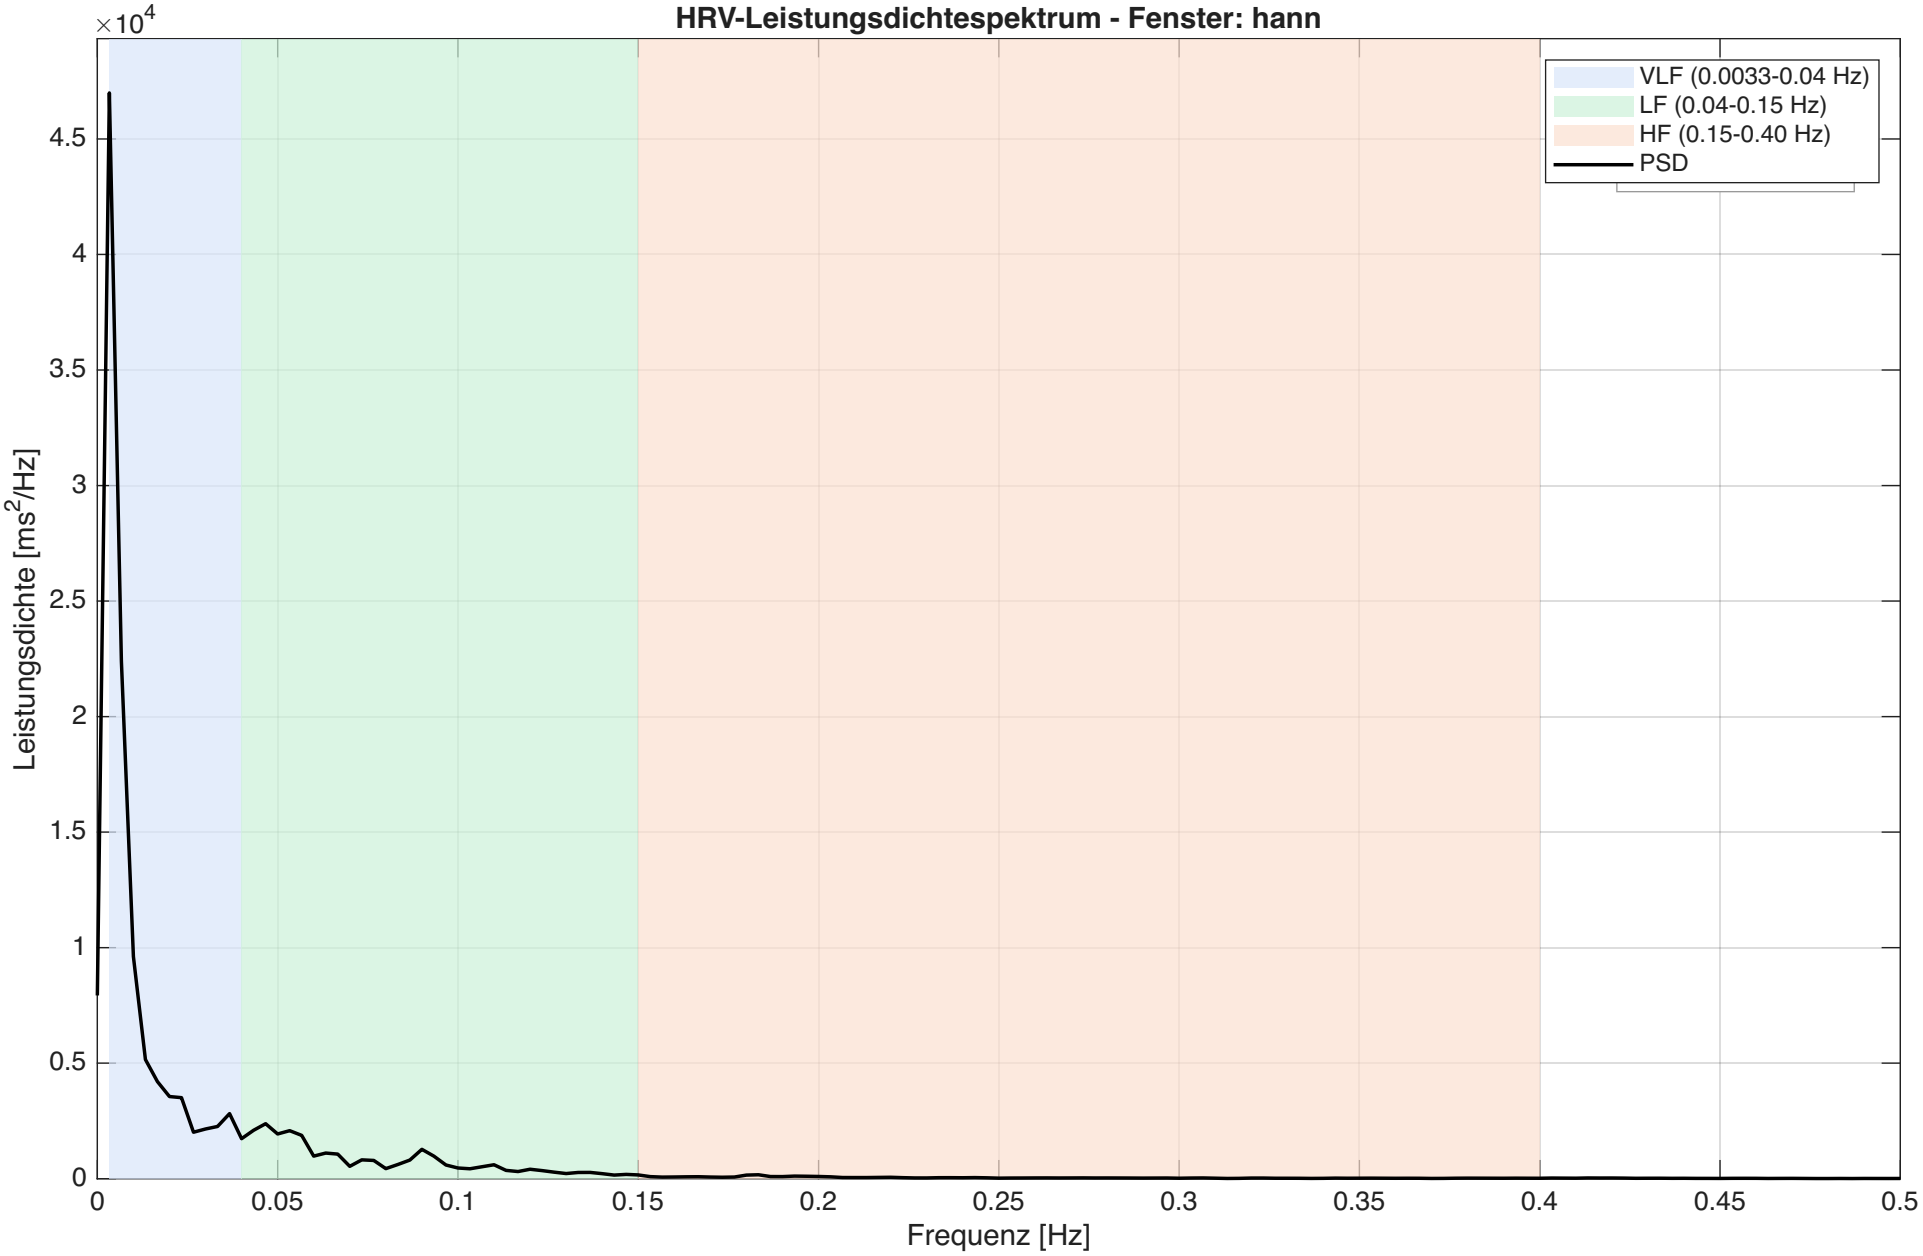


HRV-Wasserfalldiagramm - Fenster: rect

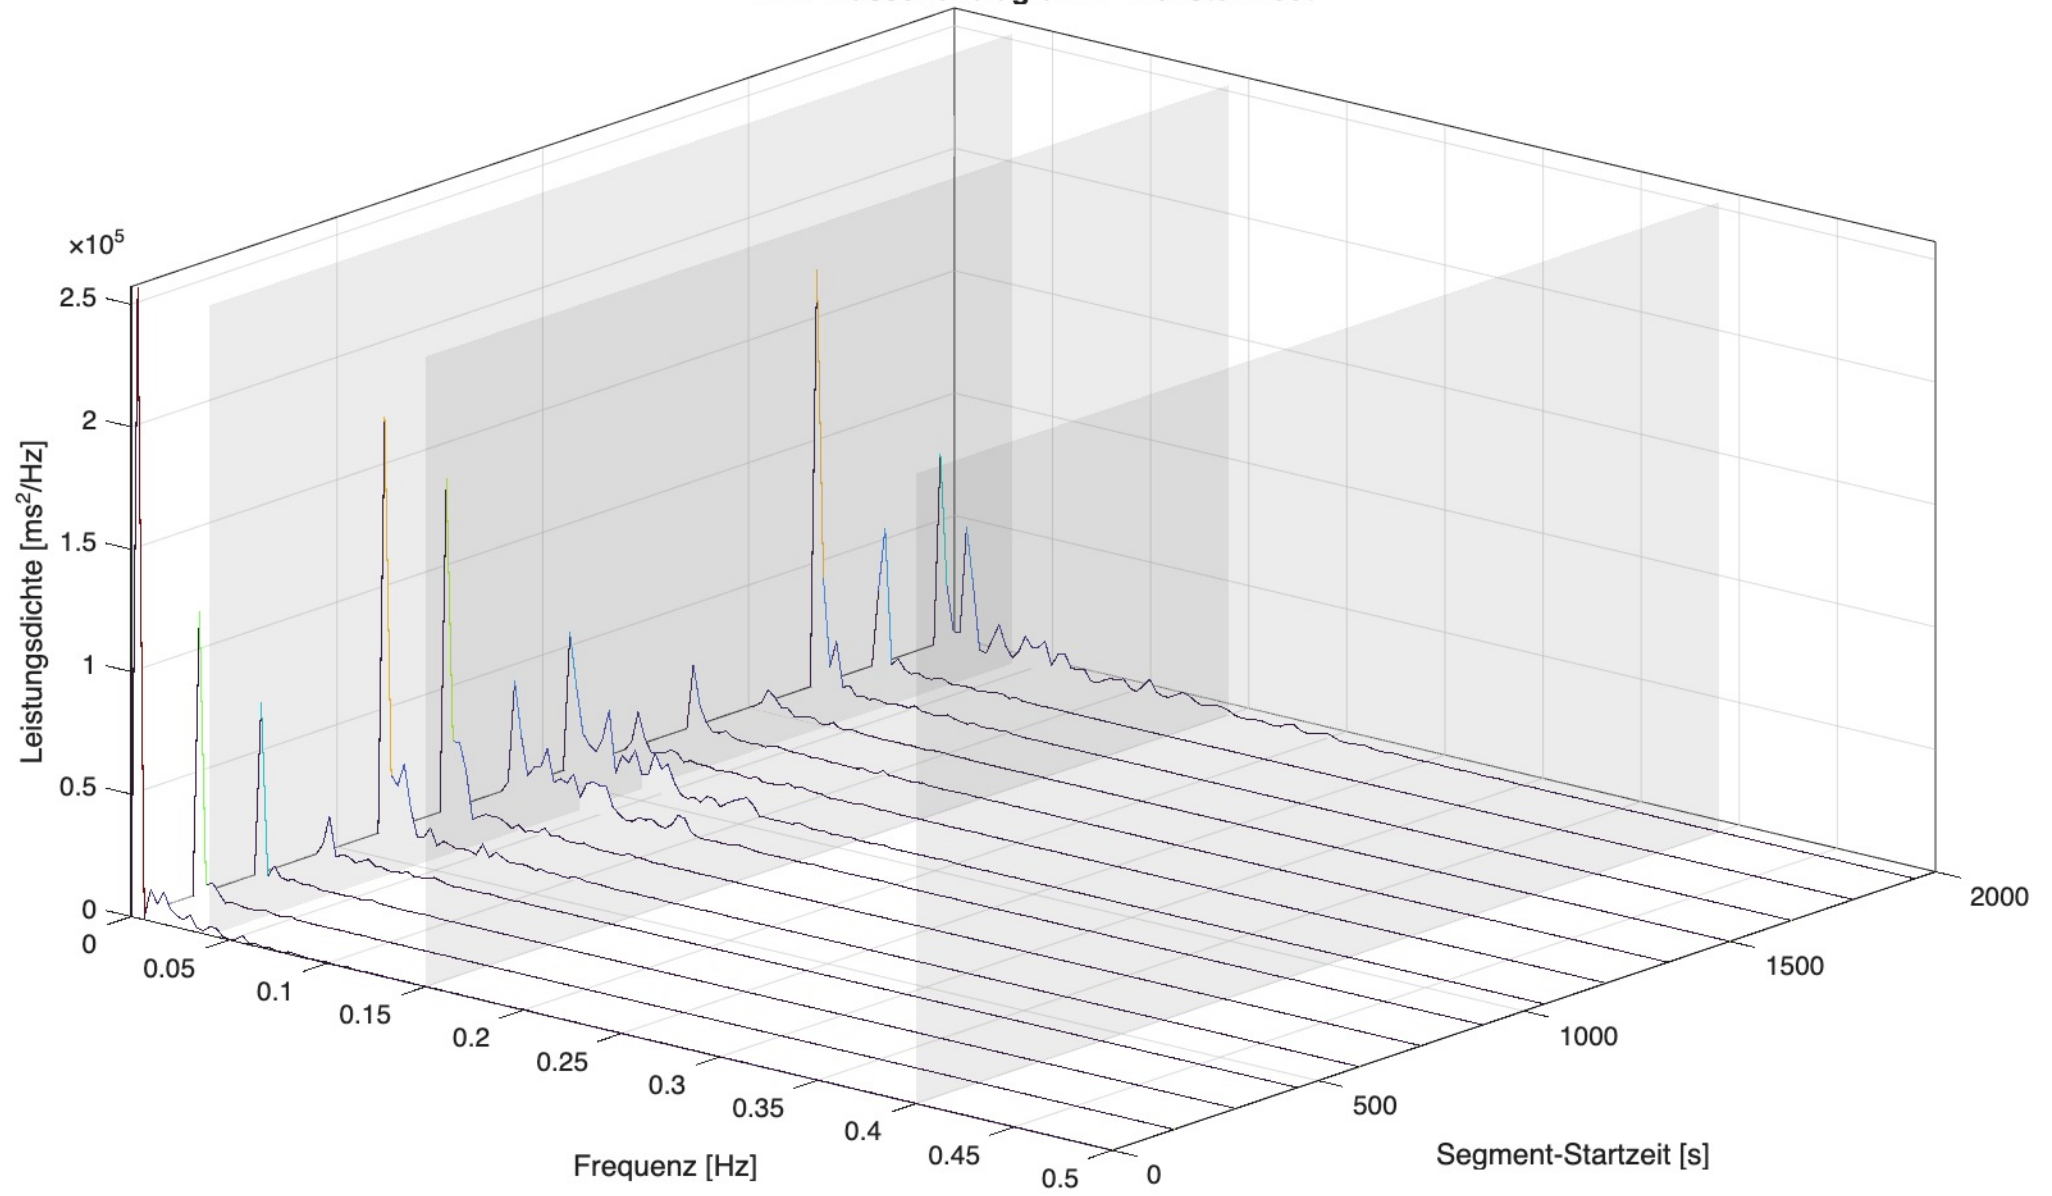


HRV-Leistungsdichtespektrum - Fenster: rect

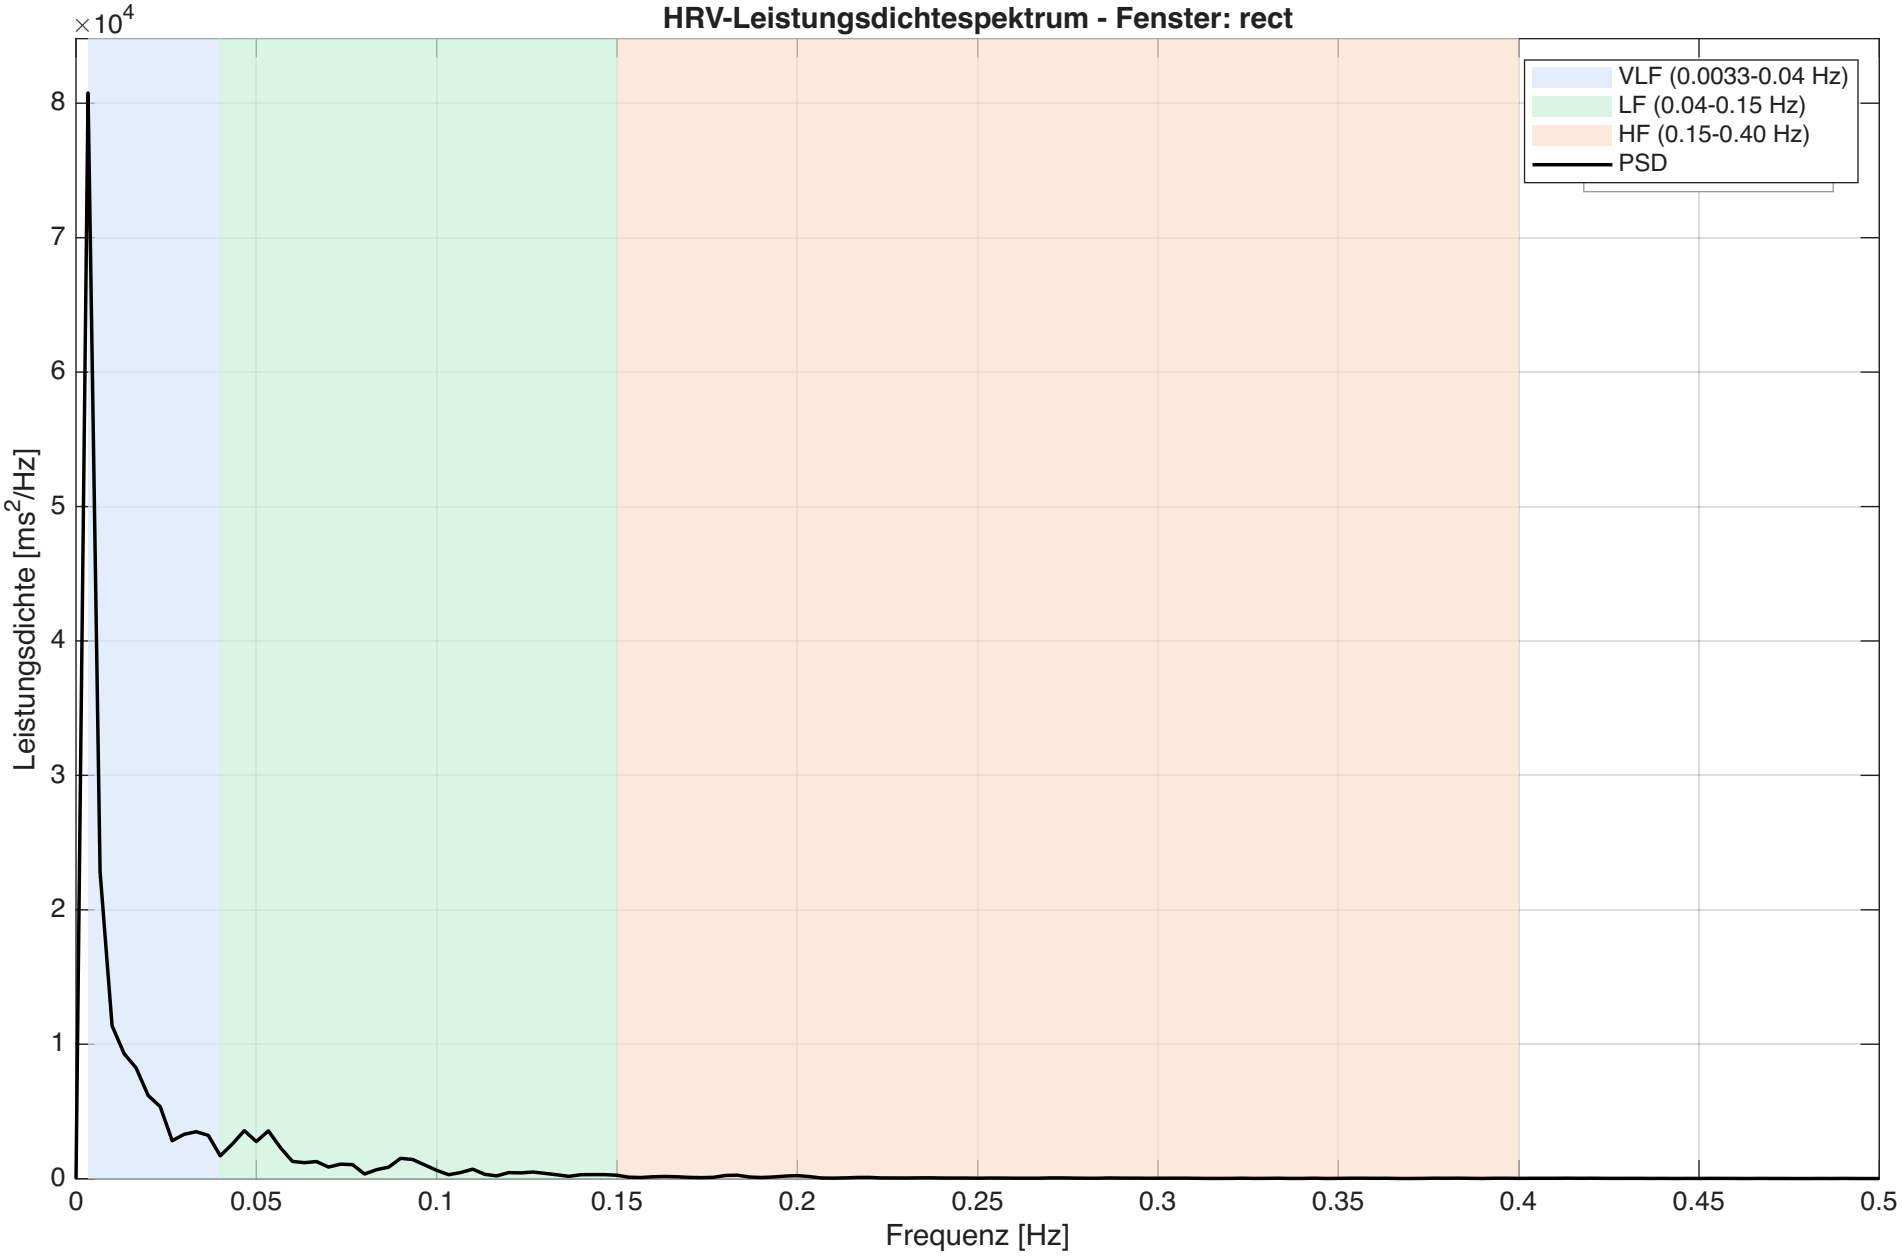


Ueberlagerte HRV-Spektren (logarithmisch) - Leakage-Vergleich

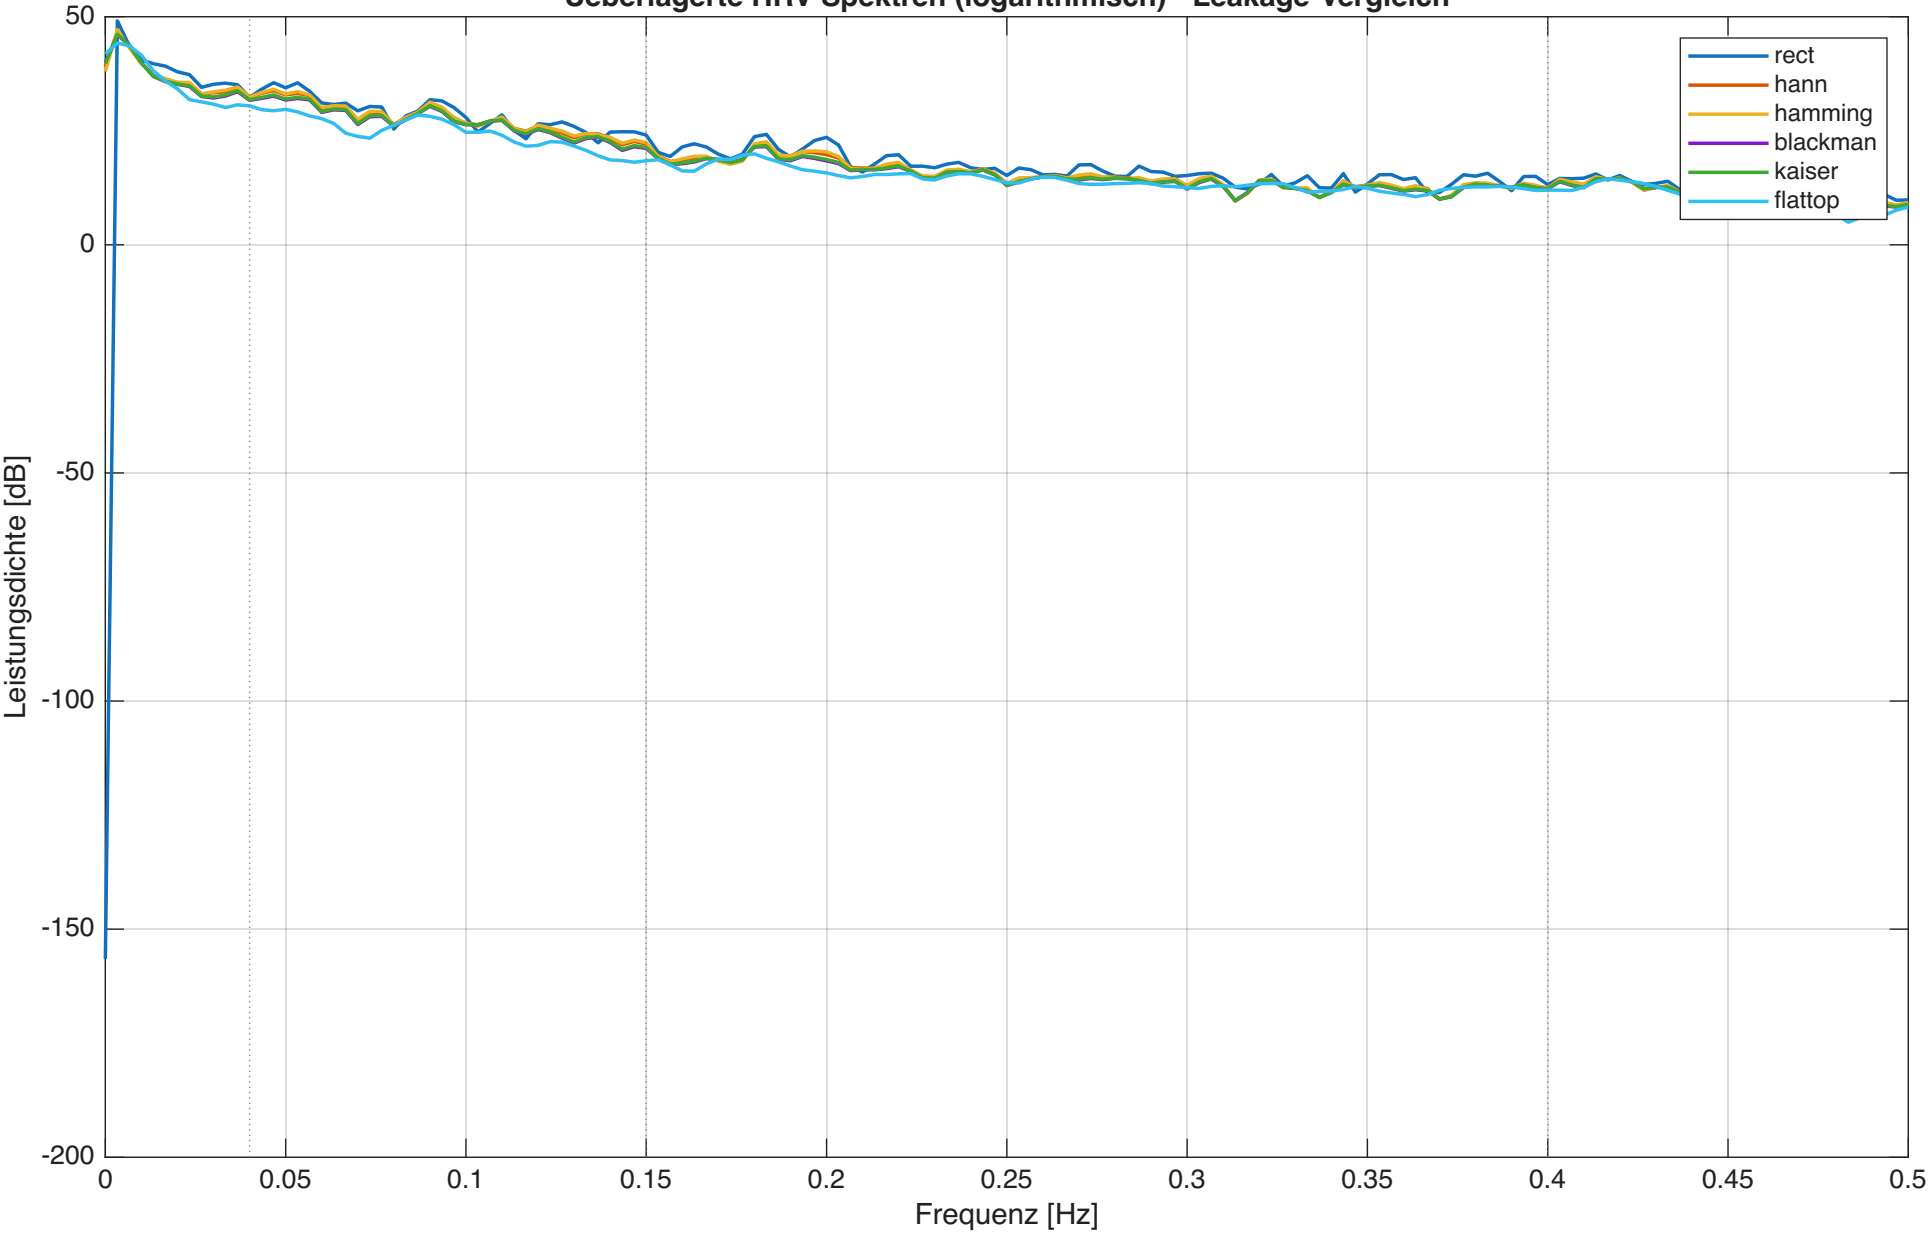


Ueberlagerte HRV-Spektren (linear)

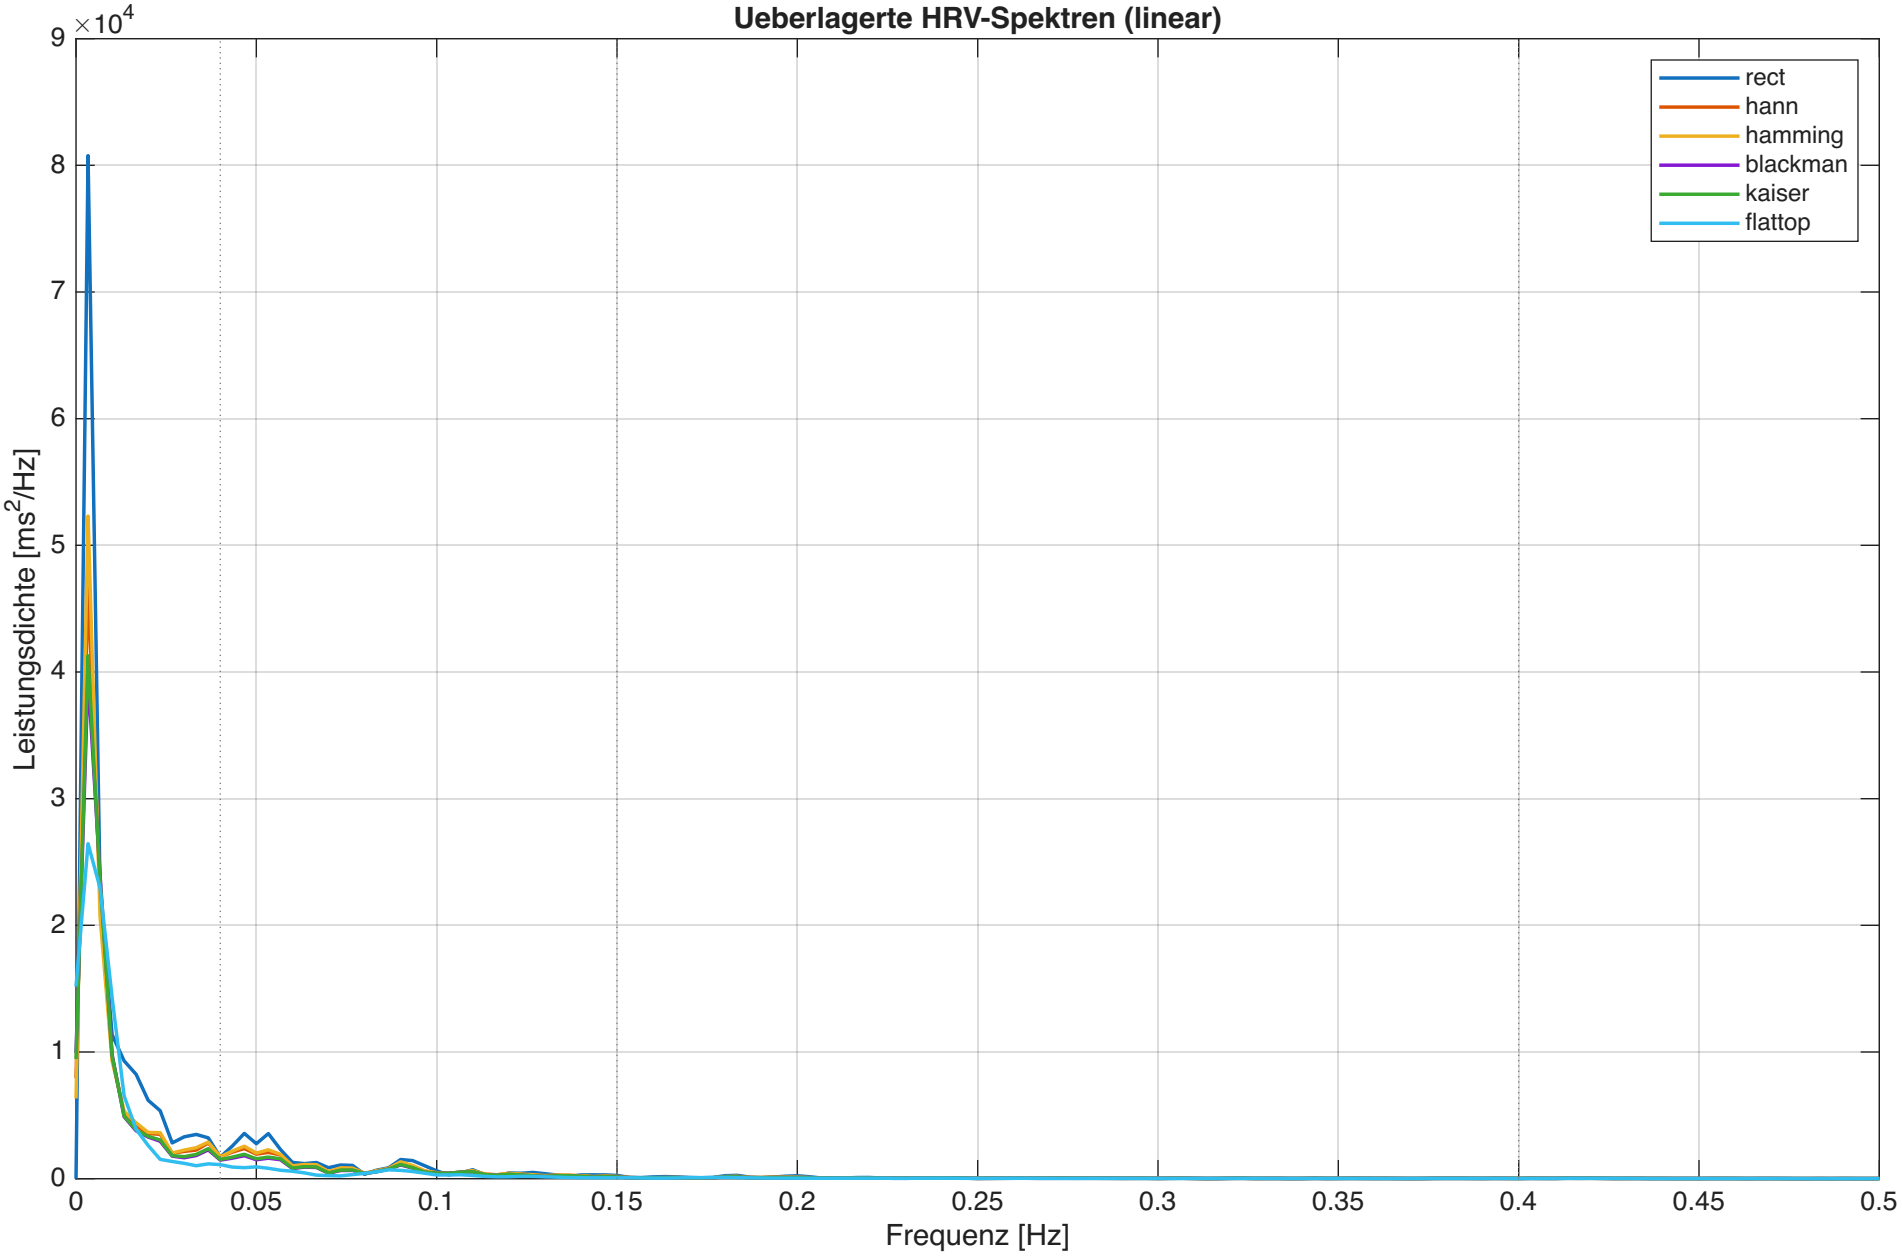


Fensterfunktionen - Zeitbereich

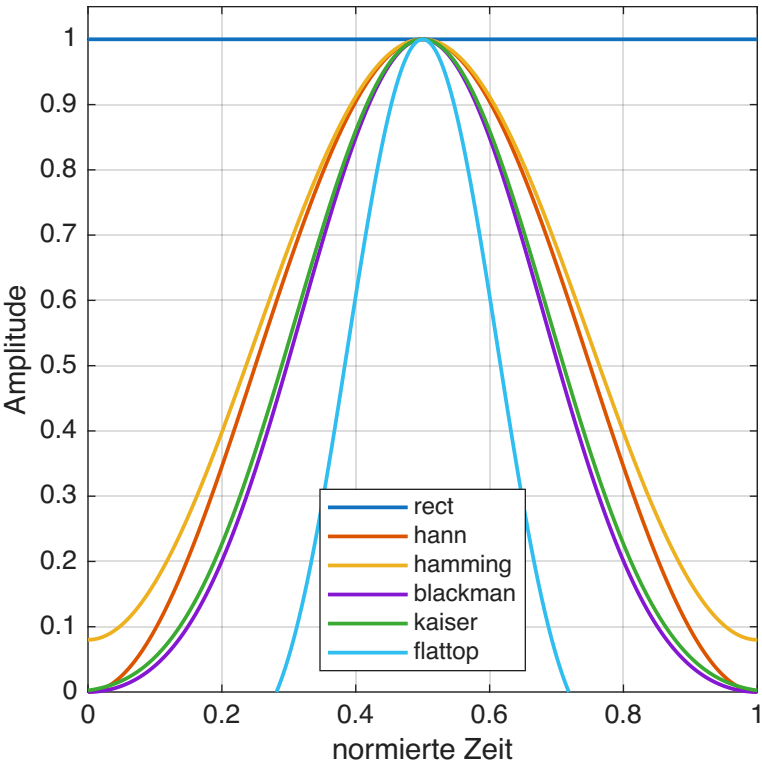


Fensterfunktionen - Frequenzgang

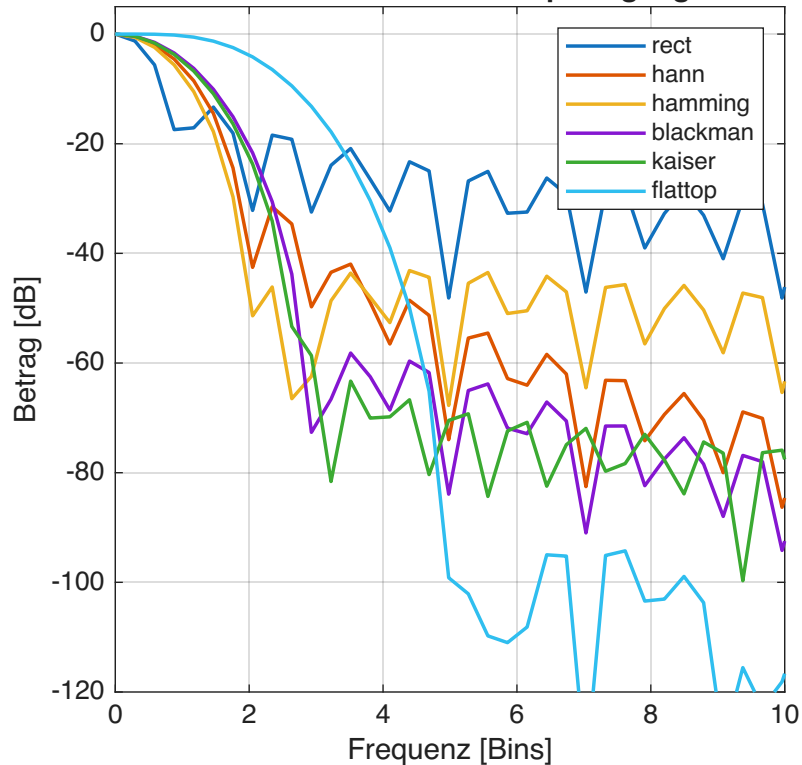


Tachogramm (RR-Intervalle) - 29 Artefakte korrigiert

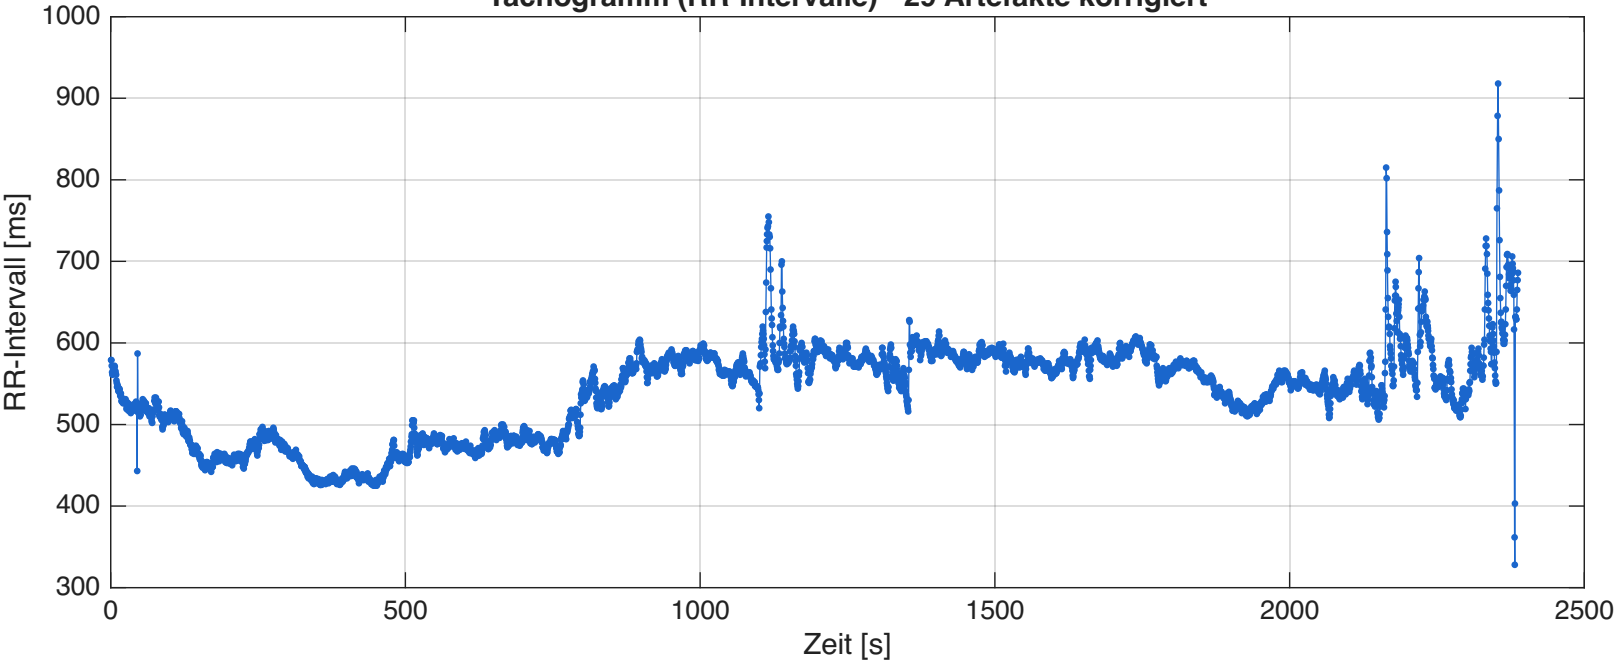

Erkannte R-Zacken (erste 10 s)

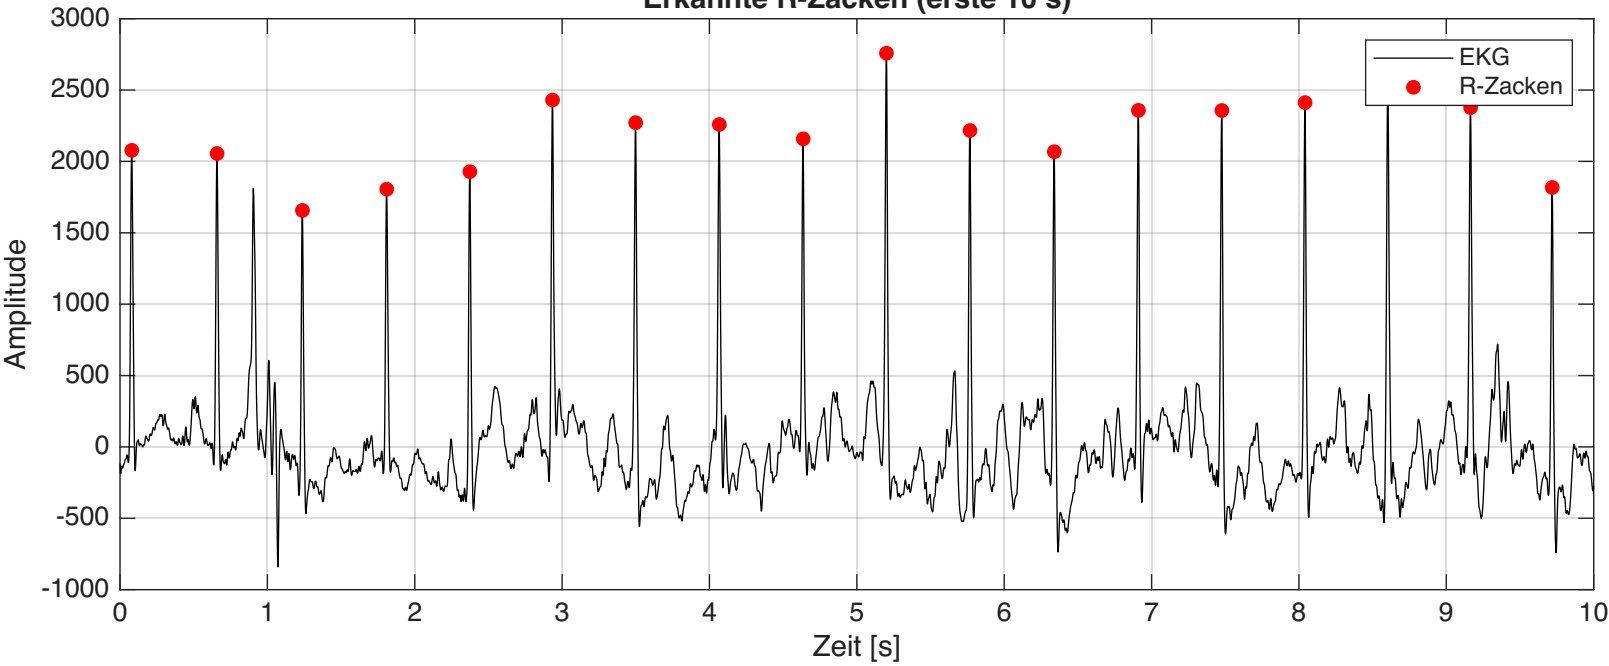

EKG - Rohsignal (Ausschnitt 10-20 s)

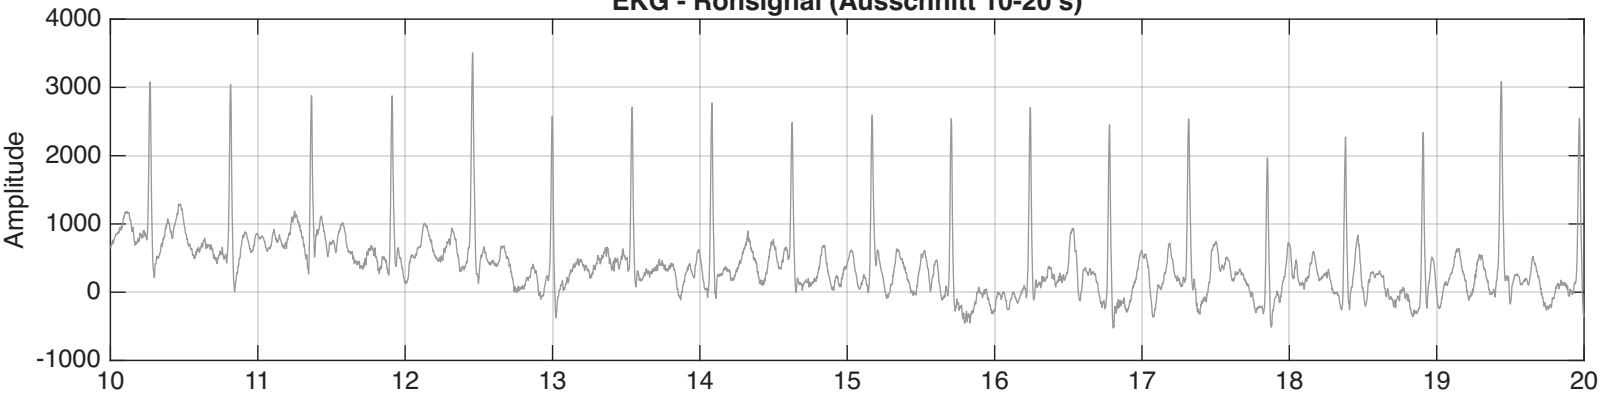

EKG - nach Vorverarbeitung (Ausschnitt 10-20 s)

