

Raport proby PiezoTester V2.0

Wygenerowano: 2026-04-18 19:34:54

Data rozpoczęcia
2026-04-18 19:31:27
Czas trwania
03:10
Typ testu
Narastający
Obciążenie koniec
1180.4 g

Data zakończenia
2026-04-18 19:34:37
Liczba próbek
10
Obciążenie start
500.0 g


Komentarz

10 NARASTAJĄCY


Wartosci statystyczne

Parametr	Srednia	Min	Max	Odch. std.
Obciążenie [g]	850.564	509.100	1184.605	214.149
Rezystancja	120677.180	94391.328	155723.438	20185.916

Rezystancja / Nr próbki

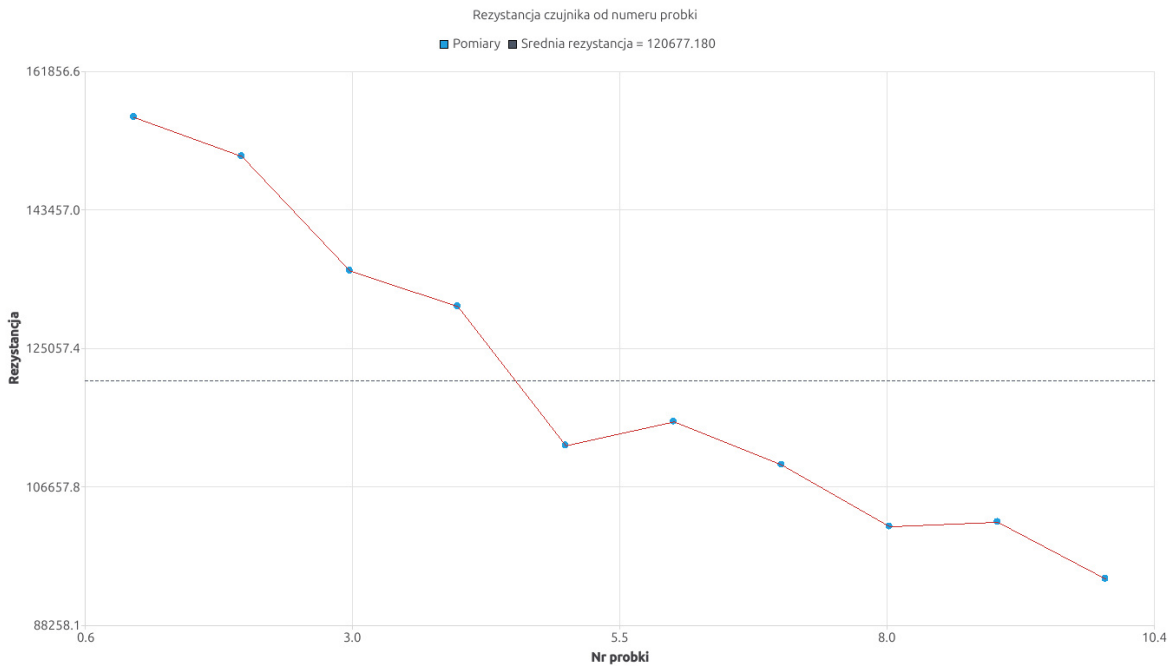

Obciazenie / Nr probki

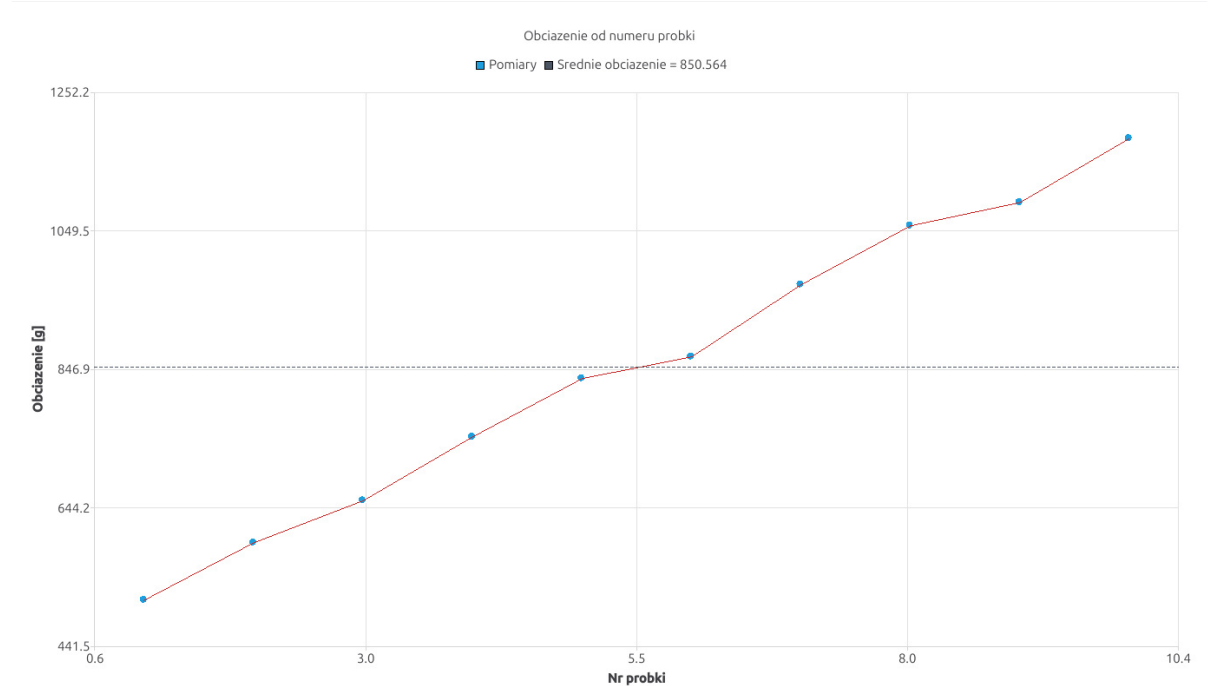

Rezystancja / Obciazenie

