

Raport proby PiezoTester V2.0

Wygenerowano: 2026-04-18 19:45:20

Data rozpoczęcia
2026-04-18 19:35:24
Czas trwania
09:27
Typ testu
Narastający
Obciążenie koniec
1194.4 g

Data zakończenia
2026-04-18 19:44:51
Liczba próbek
30
Obciążenie start
500.0 g


Komentarz

30 narastający do artykułu


Wartosci statystyczne

Parametr	Srednia	Min	Max	Odch. std.
Obciążenie [g]	856.508	510.825	1212.532	211.958
Rezystancja	122227.800	97343.578	154401.281	17016.548

Rezystancja / Nr próbki

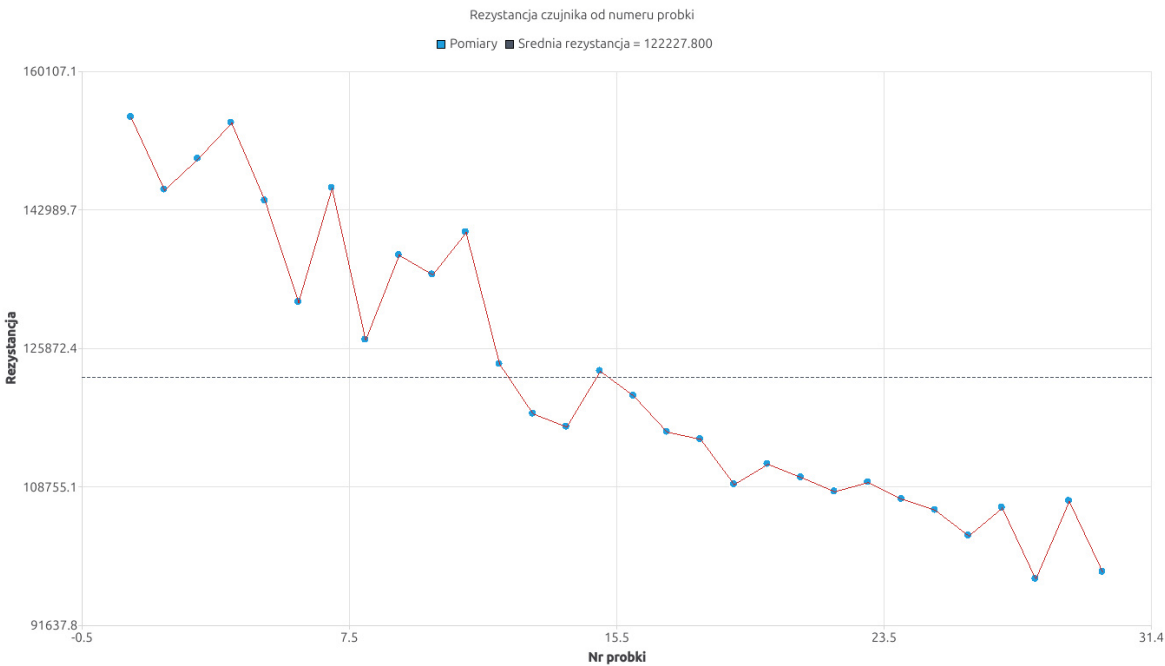

Obciążenie / Nr próbki

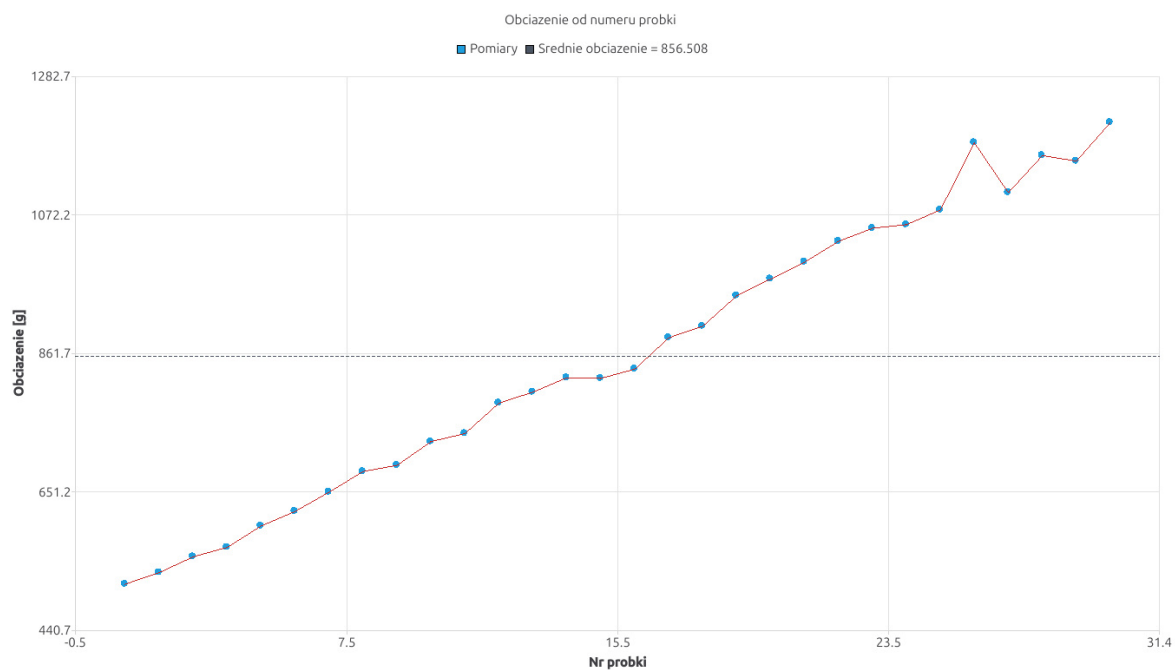

Rezystancja / Obciążenie

