

Raport proby PiezoTester V2.0

Wygenerowano: 2026-04-18 20:26:44

Data rozpoczęcia
2026-04-18 20:04:01
Czas trwania
19:40
Typ testu
Narastający
Obciążenie koniec
1100.0 g

Data zakończenia
2026-04-18 20:23:42
Liczba próbek
49
Obciążenie start
500.0 g


Komentarz

50 narastający


Wartosci statystyczne

Parametr	Srednia	Min	Max	Odch. std.
Obciążenie [g]	812.421	528.284	1109.267	182.098
Rezystancja	145770.947	101147.180	202470.750	23012.314

Rezystancja / Nr próbki

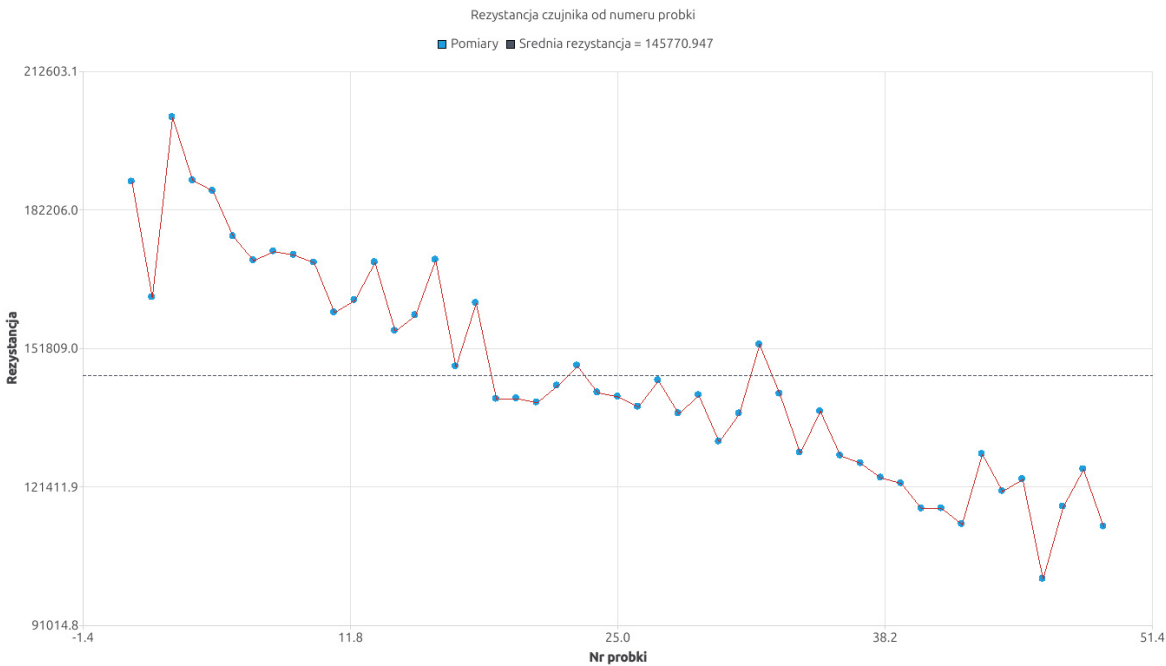

Obciążenie / Nr probki

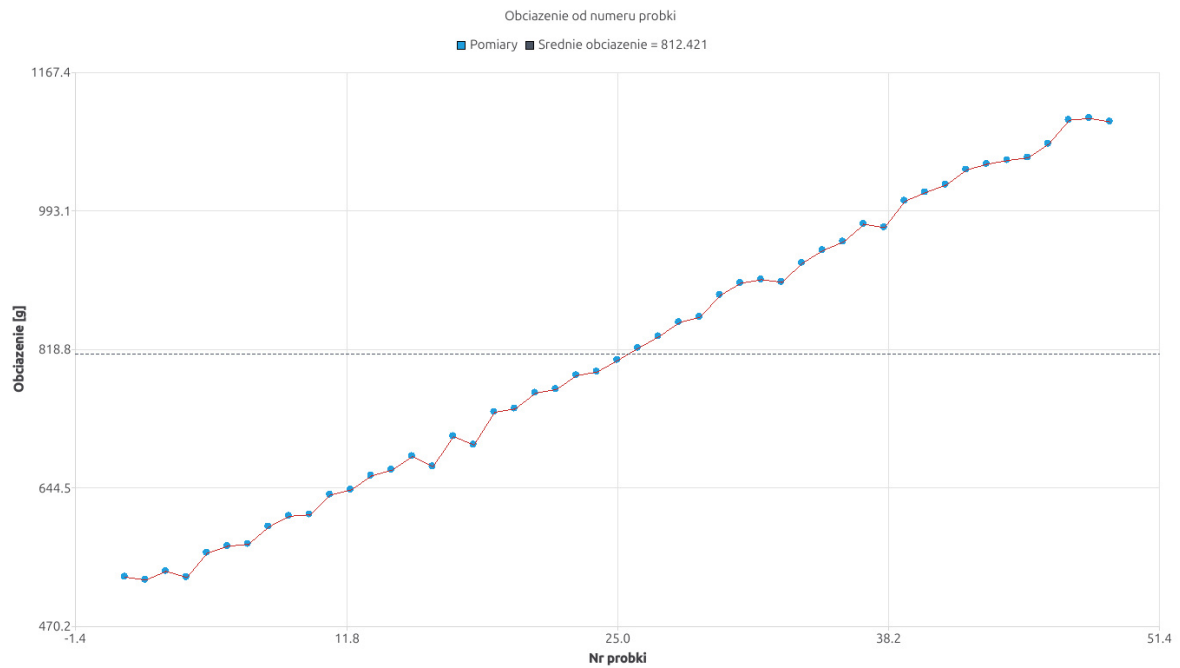

Rezystancja / Obciążenie

