


스마트병원 동행 AI

개발 현황



01 평가 항목 · 상태

항목	상태	근거
시각지도 구축	완료	CNUH 서베이 정렬
VPS 첫 위치 잡기 (서버 보조)	완료	특징점 충분 시 정확
관성 보행추적	완료	신경 관성항법
층 구분 (기압 기반)	완료 · 실데이터	계단 1→2→1 정상
장소별 맵-번들 구조	코드 완료	장소별 설정 분리
붐비는 환경 방향 안정화	진행	방위 보정 적용 · 재측정 대기
완전 단말 내장 시각측위	착수예정	로드맵 Phase C
AR 모듈 설계	진행 중	환자용 3D 지도


02 시스템 구성

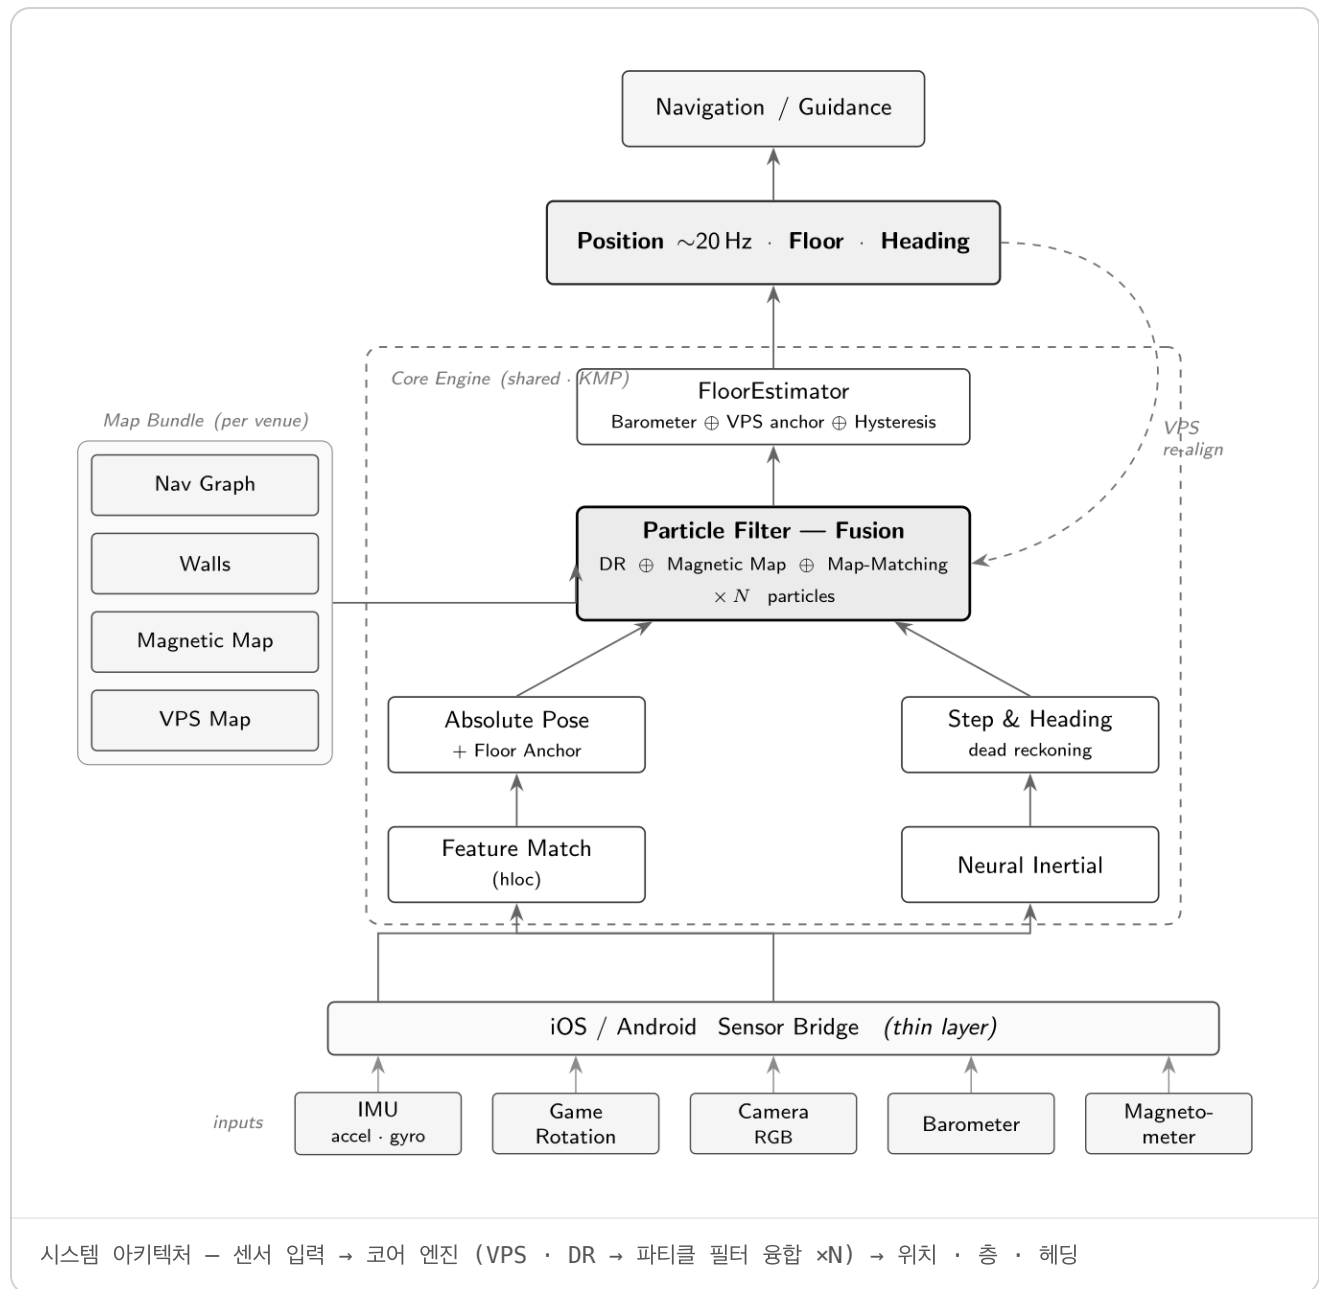

03 측위 맵 구축

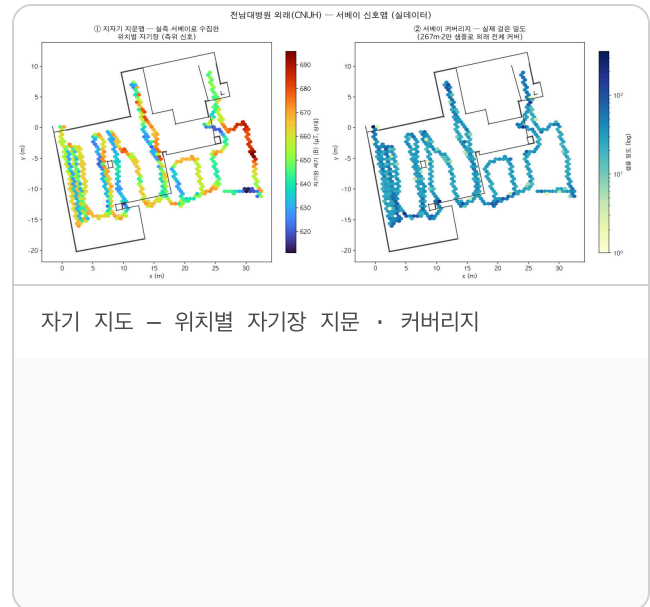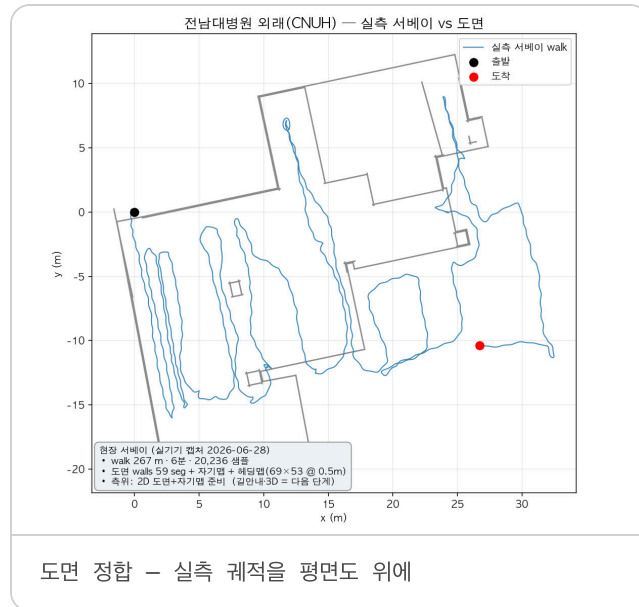


04 보행 동선

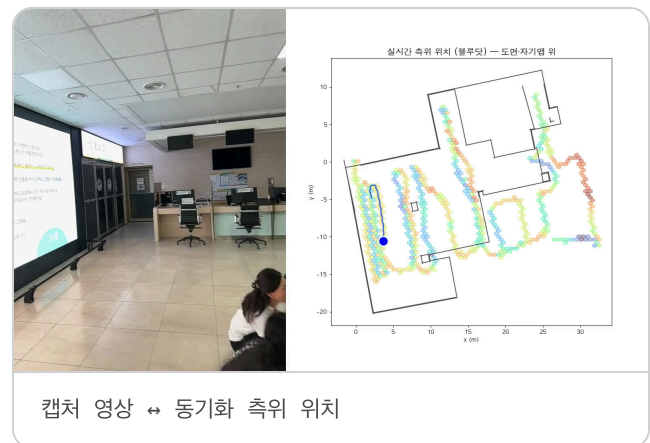


05 층 구분


기압으로 측정한 상대 고도에 기준 층을 결합하고, 완충 구간(히스테리시스)을 두어 현재 층을 자동 판정한다.
계단을 오르내리며 검증한 결과, **층 전환이 떨림 없이 명확했다.**

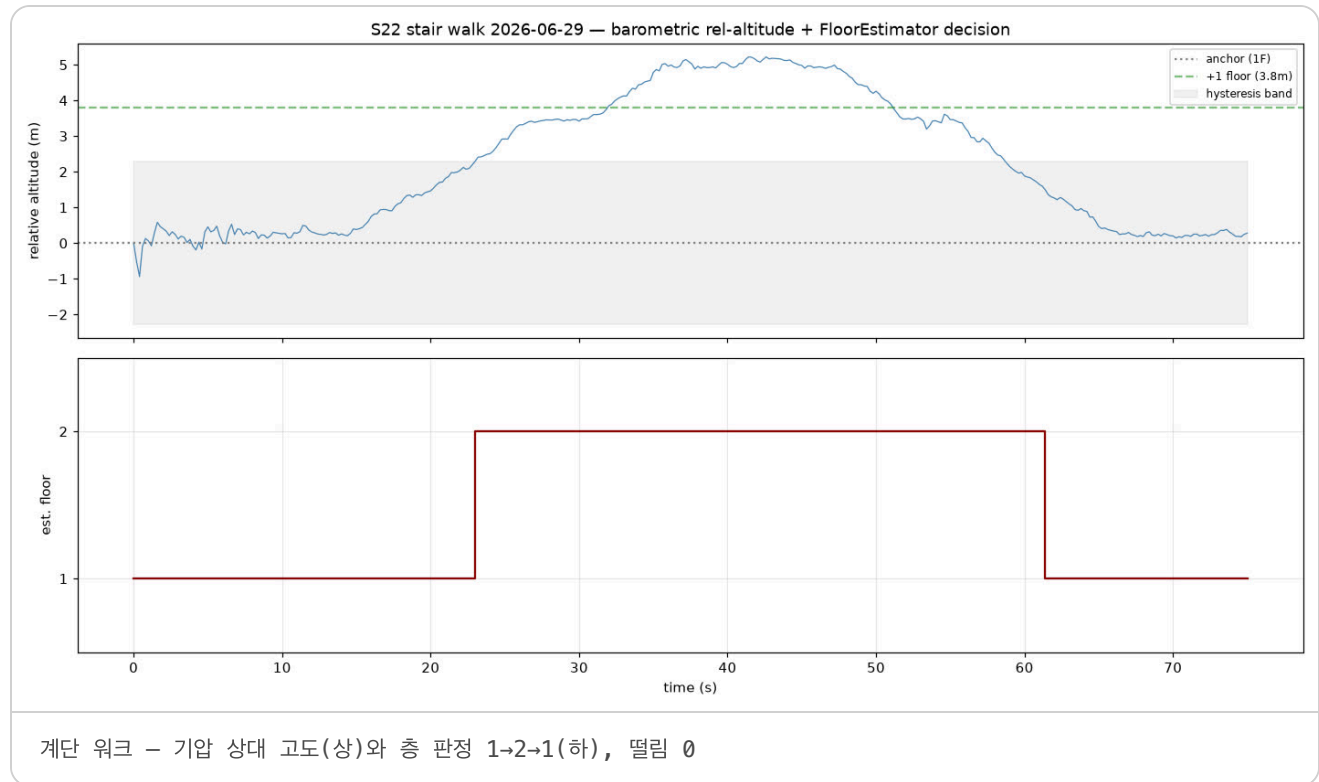

측위 데이터를 그대로 3D 공간에 정합한 결과. 실사 점군·벽·자기장·측위 궤적이 하나의 좌표계 위에 놓인다.

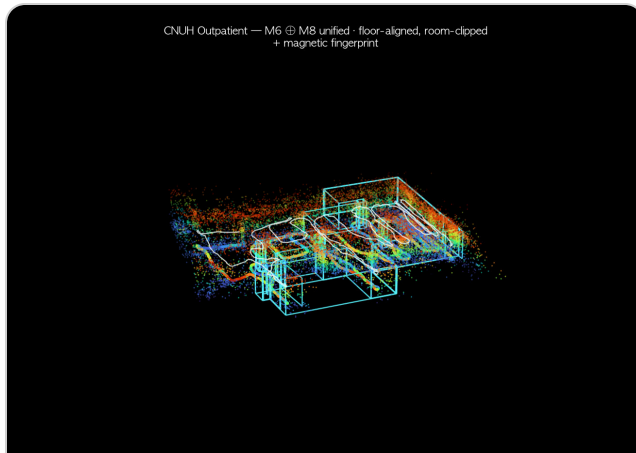

전남대병원 외래 — 점군·벽·자기장·측위 정합

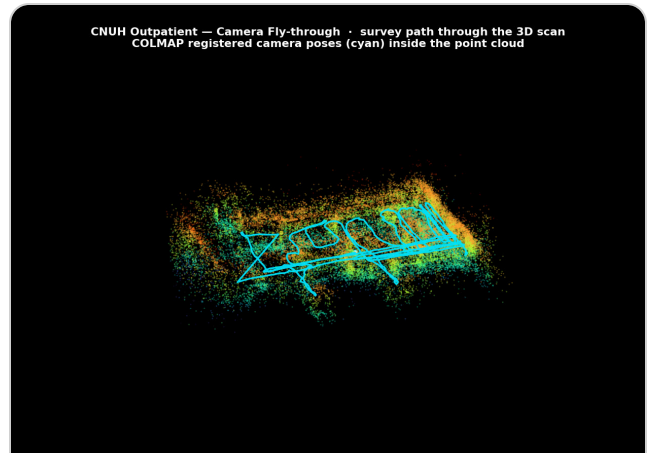


3D 점군 · 서베이 카메라 경로

07 길안내 (내비게이션)

측위가 현재 위치를 제공하면, 그 위에서 목적지까지 실내 경로를 안내한다. 진료과·검사실·화장실 등 목적지를 도면에 등록하고 복도를 따라 최단 경로를 산출해, 사용자가 바라보는 방향 기준으로 화살표·음성으로 안내한다. 고령·거동이 불편한 환자를 위한 엘리베이터 우선 경로를 제공한다.

목적지 등록 · 최단경로 (A*) · 방향기준 AR 화살표·음성 · 엘리베이터 우선

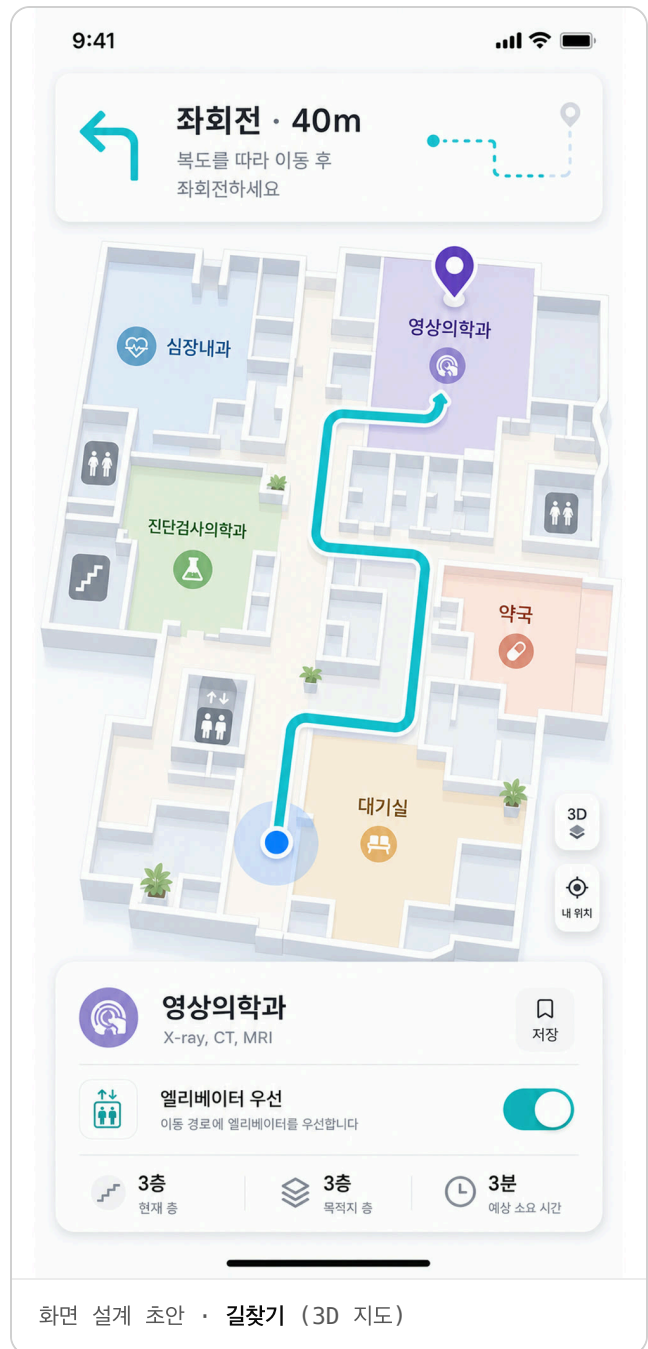

- E.O.D. -