Forord

Denne rapport indeholder dokumentation for projektet *Design af akustiske volumen-målinger af bryster*. Rapporten indeholder kravspecifikation, accepttest, dokumentation af projektets design og implementeringsfase.

Kravspecifikationen er udarbejdet i samarbejde med Pavia Lumholt, speciallæge i plastikkirurgi på OPA Privathospital, Aarhus.

Læsevejledning

Til hvert kapitel i denne rapport findes en tilhørende indledning med formål samt læsevejledning.

I bilagslisten €€€.....

i

Indholdsfortegnelse

Kapite	el 1 Kravspecifikation	1
1.1	Indledning	1
	1.1.1 Formål	1
	1.1.2 Læsevejledning	1
	1.1.3 Versionshistorik	1
1.2	Systembeskrivelse	1
	1.2.1 Aktørbeskrivelse	2
1.3	Funktionelle krav	2
	1.3.1 Use Case diagram	3
	1.3.2 Use Case $#1$ - Ufør brystvolumenmåling	4
1.4	Ikke-funktionelle krav	5
	1.4.1 Kalibrering	5
1.5	Projektafgrænsning	6
1.6	Samarbejdspartnere	8
Vanita	el 2 Testdokumentation	9
-		
2.1	Indledning	9
	2.1.1 Formål	9
	2.1.2 Læsevejledning	9
2.2	2.1.3 Versionshistorik	9
2.2	FAT-protokol	9
	2.2.1 Formål	9
	2.2.2 Referencer	9
	2.2.3 Forkortelser	9
	2.2.4 Ansvar	10
	2.2.5 Udstyrsbeskrivelse	10
	2.2.6 Acceptkriterier	10
	2.2.7 Metode	11
	2.2.8 Oversigt over testdokumenter	12
	2.2.9 Forudsætning for udførelse af FAT	12

2.3	FAT-te	estdokument	12
Kapite	l 3 In	nplementering	13
3.1	Indled	ning	13
	3.1.1	Formål	13
	3.1.2	Læsevejledning	13
	3.1.3	Versionshistorik	13
3.2	Enhed	${ m stest}$	13
	3.2.1	Højtaler ABS-224-RC	13
	3.2.2	Minijack PC Mikrofon	15
	3.2.3	Tores højtaler	17
	3.2.4	Ny enhedstest af Minijack PC Mikrofon d. 25.10.16	19
	3.2.5	Enhedstest af indbygget mikrofon i Logitech HD WEBCAM	
		C270	21
	3.2.6	Elektret mikrofon BOB 12758	23
	3.2.7	Electret Microphone Amplifier - MAX44662.5V	25
	3.2.8	Electret Microphone Amplifier - MAX44665V	28
	3.2.9	Electret Microphone Amplifier - MAX4466- frekvensbånd $$	30
	3.2.10	Multimedia USB Speaker HP-1800	33
	3.2.11	SW LabVIEW FFT af signal	35
	3.2.12	SW LabVIEW volumenformel	38
3.3	Integra	ationstest	40
	3.3.1	Bordtest nr. 1	40
	3.3.2	Bordtest nr. 2	41
	3.3.3	Bordtest nr. 3	43
	3.3.4	Bordtest nr. 4	45
	3.3.5	Bordtest nr. 5	50
	3.3.6	Bordtest nr. 6 - resonansfrekvens i tomt kammer	53
Kapite	l 4 Fi	nd en plads til det her	56
4.1	Besten	nmelse af volumen af resonator	56
	4.1.1	Bestemmelse af volumen af resonator ekskl. halsvolumen	56

Kravspecifikation

1

1.1 Indledning

Dette kapitel indeholder kravspecifikationen for den akustiske volumenmåler til bryster. Kravspecifikation er udarbejdet i samarbejde med projektets kunde, Pavia Lumholt, speciallæge i plastikkirurgi.

1.1.1 Formål

Kravspecifikation definerer de funktionelle og ikke-funktionelle krav, og fungerer som en bindende kontrakt mellem producent og kunde.

1.1.2 Læsevejledning

Dokumentet indeholder en systembeskrivelse for den akustiske brystvolumenmåler (omtales herefter BVM). Systembeskrivelsen er en kort beskrivelse af BVM samt en illustration af måleren. De definerede krav er opdelt i funktionelle og ikke-funktionelle krav, og er beskrevet i de navnebeslægtede afsnit. Dokumentet indeholder ydermere en projektafgrænsning i form af MoSCoW-modellen samt et afsnit omhandlende projektets samarbejdspartnere.

1.1.3 Versionshistorik

#	Dato	Initialer	Beskrivelse
0.1	03.10.16	JH & JR	Sendt til review

1.2 Systembeskrivelse

Brystvolumenmålerens opbygning

Den akustiske brystvolumenmåler består af en Helmholtz resonator, hvor der er påmonteret en højtaler og en mikrofon. Højtaleren og mikrofonen er koblet til en Arduino Mega 2560 R3. Arduino'en er koblet til en PC, hvor der skrives til Arduino i LabVIEW.



Figur 1.1: Beskrivelse af systemets komponenter €€€€

Brystvolumenmåleren funktionalitet

Når en måling intialiseres med BVM'en afsendes en lyd i resonatoren via højtaleren. Mikrofonen på resonatoren opsamler den reflekterede lyd, og udfra den reflekterede lyd, udregner en algoritme størrelsen på brystvolumen.

1.2.1 Aktørbeskrivelse


Systemets primære aktør er en plastikkirurg, som bruger BMV'en når han ønsker et objektivt mål på et bryst. Det er udelukkende plastikkirurgen, der betjener BMV'en under en måling. Som sekundær aktør giver patient et input, sit bryst, til systemet.

1.3 Funktionelle krav

Dette afsnit beskriver de funktionelle krav, som er udarbejdet i samarbejde med Pavia Lumholt. Disse krav er præsenteret i et Use Case diagram samt i en Fully Dressed Use Case beskrivelse.

1.3.1 Use Case diagram

I Use Case diagrammet, 1.2, vises en Use Case for brugen af den akustiske brystvolumenmåler. På venstre side af Use Casen ses systemets primære aktør, og på højre side ses systemets sekundære aktør. Endvidere, vises systemets interessenter, nederst i diagrammet.

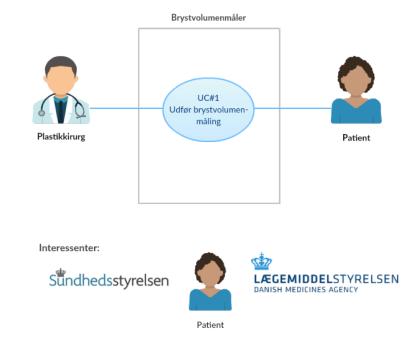

Figur 1.2: Use Case #1 diagram, hvor blablabla €€€

1.3.2 Use Case #1 - Ufør brystvolumenmåling

Use Case #1: Udfør brystvolumenmåling		
Use Case ID	UC #1	
Primær aktør	Plastikkirurg (PK)	
Sekundær aktør	Patient	

Interessenter

- 1. Patient: ønsker et objektivt mål, som bevis på overensstemmelse med købsaftale
- 2. Sundhedsstyrelsen: ønsker et objektivt mål til vurdering af berettigelse til brystformindskende operation
- 3. Lægemiddelstyrelsen: ønsker, at BVM er i overenstemmelse med EU-lovgivning for medicinsk udstyr

Startbetingelse		Slutbetingelse	
	BVM skal være tændt	BVM skal vise et mål for brystvolumen	

Normalforløb

- 1. PK har behov for at kende patientens brystvolumen
- 2. PK kalibrerer BVM i den tilhørende dockingstation
- 3. PK placrerer BVM på patients blottede bryst
- 4. PK kontrollerer, at patientens bryst er tætomsluttet af BVM
- 5. PK kontrollerer, at BVM er placeret med et ensartet tryk på patientens bryst
- 6. PK foretager en måling af brystvolumen ved at trykke på den dertilhørende knap
- 7. BVM præsenterer målingen på et display, som PK aflæser
- 8. BVM slukkes og rengøres

Alternativt flow

- 1. Manglende kalibrering
- (a) PK anbringer BVM i dockingstation
- (b) PK starter kalibrering ved at trykke på den dertilhørerende knap
- (c) BVM melder klar til brug
 - 2. Fejlhåndtering
- (a) PK slukker BVM
- (b) PK anbringer BVM i dockingstationen
- (c) PK tænder BVM
- (d) PK kalibrerer BVM

Åbne problemstillinger

- · Hvordan ved PK, at BVM mangler at blive kalibreret?
- · Hvordan ved PK, at BVM melder fejl?
- · Hvordan ved PK, at han påfører et ensartet tryk?
- Hvordan ved PK, at patientens bryst er tætomsluttet af BVM?

1.4 Ikke-funktionelle krav

Tid

Efter kalibrering må målingen maksimalt tage 10 sek. Dette er et kundekrav fra Pavia Lumholt. BMV'en skal melde om kalibrereingsbehov hver 10. minut

Enheder

Målingen skal angives til PK i milliliter(ml.)Plastikkirurger bruger milliliter enheder når de angiver bryststørrelse.

UI

UI skal være en touch-screen, da denne form for skærm er rengøringsvenlig. Tekst skal være synligt på en halv meters afstand, da det skal være muligt at aflæse teksten når man står med BVM'en i nogelunde strakt arm. Sproget skal være engelsk, da der ønskes et sprog som kan læses af formentlig alle plastikkirurger. UI skal fejlmelde når der opstår uventet fejl

Lovgivning for medicinsk udstyr

BMV'en skal overholde lovgivningen for et medicinsk device. BMV'en skal som et klasse I udstyr og et målingsudstyr opfylde bilag VII og være i overensstemmelse med processerne i bilag VI,V eller VI gældende for metrologisk udstyr.

1.4.1 Kalibrering

BMV'en skal kunne kalibreres efter temperatur og luftfugtighed, da disse kan have en indflydelse på målingens output.

Nøjagtighed, præcision og linearitet

BMV'en skal måle nøjagtige og præcice, for at målingerne er valide og kan bruge i praksis. Der skal kunne vises en linearitet ved målinger, så målingerne kan bruge i hele bryststørrelsesspektret.

1.5 Projektafgrænsning

MoSCoW-modellen er en prioriteringsmetode, som anvendes til afgræsning af projektet. Modellen beskriver, hvilke dele og krav i projektet, som skal opfyldes (**M**ust), bør opfyldes (**S**hould), kan opfyldes (**C**ould) og ikke vil opfyldes (**W**ould not have). Således gives en struktureret oversigt over, hvilke krav, der er vigtigst at få opfyldt inden for den givne tidsramme, og endvidere, hvilke krav, som efterfølgende med fordel kan implementeres, hvis tidensramme tillader det. Figur 1.3 viser, hvordan de enkelte dele og krav i projektet prioriteres i henhold til MoSCoW-metoden.

MoSCoW-model

Must have

En prototype, som:

- afspiller lyd og optager reflekteret lyd i en resonator
- bestemmer volumen af et bestemt brystfantom ud fra den reflekterede lyd
- · præsenterer resultat af måling på et UI

Test af

nøjagtighed og præcision

Dokumentation for:

- søgning, analyse og vurdering af ny viden inden for Helmholtz resonans teori og eksisterende løsninger
- databehandling og testresultater af nøjagtighed og præcision
- lovgivningsmæssige krav for medicinsk udstyr, gældende for prototypen

Should have

En prototype, som:

- er håndholdt
- · har et integreret UI

Test af:

- brystfantomer i forskellige størrelser, former og materialer
- linearitet
- · betydningen for temperatur- og luftfugtighedsforhold

Dokumentation for:

- databehandling og testresultater af linearitet ved forskellige brystfantomer
- databehandling og testresultater af betydningen for temperatur- og luftfugtighedsforhold mhp. nødvendighed for kalibrering
- analyse af anvendelsesmuligheder i forhold til ammemonitorering

Could have

En prototype, som:

• signalerer ved et ensartet anlægstryk

Test af

- · betydning for tætheden af resonatorens kantafgrænsning
- betydningen for resonatorens udformning og størrelse

Dokumentation for:

- databehandling og testresultater af betydning for tætheden af resonatorens kantafgrænsning
- databehandling og testresultater af betydning for resonatorens udformning og størrelse

Would not have

En prototype, som:

· ved brug af algoritme, selv afbryder ved stabil måling

Figur 1.3: MoSCoW-model, hvor blablabla €€€

1.6 Samarbejdspartnere

Kravspecifikationen er udarbejdet gennem et samarbejde med flere parter. Først og fremmest er projektets kravspecifikation til den endelige prototype specificeret i et samarbejde med projektets kunde, speciallæge i plastikkirurgi, Pavia Lumholt. Derudover er projektet tilknyttet en vejleder, lektor Samuel Alberg Thrysøe, med speciale i signalbehandling, som vejleder ved eventuelle problemstillinger. Endvidere indgår eksterne konsulenter, som reviewer's på indholdet af kravspecifikationen.

Testdokumentation 2

2.1 Indledning

Dette kapitel indeholder dokumentation for de udførte tests på den akustiske brystvolumenmåler.

2.1.1Formål

2.1.2 Læsevejledning

Versionshistorik 2.1.3

2.2FAT-protokol

Denne Final Acceptance Test protokol (FAT-protokol) beskriver alle de forhold og forudsætninger, som skal være opfyldt for at kunne udføre FAT af den akustiske brystvolumenmåler.

2.2.1Formål

Formålet med denne protokol er at specificere FAT-aktivteterne gældnede for $bryst volumen m{\ra}leren.$

2.2.2Referencer

€€ Eksempelvis UC#1

2.2.3Forkortelser

FAT - Final Acceptance Test

2.2.4 Ansvar

Ved underskrift på protokollen bekræfter:

Kunde - Projektansvarlig

- at indholdet er komplet og entydigt
- at det tekniske indhold og metoder er i orden og dækkende for de planlagte tests
- at den projektansvarlige er enig i omfang, metode og acceptkriterier

Udviklere - Projektansvarlige

• at det tekniske indhold og metoder er i orden og dækkende for de planlagte tests

2.2.5 Udstyrsbeskrivelse

Den akustiske brystvolumenmåler består af en Helmholtz resonator, hvor der er påmonteret en højtaler og en mikrofon. Højtaleren og mikrofonen er koblet til en Arduino Mega 2560 R3. Arduino'en er koblet til en PC, hvor der skrives til Arduino i LabVIEW. Brystvolumenmåleren benyttes af en plastikkirurg, som bruger BMV'en når han ønsker et objektivt volumenmål på et bryst. Når en måling intialiseres med BVM'en afsendes en lyd i resonatoren via højtaleren. Mikrofonen på resonatoren opsamler den reflekterede lyd, og udfra den reflekterede lyd, udregner en algoritme størrelsen på brystvolumen.



Figur 2.1: Beskrivelse af systemets komponenter €€€€

2.2.6 Acceptkriterier

Acceptkriterierne er afledt af de forhold, der er specificeret i Kravspecifikationen, kapitel 1. Acceptkriterierne er specificeret i de enkelte testskemaer.

2.2.7 Metode

Dette afsnit specificerer de retningslinjer, hvorefter FAT'en skal afvikles.

Dokumentsammenhæng

illustreres €€ Indsæt oversigt, med inspiration fra s. 204

Gennerelle krav

Afviklingen af FAT skal overholde følgende nøglekrav:

- Protokollen skal være godkendt, før aktiviteter udføres
- Afvigelser skal registreres og rettelser udføres
- $\bullet \ \ Data ind samling \ \ og \ \ registreringer \ \ skal \ \ udføres \ \ i \ \ overenstemmelse \ \ med \ \ »god \\ test praks is «$
- Data skal granskes for rigtighed og fuldstændighed
- En FAT-rapport skal udarbejdes og godkendes som bevis på den gennemførte FAT

Acceptkriterier

Dette afsnit beskriver, hvordan testskemaerne specifikt skal udfyldes.

- Alle krav skal opfylde de specificerede acceptkriterier i hvert enkelte testskema.
- De aktuelle observationer skal svare til de forventede observationer
- ullet I » Godkendt«-kolonnen skrives » Ja«, hvis acceptkriteriet er overholdt.
- I »Godkendt«-kolonnen skrives »Nej« samt afvigelsesnummer, hvis acceptkriteriet ikke er overholdt.

subsubsectionAfvigelseshåndtering Afvigelser registreres under udførslen af FAT dokumenteres ved udarbejdelse af afvigelsesbilag, hvor følgende punkter opfyldes:

- a) Afvigelse og årsag til afvigelsen beskrives
- b) Aktion for opfyldelse af acceptkriterier angives
- c) Resultat af gennemført aktion dokumenteres

Afslutning af FAT-aktiviteter

Ved afslutningen af FAT'aktivteterne, skrives en FAT-rapport der lukker FAT-aktiviteterne, og fungerer som bevis for, at den gennemførte test af brystvolumenmåleren er afsluttet med et tilfredsstillende resultat.

FAT-rapporten omhandler følgende punkter:

- Konklusion på den gennemførte FAT
- Kopi af godkendt protokol
- $\bullet \ \ A fvigelses blad \ med \ korrektive \ aktioner$
- Udfyldte testskemaer

2.2.8 Oversigt over testdokumenter

 \mathfrak{CC} Her angives de specifikke testdokumenter i en tabel. Obs, på eventuelle referencer til kravspec.

2.2.9 Forudsætning for udførelse af FAT

 $\mbox{\em \formula}$ Hvad forudsætter afgørelsen for igangsættelse af FAT / når det og det er opfyldt, startes FAT

2.3 FAT-testdokument

Implementering 3

3.1 Indledning

Dette kapitel indeholder enhedstest,
integrationstest samt eee ee ee eacceptest. Alle udførte tests er reproducerbare, hvilket afspejles i den høje detaljegrad som testene er beskrevet i. For at kunne reproducere beskrevne tests, forventes et

kendskab til Labview, herunder LINX [LabVIEW MakerHub].

3.1.1 Formål

3.1.2 Læsevejledning

3.1.3 Versionshistorik

3.2 Enhedstest

Dette afsnit beskriver de indledende funktionstests, hvor hver enkelte selvstændige funktion i systemet afprøves.

3.2.1 Højtaler ABS-224-RC

Testformål

Det afprøves, om højtaleren kan generere en lyd.

Produktspecifikationer

Hardware:

Højtaler: ABS-224-RC

Højtalerkabel: Rød/Sort

2 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Arduino Mega 2560 R3

PC

USB kabel Hi-speed 2.0 shield 28AWG/2C+24AWG/2C Han USB A - Han USB B

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

Opstilling og opsætning

Højtaleren er loddet til højtalerkablets ene ende, og pin headerne er loddet til kablets anden ende. Pin headerne er isat Arduino'en i pin 46 (PL3(OC5A)), som et er digitalt PWM output, og til ground (GND). Arduino'en er med et USB kabel koblet til PC'en. Testopstillingen er vist i figur 3.1.




Figur 3.1: Testopstilling for enhedstest af Højtaler ABS-224-RC.

På PC'en er VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi åbnet i LabVIEW. Blokdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.2.

\mathbf{Udf} ørsel

- I Enter Frequency på frontpanelet i genererfrekvenssignal0.2.vi, indtastes 500.
- 2. Der trykkes på Run.
- 3. Der lyttes efter lydsignal fra højtaleren.

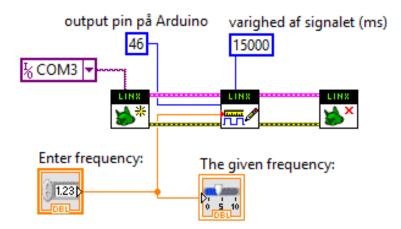

Figur 3.2: I blokdiagrammet genererfrekvenssignal0.2.vi er der anvendt følgende LINX-VI'er; Initialize, Digital Write Square Wave samt Close.

Resultater

Lydsignal blev generet og afspillet.

Diskussion

_

Konklusion

Højtaleren opfylder testen idet der generes en lyd. Samtidig konkluderes, at øvrigt anvendt HW og SW i denne test virker tilfredsstillende, og der vil derfor ikke blive lavet yderligere enhedstests på disse komponenter.

Aktion

_

3.2.2 Minijack PC Mikrofon

Testformål

Det afprøves, om mikrofonen kan optage en hørbar lyd og at det ikke er PC´ens indbyggede mikrofon som opfanger lyden

Produktspecifikationer

Hardware:

Minijack PC Mikrofon

PC


Software:

NI LabVIEW 2014

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

Mikrofonen er sat i PC'ens minijack-stik. Testopstillingen er vist i figur 3.3.

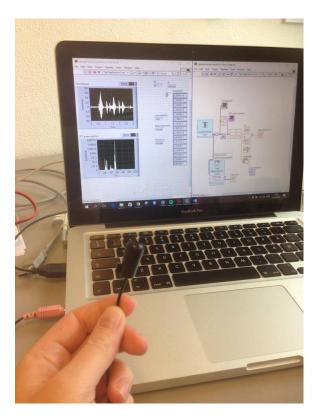


Figur 3.3: Testopstilling for enhedstest af Minijack PC Mikrofon.

På PC'en er VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi åbnet i LabVIEW. Blokdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.4.

www.onlinegenerator.com er åben i en browser på PC 'en.

Udførsel

1. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi, trykkes på Run.



Figur 3.4: I blokdiagrammet optagefrekvenssignal0.1.vi opsamles lydsignalet, som vises i en graf på frontpanelet.

- a) Der genereres en hørbar lyd til mikrofonen fra onlinegenerator.com.
- b) På frontpanelet i VI'et observeres om grafen viser frekvensudsving.
- 2. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi, trykkes på Run.
 - a) Mikronfonen dækkes nu med en hånd mhp. at mikrofonen ikke opfanger en lyd.
 - b) Der generes en hørbar lyd til mikrofonen fra onlinegenerator.com.
 - c) På frontpanelet i VI'et observeres om grafen viser frekvensudsving.

Resultater

Ad1. Der er observeret et udsving på grafen. Mikronen har opfanget et frekvenssignal.

Ad2. Der er ikke observeret et udsving på grafen. Mikrofonen har ikke opfanget et frekvenssignal.

Diskussion

_

Konklusion

Idet der ikke optages en hørbar lyd i Ad2., konkluderes det, at den hørbare lyd, optages gennem Ad1. Mikrofonen opfylder testen.

Aktion

_

3.2.3 Tores højtaler

Testformål

Det afprøves, om højtaleren kan generere en lyd.

Produktspecifikationer

Hardware:

Tores højtaler

Højtalerkabel: Rød/Sort

Kabelsko: Rød fladstik hun, str. 0.25-1.65 mm2, 6.6 mm bred fladstik

2 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Arduino Mega 2560 R3

PC

USB kabel Hi-speed 2.0 shield 28AWG/2C+24AWG/2C Han USB A - Han USB B

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

Opstilling og opsætning

Højtalerkablets ene ende er påsat kabelsko, som er påsat højtaleren. Til kablets anden ende er pin headere loddet fast. Pin headerne er isat Arduino'en i pin 46 (PL3(OC5A)), som et er digitalt PWM output, og til ground (GND). Arduino'en er med et USB kabel koblet til PC'en. Testopstillingen er vist i figur 3.5.



Figur 3.5: Testopstilling for enhedstest af Tores højtaler.

På PC'en er VI'et genererfrekvenssignalo.2.vi åbnet i LabVIEW. Blokdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.2.

Udførsel

Udføres på samme vis, som ved enhedstest af 3.2.1 Højtaler ABS-224-RC.

Resultater

Lydsignal blev generet og afspillet.

Diskussion

_

Konklusion

Højtaleren opfylder testen idet der generes en lyd.

Aktion

_

3.2.4 Ny enhedstest af Minijack PC Mikrofon d. 25.10.16

Testformål

Det afprøves, om mikrofonen kan optage en hørbar lyd og at det ikke er PC´ens indbyggede mikrofon som opfanger lyden

Produktspecifikationer

Hardware:

Minijack PC Mikrofon

PC

Smartphone

Software:

NI LabVIEW 2014

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

Mikrofonen er med en ledning tilsluttet PC'ens minijack-stik. Ledningens længde er godt en meter €€€SKAL MÅLES, og muliggør dermed, at PC'en er placeret i et rum, og mikrofonen med ledningen gennem den lukkede dør, er placeret i et andet rum. I en browser på smartphonen åbnes onlinetonegenerator.com. Smartphonen placeres ca. 2 cm fra mikrofonen.

På PC'en er VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi åbnet i LabVIEW. Blokdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.4.

Testopstillingen er vist i figur €€€€.

Udførsel

- 1. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi, trykkes på Run.
- 2. Der generes en hørbar lyd i onlinegenerator.com til mikrofonen.
- 3. På frontpanelet i VI'et observeres frekvensudsving på grafen.

Resultater

Der blev ikke observeret et frekvensudsving på grafen. Mikronen har ikke opfanget et frekvenssignal.

Diskussion

_

Konklusion

Mikrofonen opfanger intet frekvensudsving og det konkluderes, at den virker til at være deaktiv eller ude af funktion.

Aktion

Denne problemstilling må undersøges yderligere med henblik på at få en fungerende, aktiv mikrofon, som opfanger et frekvenssignal.

3.2.5 Enhedstest af indbygget mikrofon i Logitech HD WEBCAM C270

Testformål

Det afprøves, om den indbyggede mikrofon i webkameraet opfanger en hørbar lyd.

Produktspecifikationer

Hardware:

Logitech HD WEBCAM C270

PC

Smartphone

Software:

NI LabVIEW 2014

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

Webkameraet er tilsluttet PC'ens USB-port. PC'en er placeret i et rum med en dør, og webkameraet er placeret uden for døren. I en browser på smartphonen åbnes onlinetonegenerator.com. Smartphonen placeres ca. 2 cm fra webkameraet.

På PC'en er VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi åbnet i LabVIEW. Blokdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.4.

Testopstillingen er vist i figur 3.8.

Udførsel

- 1. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi, trykkes på Run.
- 2. Der generes en hørbar lyd i onlinegenerator.com til webkameraet.
- 3. På frontpanelet i VI'et afventes frekvensudsving på en graf.





(a) Placering af PC

(b) Placering af webkamera

Figur 3.6: Testopstilling for enhedstest af indbygget mikrofon i Logitech HD WEBCAM C270.

Resultater

Der observeres et udsving på grafen. Mikrofonen i webkameraet har opfanget en hørbar lyd.

Diskussion

_

Konklusion

Den indbyggede mikrofon i webkameraet opfanger et frekvensudsving, og det konkluderes, at den opfylder testen.

Aktion

Denne mikrofon er ikke hensigtsmæssig til brug i den videre test, da den er for stor til at kunne påsættes resonatoren. Næste skridt er at finde en mindre mikrofon med USB-stik.

3.2.6 Elektret mikrofon BOB 12758

Testformål

Det afprøves, om mikrofonen opfanger signaler med frekvenser i intervallet 20 Hz - $10~\mathrm{kHz}$.

Produktspecifikationer

Hardware:

Electret Microphone Breakout BOB 12758

3 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Mikrofonkabler: Rød/Sort/Blå

Krympeflex 2:1

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

USB kabel: National Instruments USB A/B 2.0 Cable (1 Meter)

PC

Software:

NI LabVIEW 2014


LabVIEW2014-NI-DAQmx-14

www.onlinetonegenerator.com


Opstilling og opsætning

På kablerne er pins fastloddet, som igen er loddet fast til mikrofonprintet. Det røde kabel forbinder mikrofonprintets "AUD"til "+AI0-indgangen på DAQ'en. Det sorte kabel forbinder mikrofonprintets GND til "GND-indgangen på DAQ'en. Det blå kabel forbinder mikrofonprintets "VCC"til "+5V"på DAQ'en. DAQ'en er med USB-kablet tilkoblet PC'en, hvorpå VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi er åbnet i LabVIEW. Blockdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.7.I en browser på PC'en er onlinetonegenerator.com åbnet.

Testopstillingen er vist i figur 3.8.

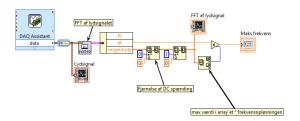

Figur 3.7: Blokdiagram for VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi.

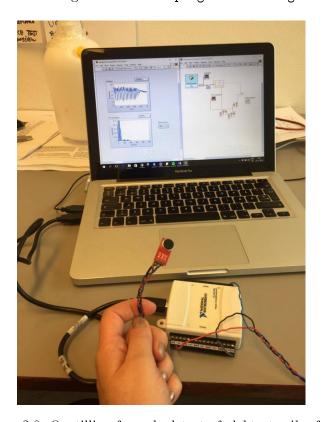

Figur 3.8: Opstilling for enhedstest af elektret mikrofon.

Udførsel

- 1. I VI'et optagefrekvenssignal
0.4.vi, trykkes på Run.
- 2. Der generes et signal med følgende frekvens: 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz , 5 kHz og 10 KHz fra onlinetonegenerator.com
- 3. På frontpanelet i VI'et observeres frekvensudsving på grafen.
- 4. Resultatet aflæses i Max Frequency på VI'ets frontpanel.

Testen fortages to gange for hver frekvens.

Tabel 3.1: Tabel over resultater

Udsendt frekvens [Hz]	1. resultat	2. resultat
100	20	40
500	500	500
1000	1000	1000
5000	3000	3000
10000	20	50

Resultater

Diskussion

Skyldes de upræcise resultater ved 100 Hz, at PC højtaleren's frekvensbånd ikke er lavt nok til at udsende et signal med en frekvens på 100 Hz?

Konklusion

Ved et signal med en frekvens på hhv. 100 Hz, 5 kHz og 10 kHz er resultaterne ikke tilnærmelsesvis de udsendte frekvenser. Det kan ikke konkluderes, hvorvidt det skyldes mikrofonen eller PC'ens højtalere.

Aktion

Der skal udføres en ny enhedstest af mikrofonen, hvor der er sikkert, at lydgiveren kan afgive frekvenser i mikrofonens frekvensbånd.

3.2.7 Electret Microphone Amplifier - MAX44662.5V

Testformål

Det afprøves, om mikrofonen opfanger signaler med frekvenser i intervallet 20 Hz - $1~\mathrm{kHz}.$

Produktspecifikationer

Hardware:

Electret Microphone Amplifier - MAX4466

3 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Mikrofonkabler: Rød/Sort/Blå

Krympeflex 2:1

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

USB kabel: National Instruments USB A/B 2.0 Cable (1 Meter)

PC

Software:

NI LabVIEW 2014

LabVIEW2014-NI-DAQmx-14

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

På kablerne er pins fastloddet, som igen er loddet fast til mikrofonprintet. Det røde kabel forbinder mikrofonprintets "AUD"til "+AI0-indgangen på DAQ'en. Det sorte kabel forbinder mikrofonprintets GND til "GND-indgangen på DAQ'en. Det blå kabel forbinder mikrofonprintets "VCC"til "+2.5V"på DAQ'en. DAQ'en er med USB-kablet tilkoblet PC'en, hvorpå VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi er åbnet i LabVIEW. Blockdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.7. I en browser på PC'en er onlinetonegenerator.com åbnet.

Testopstillingen er vist i figur 3.11.

Udførsel

- 1. I VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi, trykkes på Run.
- Der generes et signal med følgende frekvens: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz og 10 KHz fra onlinetonegenrator.com.
- 3. På frontpanelet i VI'et observeres frekvensudsving på grafen.
- 4. Resultatet aflæses i Max Frequency på VI 'ets frontpanel.


Testen fortages to gange for hver frekvens.

Resultater

Resultaterne vises i tabel 3.2.

Diskussion

I beskrivelsen af mikrofonen anbefales at bruge 2,5V som er den mest støjsvage forsyning. €€€ https://www.adafruit.com/products/1063 Skyldes de afvigende

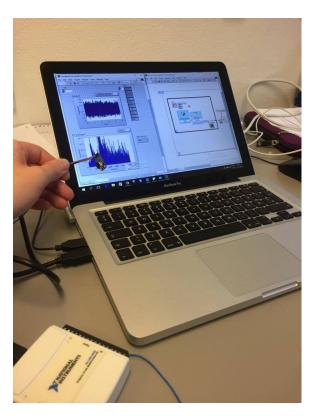

Figur 3.9: Opstilling for enhedstest af Electret Microphone Amplifier - MAX4466.

Tabel 3.2: Tabel over resultater

Udsendt frekvens [Hz]	1. resultat	2. resultat
20	96	96
50	22	15
100	95	95
1000	1000	1000
10000	4	15

resultater at der kun bruges 2,5V strømforsyning til at opsamle lyden?

Konklusion

Ved et signal med en frekvens på hhv. 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, og 10 kHz er resultaterne ikke tilnærmelsesvis de udsendte frekvenser. Det kan ikke konkluderes, hvorvidt det skyldes mikrofonen, et begrænset frekvensbånd på PC'ens højtaler eller en for lav strømforsyning til mikrofonen.

Aktion

Testen udføres igen med en strømforsyning på 5V.

3.2.8 Electret Microphone Amplifier - MAX44665V

Testformål

Det afprøves, om mikrofonen opfanger signaler med frekvenser i intervallet 20 Hz - $1~\mathrm{kHz}.$

Produktspecifikationer

Hardware:

Electret Microphone Amplifier - MAX4466

3 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Mikrofonkabler: Rød/Sort/Blå

Krympeflex 2:1

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

USB kabel: National Instruments USB A/B 2.0 Cable (1 Meter)

PC

Software:

 ${
m NI~LabVIEW~2014}$

LabVIEW2014-NI-DAQmx-14

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

På kablerne er pins fastloddet, som igen er loddet fast til mikrofonprintet. Det røde kabel forbinder mikrofonprintets "AUD"til "+AI0-indgangen på DAQ'en. Det sorte kabel forbinder mikrofonprintets GND til "GND-indgangen på DAQ'en. Det blå kabel forbinder mikrofonprintets "VCC"til "+5V"på DAQ'en. DAQ'en er med USB-kablet tilkoblet PC'en, hvorpå VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi er åbnet i LabVIEW. Blockdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.7. I en browser på PC'en er onlinetonegenerator.com åbnet.

Testopstillingen er vist i figur 3.11.



Figur 3.10: Opstilling for enhedstest af Electret Microphone Amplifier - MAX4466.

Udførsel

- 1. I VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi, trykkes på Run.
- Der generes et signal med følgende frekvens: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz og 10 KHz fra onlinetonegenrator.com.
- 3. På frontpanelet i VI'et observeres frekvensudsving på grafen.
- 4. Resultatet aflæses i Max Frequency på VI´ets frontpanel.

Testen fortages to gange for hver frekvens.

Resultater

Resultaterne vises i tabel 3.3.

Tabel 3.3: Tabel over resultater

${f Udsendt\ frekvens\ [Hz]}$	1. resultat	2. resultat
20	20	40
50	80	100
100	20	700
1000	1000	1000
10000	40	20

Diskussion

Strømforsyningen på 5V gjorde ikke afvigelserne i resultaterne mindre. Kan det være frekvensbåndet i PC´ens højtalere som ikke er bredt nok til at afspiller det ønskede frekvensbånd.

Konklusion

Ved et signal med en frekvens på hhv. 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, og 10 kHz er resultaterne ikke tilnærmelsesvis de udsendte frekvenser. Det kan ikke konkluderes, hvorvidt det skyldes mikrofonen eller et begrænset frekvensbånd på PC'ens højtaler.

Aktion

Frekvensbåndet mellem 100 og 1000 Hz ønskes testet, da det muligvis kan være tilstrækkeligt til de videre tests.

3.2.9 Electret Microphone Amplifier - MAX4466- frekvensbånd

Testformål

Det afprøves, om mikrofonen opfanger signaler med frekvenser i intervallet 100 Hz - $1~\mathrm{kHz}$.

Produktspecifikationer

Hardware:

Electret Microphone Amplifier - MAX4466

3 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Mikrofonkabler: Rød/Sort/Blå

Krympeflex 2:1

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

USB kabel: National Instruments USB A/B 2.0 Cable (1 Meter)

PC

Software:

NI LabVIEW 2014

LabVIEW2014-NI-DAQmx-14

www.onlinetonegenerator.com


Opstilling og opsætning

På kablerne er pins fastloddet, som igen er loddet fast til mikrofonprintet. Det røde kabel forbinder mikrofonprintets "AUD"til "+AI0-indgangen på DAQ'en. Det sorte kabel forbinder mikrofonprintets GND til "GND-indgangen på DAQ'en. Det blå kabel forbinder mikrofonprintets "VCC"til "+5V"på DAQ'en. DAQ'en er med USB-kablet tilkoblet PC'en, hvorpå VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi er åbnet i LabVIEW. Blockdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.7. I en browser på PC'en er onlinetonegenerator.com åbnet.

Testopstillingen er vist i figur 3.11.

Udførsel

- 1. I VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi, trykkes på Run.
- 2. Der generes et signal med følgende frekvens: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz,

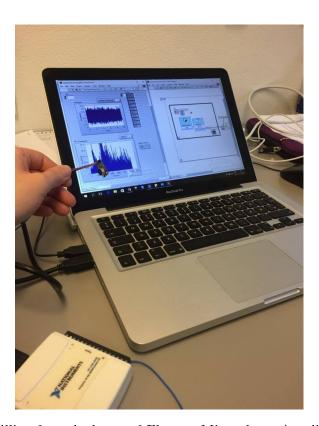

Figur 3.11: Opstilling for enhedstest af Electret Microphone Amplifier - MAX4466.

 $300,\ 400\ \mathrm{Hz},\ 500\ \mathrm{Hz},\ 600\ \mathrm{Hz},\ 700\ \mathrm{Hz},\ 800\ \mathrm{Hz},\ 900\ \mathrm{Hz}$ og 1 kHz fra onlinetonegen
rator.com.

- 3. På frontpanelet i VI'et observeres frekvensudsving på grafen.
- 4. Resultatet aflæses i Max Frequency på VI'ets frontpanel.

Testen fortages to gange for hver frekvens.

Resultater

Resultaterne vises i tabel??.

Diskussion

Resultaterne af det udsendte frekvenssignal på 100 Hz er afvigende. Det kan muligvis skyldes et begrænset frekvensbånd i PC-højtaleren.

Konklusion

Det anvendte hardware kan opfange et frekvensbånd fra 150 Hz - 1 kHz med en nøjagtighed på 100 pct.

Aktion

Det er besluttet at anvende mikrofonen i det videre testforløb.

Tabel 3.4: Tabel over resultater

${f Udsendtfrekvens[Hz]}$	1. resultat	2. resultat
100	20	80
150	150	150
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000

3.2.10 Multimedia USB Speaker HP-1800

Testformål

Det afprøves, om højtaleren kan generere signaler med frekvenser i intervallet 20 Hz - $1500~{\rm Hz}$.

Produktspecifikationer

Hardware:

Electret Microphone Amplifier - MAX4466

3 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Mikrofonkabler: Rød/Sort/Blå

Krympeflex 2:1

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

USB kabel: National Instruments USB A/B 2.0 Cable (1 Meter)

Multimedia USB Speaker HP-1800

PС

Software:

NI LabVIEW 2014


LabVIEW2014-NI-DAQmx-14

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

På kablerne er pins fastloddet, som igen er loddet fast til mikrofonprintet. Det røde kabel forbinder mikrofonprintets "AUD"til "+AI0-indgangen på DAQ'en. Det sorte kabel forbinder mikrofonprintets GND til "GND-indgangen på DAQ'en. Det blå kabel forbinder mikrofonprintets "VCC"til "+5V"på DAQ'en. DAQ'en er med USB-kablet tilkoblet PC'en, hvorpå VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi er åbnet i LabVIEW. Blockdiagrammet for VI'et er vist i figur 3.7. Højtaleren er tilsluttet PC'ens USB-port og minijack-stik, og er placeret ca. 2 cm. fra mikrofonen. I en browser på PC'en er onlinetonegenerator.com åbnet.

Testopstillingen er vist i figur 3.12.

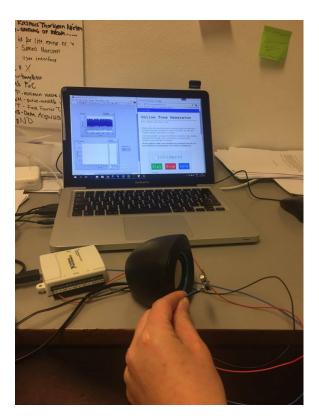

Figur 3.12: Opstilling for enhedstest af Electret Microphone Amplifier - MAX4466.

Udførsel

- Der generes et signal med henholdvis følgende frekvens: 20 Hz, 75 Hz, 80 Hz,
 90 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 300, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 800
 Hz, 900 Hz, 1000 Hz, 1100 Hz, 1200 Hz, 1300 Hz, 1400 Hz og 1500 Hz fra onlinetonegenrator.com.
- 2.
- I VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi, trykkes på Run efter hvert genereret frekvens.
- 4. På frontpanelet i VI'et aflæses frekvensen i Maks frekvens

Testen fortages to gange for hver frekvens.

Resultater

Resultaterne vises i tabel 3.5.

Diskussion

Frekvenser op til 90 Hz og frekvenser fra 1300 Hz til 1500 afviger fra de udsendte frekvenser. Kan det muligvis skyldes mikrofonen ikke kan optage disse signaler eller

Tabel 3.5: Tabel over resultater

Udsendt frekvens [Hz]	1. resultat	2. resultat
20	20	50
75	70	80
80	90	80
90	90	90
100	100	100
150	150	150
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000
1100	1100	1100
1200	1200	1200
1300	1200	1200
1400	1100	1100
1500	1000	1000

skyldes det højtaleren ikke kan generere frekvenserne?

Konklusion

Det konkluderes at højtaleren kan leverer frekvenser fra 90 til 1200 Hz.

Aktion

Det vælges at anvende denne højtaler til det videre testforløb, hvor resonansfrekvens i et tomt kammer måles.

3.2.11 SW LabVIEW FFT af signal

Testformål

Denne test har til formål at sikre at den maksfrekvens som LabVIEW er kodet til at detektere stemmer overens med den maksfrekvens som findes i det inputsignal som optages.

${\bf Produkt specifikation er}$

Hardware:

PC

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1


VI Package Manager

LabVIEW2014-NI-DAQmx-14


www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning


optagefrekvenssignal0.4.vi er åbnet og onlinetonegeneratoren er åbnet i browseren på PC'en. Blokdiagrammet er vist i figur ??. I blokdiagrammet i optagefrekvenssignal0.4.vi åbnes DAQ assistant modulet og i Samples to read indtastes 800 og i Rate(Hz) indtastes 8000. Dette vises i figur 3.13. I onlinetonegeneratoren åbnes DMTF generatoren som er vist i figur 3.15

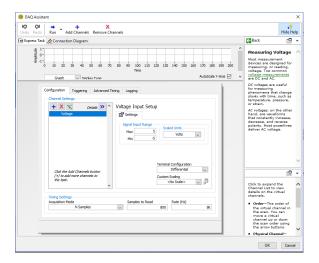

Figur 3.13: DAQ assistant modulet med korrekt indtastet værdier



Figur 3.14: Blokdiagram for VI'et optagefrekvenssignal0.4.vi.

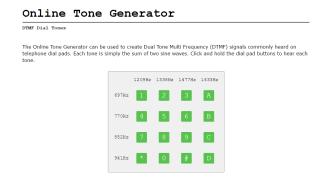

Figur 3.15: DTMF generatoren

Udførsel

- 1. En DTMF tone 1 vælges i tonegeneratoren. Den højste frekvens i DTMF tonen noteres.
- 2. Tonen afspilles og der trykkes på run i VI'et som nu optager tonen.
- 3. Maksfrekvensen aflæses på frontpanlet i *Maks frekvens* og sammenholdes med den tidligere noteret maksfrekvens. Disse skulle gerne stemme overens.

Denne udførsel gentages med tone 5, 9 samt D fra DTMF generatoren.

Resultater

Diskussion

_

Konklusion

Resultaterne af testen ligger acceptabelt tæt på de afsendte frekvenser.

Aktion

Det besluttes at godkende testen og bruge koden i det videre forløb.

Tabel 3.6: Tabel over resultater

DTMF tone	Højeste frekvens	Resultat
1	1209	1209,6
5	1336	1332,16 1475,84
9	1477	1475,84
D	1633	1633,4

3.2.12 SW LabVIEW volumenformel

Testformål

Denne test har til formål at afklare om den kodet helmholtzresonansformel i LabVIEW udregner korrekt volumen ud fra givet værdier.

Produktspecifikationer

Hardware:

PC

Texas Instruments TI-89

Software:

NI LabVIEW 2014


Opstilling og opsætning

 ${\tt HelmholtzresonansVolumenformel.vi}$ er åbnet. Blokdiagrammet for ${\tt VI'et}$ ses i figur 3.16


På TI-89´eren indtastes formlen for udregningen af volumen ud fra helmholtzresonansen. Formel defineres således

$$W = V * \left(1 - \left(\frac{f_0}{f_b}\right)^2\right) \tag{3.1}$$

Indtastningen op TI-89'eren ses på figur 3.17,hvor værdierne er angivet således at $v = 1671, f_0 = 150 \text{ og } f_b = 250$. Resultatet af indtastning giver volumet W = 1069.44



Figur 3.16: Blokdiagram for VI'et Helmholtzresonansformel.

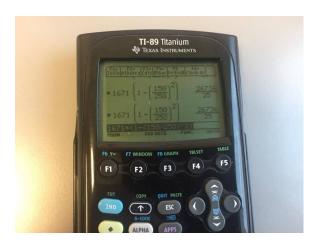

Figur 3.17: Indtastning af formel på TI-89

Udførsel

- 1. De overnævnte værdier indtastes i blokdiagrammet på de korrekte pladser.
- 2. Der trykkes på Run
- 3. Resultat af udregningen aflæses på frontpanelet i feltet Resultat.
- 4. Resultatet fra TI-89 og VI´et sammenlignes.

Resultat

Volumet, regnet på TI-89´erne, angav at W=1069.44. Volumet, regnet i VI´et, angav at W=1069.44.

Diskussion

_

Konklusion

Da resultatet af udregningen er ens for begge metoder, godkendes testen.

Aktion

Det besluttes at den kodede formel fra VI´et kan bruges i det videre udviklingsforløb i LabVIEW.

3.3 Integrationstest

3.3.1 Bordtest nr. 1

Testformål

Det afprøves, at generere et frekvenssignal som udsendes gennem højtaleren, og derefter opfanges af mikrofonen, hvor den højst målte frekvens til sidst angives.

Produktspecifikationer

Hardware:

Højtaler: ABS-224-RC

Højtalerkabel: Rød/Sort

2 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Arduino Mega 2560 R3

PC

USB kabel Hi-speed 2.0 shield 28AWG/2C+24AWG/2C Han USB A - Han USB B

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

Opstilling og opsætning

1. delopstilling:

Højtaleren er loddet til højtalerkablets ene ende, og pin headerne er loddet til kablets anden ende. Pin headerne er isat Arduino'en i pin 46 (PL3(OC5A)), som et er digitalt PWM output, og til ground (GND). Arduino'en er med et USB kabel koblet til PC'en. På PC'en er VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi åbnet i LabVIEW. Testopstillingen for denne del er vist i figur 3.1, og blokdiagrammet er vist i figur 3.2.

2. delopstilling:

Mikrofonen er sat i PC'ens minijack-stik. På PC'en er VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi åbnet i LabVIEW. Testopstillingen for denne del er vist i figur 3.3, og blokdiagram-

met er vist i figur 3.4.

Udførsel

- 1. Højtaleren holdes manuelt således membranen står i lodret position.
- 2. Mikrofonen holdes manuelt, vendt mod højtaleren, i en afstand på 5 cm.
- 3. I VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi indtastes den ønskede frekvens i den numeriske kontrol *Enter Frequency*.
 - a) Koden eksekveres ved at trykke på Run.
- 4. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi trykkes på Run.
 - a) Den maksimale optagede frekvens aflæses i Max Frequency.

Punkt 1-4 gentages med frekvenser på: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz og 700 Hz.

Resultater

Den maksimale optagede frekvens var ikke tilnærmelsesvis frekvensen på den udsendte tone.

Diskussion

Det ønskede resultat er frekvensen på den udsendte tone, hvilket ikke var tilfældet i denne test. Hvor er fejlen opstået; er der fejl i LabVIEW-kode eller hardware?

Konklusion

Det er nødvendigt at undersøge om fejlen opstår i vores hardware eller software.

Aktion

Det skal med en online tonegenerator undersøges, hvor fejlen er opstået.

3.3.2 Bordtest nr. 2

Testformål

Det afprøves, at generere et frekvenssignal fra en online tonegenerator, som udsendes gennem PC'ens højtaler, og derefter opfanges af mikrofonen, hvor den højst målte frekvens til sidst angives.

Produktspecifikationer

Hardware:

Minijack PC Mikrofon

PC

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

Mikrofonen er sat i PC'ens minijack-stik. På PC'en er VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi åbnet i LabVIEW. Testopstillingen for denne del er vist i figur 3.3, og blokdiagrammet er vist i figur 3.4.

I en internetbrowser er hjemmesiden www.onlinetonegenerator.comåbnet, og PC'ens højtalere er slået til.

Udførsel

- 1. Mikrofonen holdes manuelt, vendt mod PC'ens højtaler, i en afstand på 5 cm.
- 2. I onlinetonegenerator.com genereres et signal med den ønskede frekvens.
- 3. I VI'et optagefrekvenssignal
0.1.vi ${\rm trykkes}$ på ${\it Run}.$
 - a) Den maksimale optagede frekvens aflæses i Max Frequency.

Punkt 1-4 gentages med frekvenser på: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz og 700 Hz.

Resultater

Den optagede frekvens var den generede udsendte frekvens (+/- 0.5 Hz).

Diskussion

Der opnås nu pæne resultater, og der reflekteres over om resultaterne i 3.3.1 skyldes fejl i højtaler eller fejl i VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi.

Konklusion

Det konkluderes, at der ikke er fejl i VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi.

Aktion

Det skal undersøges, hvilken forskel der er på frekvenssignalet fra onlinetonegenerator.com og det generede frekvenssignal udsendt fra højtaleren ABS-224-RC.

3.3.3 Bordtest nr. 3

Testformål

Det undersøges, hvilken forskel der er på frekvenssignalet fra onlinegenerator.com og det genererede frekvenssignal udsendt fra højtaleren ABS-224-RC.

Produktspecifikationer

Hardware:

Højtaler: ABS-224-RC

Højtalerkabel: Rød/Sort

2 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Krympeflex 2:1Arduino Mega 2560 R3

USB kabel Hi-speed 2.0 shield 28AWG/2C+24AWG/2C Han USB A - Han USB B

PC

Minijack PC Mikrofon

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

1. delopstilling:

Højtaleren er loddet til højtalerkablets ene ende, og pin headerne er loddet til kablets anden ende. Pin headerne er isat Arduino'en i pin 46 (PL3(OC5A)), som et er

digitalt PWM output, og til ground (GND). Arduino'en er med et USB kabel koblet til PC'en. På PC'en er VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi åbnet i LabVIEW. Testopstillingen for denne del er vist i figur 3.1, og blokdiagrammet er vist i figur 3.2.

$2.\ delops tilling$:

Mikrofonen er sat i PC'ens minijack-stik. På PC'en er VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi åbnet i LabVIEW. Testopstillingen for denne del er vist i figur 3.3, og blokdiagrammet er vist i figur 3.4.

$3. \ delopstilling:$

I en internetbrowser er hjemmesiden www.onlinetonegenerator.com åbnet, og PC'ens højtalere er slået til.

Udførsel

1. deltest

- 1. Højtaleren holdes manuelt således membranen står i lodret position.
- 2. Mikrofonen holdes manuelt, vendt mod højtaleren, i en afstand på 5 cm.
- 3. I VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi indtastes den ønskede frekvens i den numeriske kontrol *Enter Frequency*.
 - a) Koden eksekveres ved at trykke på Run.
- 4. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi trykkes på Run.
 - a) Den maksimale optagede frekvens aflæses i Max Frequency.

2. deltest

- 1. Mikrofonen holdes manuelt, vendt mod PC'ens højtaler, i en afstand på 5 cm.
- 2. I onlinetonegenerator.com genereres et signal med den ønskede frekvens.
- 3. I VI'et optagefrekvenssignal0.1.vi trykkes på Run.
 - a) Den maksimale optagede frekvens aflæses i Max Frequency.

Deltestene gentages med frekvenser på: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700, 1000 0g 1200 Hz, og resultaterne sammenholdes.

Resultater

Det blev observeret, at resultaterne fra det generede frekvenssignal i VI'et genererfrekvenssigna var grundtonens harmoniske overtoner, idet frekvensen udsendes som et firkantsignal. Kun ved højfrekvente signaler (<1 kHz), blev grundtonen opfanget. Ved at benytte onlinetonegenerator.com, kunne der udsendes et sinussignal med en given frekvens, som blev korrekt opfanget (+/- 0.5 Hz).

Diskussion

Der opnås pæne resultater ved at bruge et sinussignal, men der er desværre meget kompliceret at generere sinussignaler til en Arduino.

Konklusion

Det konkluderes, at der ikke er fejl i software og hardware, og de unøjagtige resultater skyldes firkantsignalets harmoniske overtoner.

Aktion

Det skal undersøges, om det er muligt at filtrere firkantssignalets harmoniske overtoner fra, således firkantssignalet kan benyttes.

3.3.4 Bordtest nr. 4

Testformål

Det undersøges, om en resonatorlignende beholder kan dæmpe de harmoniske overtoner fra firkantsignalet.

Produktspecifikationer

Hardware:

Tores højtaler

Højtalerkabel: Rød/Sort

Kabelsko: Rød fladstik hun, str. 0.25-1.65 mm2, 6.6 mm bred fladstik

2 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Krympeflex 2:1

Arduino Mega 2560 R3

Minijack PC Mikrofon

PC

USB kabel Hi-speed 2.0 shield 28AWG/2C+24AWG/2C Han USB A - Han USB B Tryksprøjte NSG 150 - Neptun (resonator)

Lineal

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

Opstilling og opsætning

Højtalerkablets ene ende er påsat kabelsko, som er påsat højtaleren. Til kablets anden ende er pin headere loddet fast og forsejlet med krympeflex. Pin headerne er isat Arduino'en i pin 46 (PL3(OC5A)), som et er digitalt PWM output, og til ground (GND). Arduino'en er med et USB kabel koblet til PC'en. Mikrofonen er sat i PC'ens minijack-stik og er ført ned i resonatoren hvor den ligger i bunden. Højtaleren placeres i en afstand på en halv diameter af højtalerens membran, ovenfor resonatorens hals.

På PC'en er VI'erne genererfrekvenssignal0.2.vi og optagefrekvenssignal0.2.vi åbnet i LabVIEW og blokdiagrammerne er vist i figur 3.2 og 3.4

Testopstillingen kan ses på figur 3.18.

Udførsel

- Tryksprøjtedelen afmonteres beholderen og fungerer nu som resonator.
 Resonatoren stilles på et bord med halsen pegende opad.
- 2. Mikrofonen føres ned i resonatoren og ligger i resonatorens bund.
- 3. Linealen påsættes resonatorens hals så den fungerer som afstandsmåler fra halsåbningen.
- 4. Højtaleren holdes manuelt over resonatorhalsen i en afstand på en halv diameter af højtalermembranen. Ved anvendelse ef den specificerede højtaler er afstanden to centimeter.



Figur 3.18: Testopstilling for bordtest 4

- 5. I VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi indtastes den ønskede frekvens i den numeriske kontrol *Enter Frequency*.
 - a) Koden eksekveres ved at trykke på Run.
- 6. I VI'et optagefrekvenssignal0.2.vi trykkes på Run.
 - a) Den maksimale optagede frekvens aflæses i Max Frequency.

Testen udføres med en frekvens på 200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz og 1200 Hz. Der afprøves to gange med hvert frekvens


Resultater

Det blev observeret ved begge forsøg, at resultatet fra det generede frekvenssignal i VI'et generefrekvenssignal0.2.vi på 500 Hz var en af grundtonens harmoniske overtoner på 1500 Hz. Dette ses i figur 3.19.


Det blev observeret i første forsøg, at resultatet fra det generede frekvenssignal i VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi på 200 Hz var en af grundtonens harmoniske overtone på 1803 Hz og i andet forsøg observeres en harmonisk overtone 1402,33 Hz. Resultatet fra første forsøg vises i figur 3.20.

Det blev observeret i første forsøg, at resultatet fra det generede frekvenssignal i VI'et generefrekvenssignal0.2.vi på 1000 Hz var en af grundtonens harmoniske overtoner på 3000,33 Hz i. Dette ses i figur 3.21. I det andet forsøg observeres det at resultatet stemmer overens med den afspillede grundtone. Dette ses på figur 3.22.

Det blev observeret, at resultatet fra den generede frekvenssignal i VI'et genererfrekvenssignal opå 1200 Hz stemmer overens med den afspillede grundtone. Dette ses på figur 3.23.

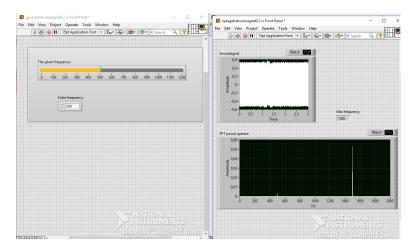


Figur 3.19: Resultat for for bordtest 4 ved anvendelse af 500 Hz

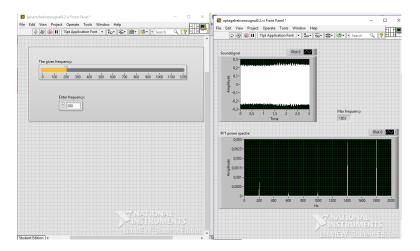


Figur 3.20: Resultat for for bordtest 4 ved anvendelse af 200 Hz

Diskussion

Ved forsøget med 1000 Hz observeres, at de to resultater ikke er tilnærmelsesvis ens. I første forsøg blev en harmonisk overtone opfanget, som den maksimale frekvens, hvor der i andet forsøg blev opfanget grundtonen på den genererede frekvens. Disse to resultater skal være ens og derfor er de ikke tilfredsstillende.

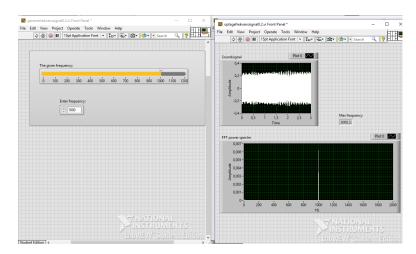

Figur 3.21: Resultat for for bordtest 4 ved anvendelse af 1000 Hz

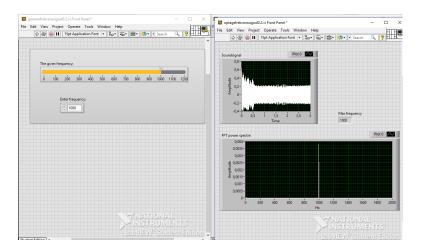


Figur 3.22: Resultat for for bordtest 4 ved anvendelse af 1000 Hz

Konklusion

Ved generering af frekvenser lavere end 1000 Hz opfanges harmoniske overtoner, i stedet for grundtonen, som er det ønskede resultat. Ved generering af frekvenser lig 1000 Hz opfanges ustabile resultater. Ved generering af frekvenser højere end 1000 Hz, opnås pæne resultater, hvor den genererede frekvens er lig den opfangede frekvens. Dermed konkluderes, at resonatoren i dette tilfælde ikke virker dæmpende på harmoniske overtoner på frekvenser lavere end 1000 Hz.

Aktion

Det skal undersøges, om målinger genereret med en frekvens lig eller højere end 1000 Hz er stabile.

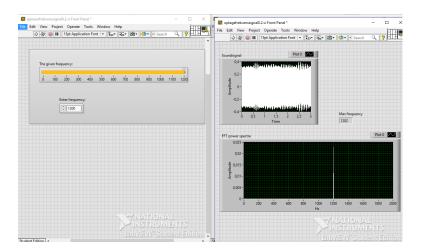

Figur 3.23: Resultat for for bordtest 4 ved anvendelse af 1200 Hz

3.3.5 Bordtest nr. 5

Testformål

Det undersøges, om firkantsignaler genereret med frekvenser lig eller højere end 1000 Hz er stabile og hvilken effekt helmHoltz resonatoren har på signalerne.

Produktspecifikationer

Hardware:

Tores højtaler

Højtalerkabel: Rød/Sort

Kabelsko: Rød fladstik hun, str. 0.25-1.65 mm2, 6.6 mm bred fladstik

2 stk. Male Single Row Pin Header Strip 2.54 mm.

Krympeflex 2:1

Arduino Mega 2560 R3

Minijack PC Mikrofon

PC

USB kabel Hi-speed 2.0 shield 28AWG/2C+24AWG/2C Han USB A - Han USB B

Tryksprøjte NSG 150 - Neptun (resonator)

Lineal

Software:

NI LabVIEW 2014

NI VISA 15.0.1

VI Package Manager

ARDUINO 1.6.12

Opstilling og opsætning

Højtalerkablets ene ende er påsat kabelsko, som er påsat højtaleren. Til kablets anden ende er pin headere loddet fast og forsejlet med krympeflex. Pin headerne er isat Arduino'en i pin 46 (PL3(OC5A)), som et er digitalt PWM output, og til ground (GND). Arduino'en er med et USB kabel koblet til PC'en. Mikrofonen er sat i PC'ens minijack-stik og er ført ned i resonatoren hvor den ligger i bunden. Højtaleren placeres i en afstand på en halv diameter af højtalerens membran, ovenfor resonatorens hals.

På PC'en er VI'erne genererfrekvenssignal0.2.vi og optagefrekvenssignal0.2.vi åbnet i LabVIEW og blokdiagrammerne er vist i figur 3.2 og 3.4

Testopstillingen er den samme som i bordtest 4, og vises i figur 3.18.

Udførsel

- Tryksprøjtedelen afmonteres af beholderen og fungere nu som resonator.
 Resonatoren stilles på et bord med halsen pegende opad.
- 2. Mikrofonen føres ned i resonatoren og ligger i resonatorens bund.
- 3. Linealen påsættes resonatorens hals så den fungere som afstandsmåler fra halsåbningen.
- 4. Højtaleren holdes manuelt over resonatorhalsen i en afstand på en halv diameter af højtalermembranen. Ved anvendelse ef den specificerede højtaler er afstanden to centimeter.
- 5. I VI'et genererfrekvenssignal0.2.vi indtastes den ønskede frekvens i den numeriske kontrol *Enter Frequency*.
 - a) Koden eksekveres ved at trykke på Run.
- 6. I VI'et optagefrekvenssignal0.2.vi trykkes på Run.
 - a) Den maksimale optagede frekvens aflæses i Max Frequency.

Testen udføres med en frekvens på 950 Hz, 1000 Hz, 1100 Hz, 1200 Hz og 1300 Hz. Testen fortages to gange med hver frekvens.

Tabel 3.7: Tabel over resultater

Udsendt frekvens [Hz]	1. resultat	2. resultat
950	954.33	954.33
1000	1000.00	1000.00
1100	1101.33	1101.33
1200	1202.00	1202.00
1300	1302.00	1302.00

Resultater

Ud fra tabellen ses at de opfangede signaler er stabile ved alle udsendte frekvenser. Det ses ydermere at de afsendte signaler ikke ser ud til at være påvirket af Helmholtzresonatoren

Diskussion

De opfangede frekvensers variation er tilfredsstillende til brug i det videre udviklingsforløb. De optagede frekvenser afviger ikke fra de udsendte frekvenser selvom de udsendte frekvenser er opfanget i resonatoren. Det er Helmholtz resonansen som ønskes opfanget og den formodes at afvige fra den udssendte frekvens. Dette er dog ikke tilfældet i denne tests resultater. Det undres over de optagede frekvenser ikke er påvirkede af resonatoren og der sås nu tvivl minijack mikrofonen opfanger signalerne eller om det er PC mikrofonen som opfanger signalerne

Konklusion

Frekvenser over 950 Hz kan opfanges som grundtonen og det opfangede signal er ikke forstyrret at de harmoniske overtoner. Det ser ikke ud til at de opfangede frekvenser ikke er påvirket af resonatoren, hvilket vil være forventeligt. Det konkluderes at det det er nødvendigt at undersøge om minijack mikrofonen opfanger de afsendte signaler.

Aktion

Der udføres en ny enhedstest af minijack mikrofonen for at klarlægge om mikrofonen opfanger signalerne.

3.3.6 Bordtest nr. 6 - resonansfrekvens i tomt kammer

Testformål

Det ønskes, at finde resonansfrekvensen f_0 i den tomme resonator, således denne kan verificeres i forhold til resonatorens kendte volumen.

Produktspecifikationer

Hardware:

Multimedia USB Speaker HP-1800

Electret Microphone Amplifier - MAX4466

Multifunction Data Acquisition (DAQ) USB-6009

Tryksprøjte NSG 150 - Neptun

Danalim klæbemasse 312

Lineal

MY DOUGH modellervoks

Etronit MBM PhenolicMelamine plade

PC

Software:

NI LabVIEW 2014

LabVIEW2014-NI-DAQmx-14

www.onlinetonegenerator.com

Opstilling og opsætning

Flasken er skruet af tryksprøjten, og bunden er savet af i et lige snit. Denne flaske har funktionen som resonator i testen. Resonatoren vises i figur 3.24. Resonatoren er placeret på pladen, og er tætnet med modellervoks i kanten mellem resonator og plade. Trykventilen på flasken er også tætnet med modellervoks. En lineal er påsat flaskehalsen, og benyttes til afstandsmåling. Mikrofonen er monteret på resonatorens inderside med klæbemasse. Mikrofonen placeres mindre end resonatorhalsens længde fra resonatorhalsens indre åbning. Mikrofonen er endvidere tilkoblet DAQ'en, som er tilsluttet PC'en. På PC'en er LabVIEW VI'et optagefrekvenssignal05.vi åbnet. Blokdiagrammet vises i figur 3.25. Højtaleren

er tilsluttet PC'en, og www.onlinetonegenerator.comer åbnet i en browser, hvor pink noise genereres. Højtaleren holdes i en afstand på en halv diameter af halsåbningen fra halsens indgangen.


Udførsel

- 1. Pink noise genereres fra www.onlinetonegenerator.comud gennem højtaleren.
- 2. Gentagelse af antal loops i blokdiagrammet sættes til 10, og der optages 4 sekunder af gangen.
- 3. Der tykkes Run i VI'et.
- 4. Resonansfrekvens f_0 aflæses i Resonansfrekvens af kammer med objekt.

Resultater



Figur 3.24: Resonator fremstillet af Tryksprøjte NSG 150 - Neptun.

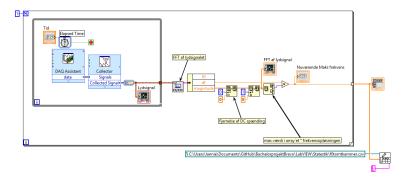

Figur 3.25: Bolkdiagram for LabVIEW VI'et optagefrekvenssignal05.vi.

Tabel 3.8: Tabel over resultater

#	f_0 [Hz]
1	
2 3	
4	
5	
5 6	
7	
8 9	
9	
10	

Find en plads til det her 4

4.1 Bestemmelse af volumen af resonator

Volumen af resonatoren skal kendes for at bestemme resonansfrekvensen i det tomme kammer. Volumen er udregnet ved at hælde vand i resonatoren, og derefter måle vandets vægt. Ud fra vandets vægt kunne volumen gives.

$$V = \frac{m}{\rho} \tag{4.1}$$

$$V_{resonator} = \frac{1698 \,\mu\text{g/cm}^3}{1000 \,\text{kg/m}^3} \tag{4.2}$$

$$V_{resonator} = 1,698 \,\mathrm{m}^3 = 1,698 \,\mathrm{L}$$
 (4.3)

4.1.1 Bestemmelse af volumen af resonator ekskl. halsvolumen

Volumen af resonatoren ekskl. halsvolumen er udregnet på samme fremgangsmåde ved brug af ligning 4.1.