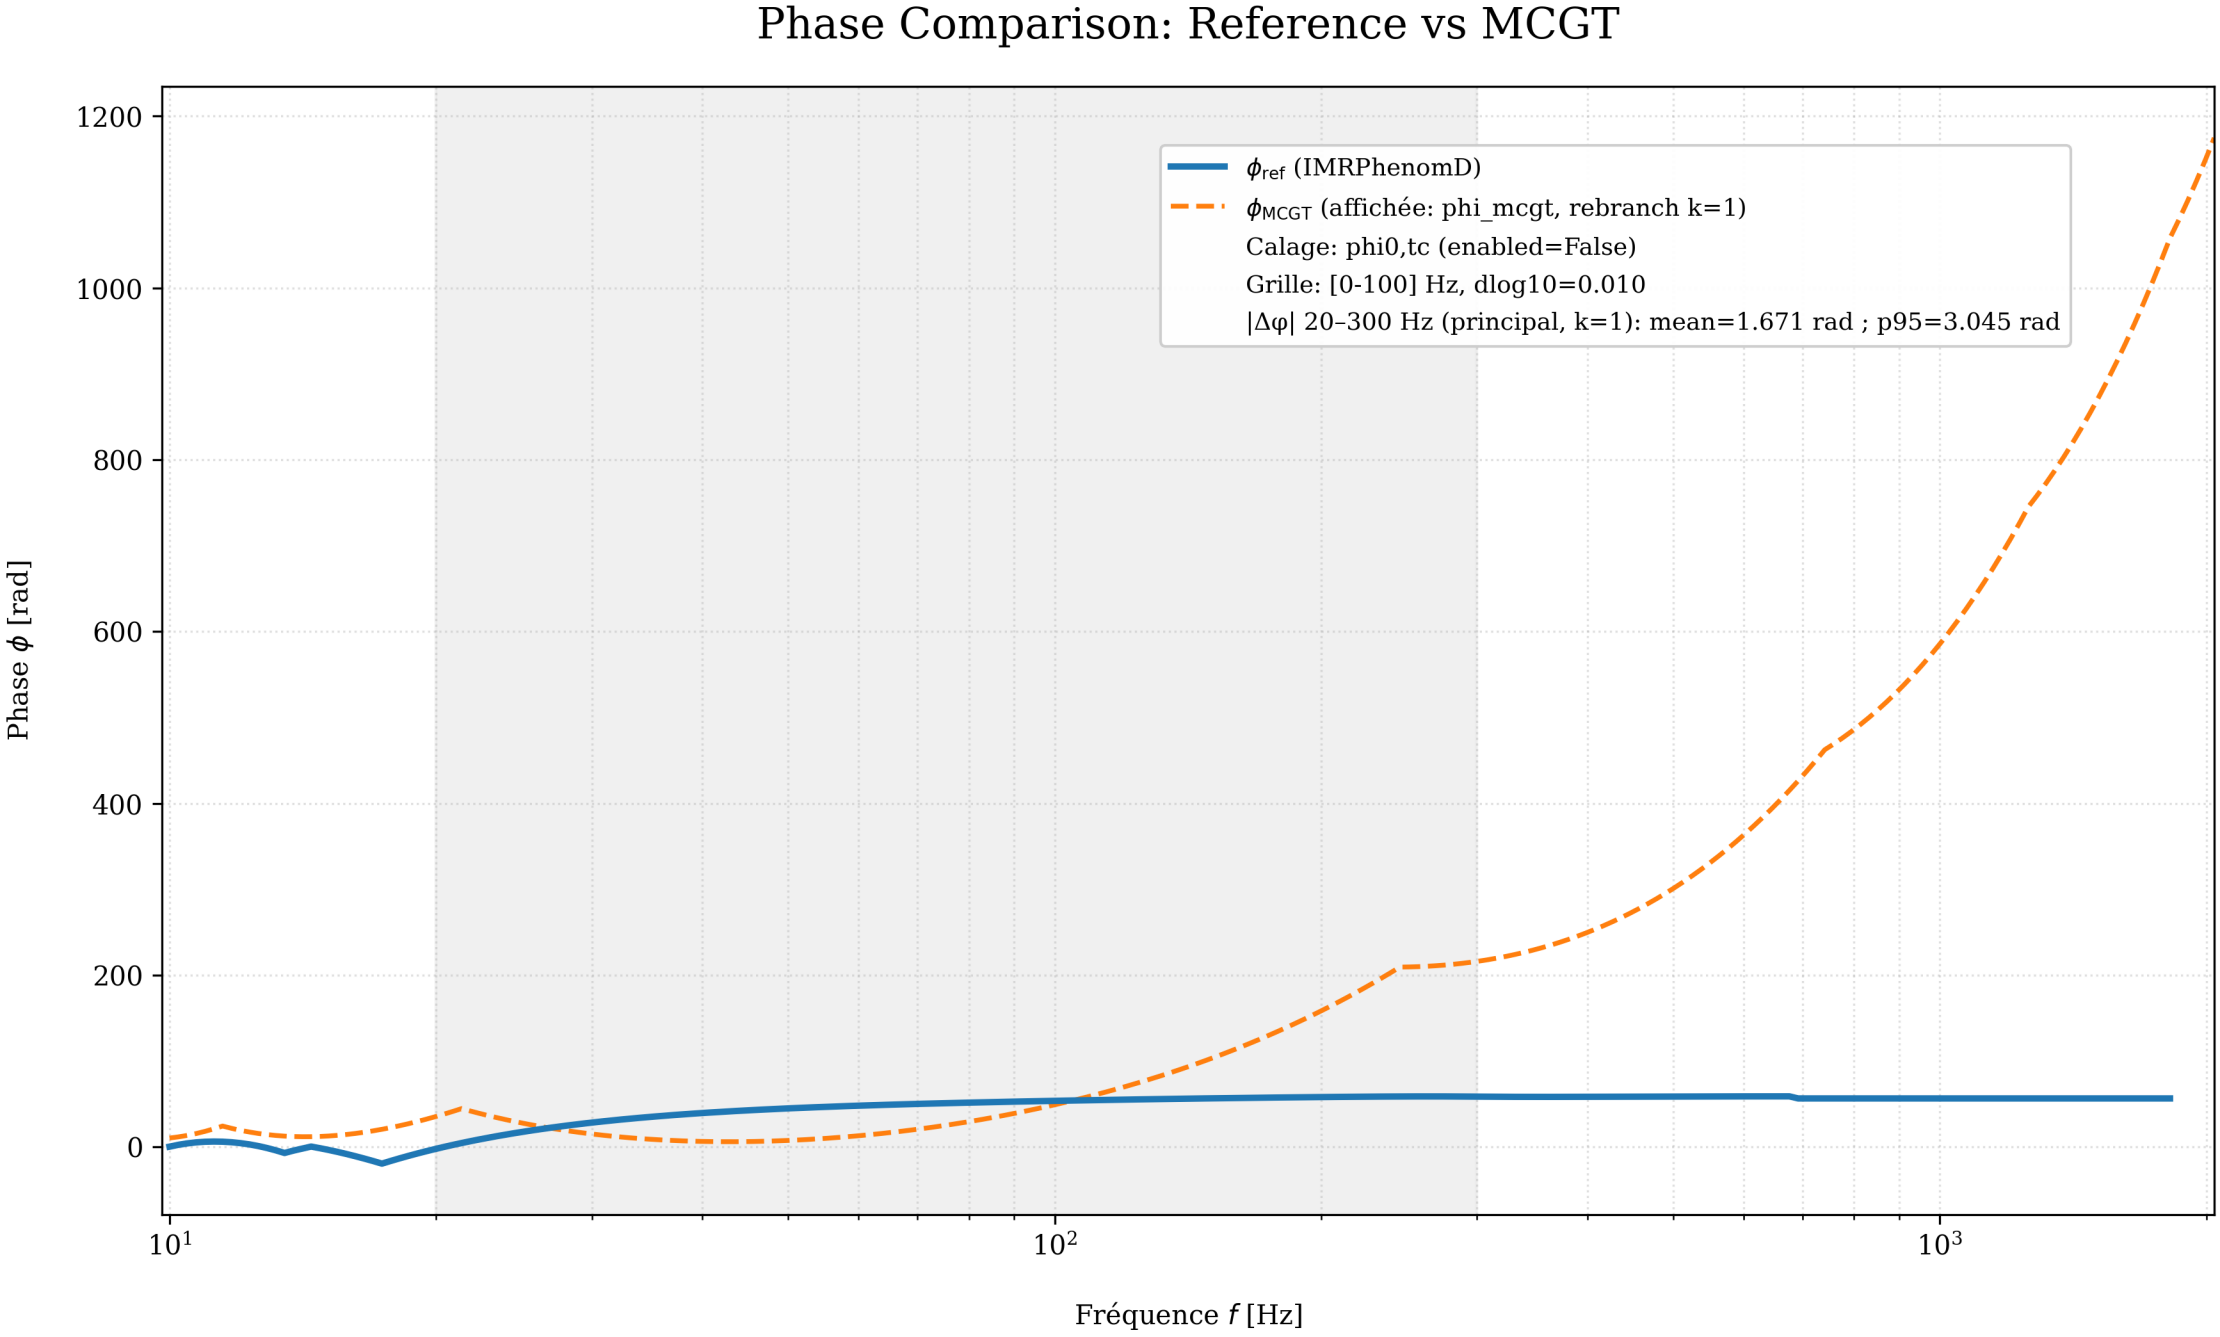
Phase Comparison: Reference vs MCGT
ϕ_{ref} (IMRPhenomD)
ϕ_{MCGT} (affichée: phi_mcgt, rebranch k=1)
Calage: phi0,tc (enabled=False)
Grille: [0-100] Hz, dlog10=0.010
|Δφ| 20–300 Hz (principal, k=1): mean=1.671 rad ; p95=3.045 rad
Phase ϕ [rad]
Fréquence f [Hz]
1200
1000
800
600
400
200
0
10^1
10^2
10^3