


no. of the sticker on the nmr tube 576
color of the label blue
workgroup Broering
KRJ MKZ NaCp
proton.ibk_35 C6D6 {D:\u} zam 7

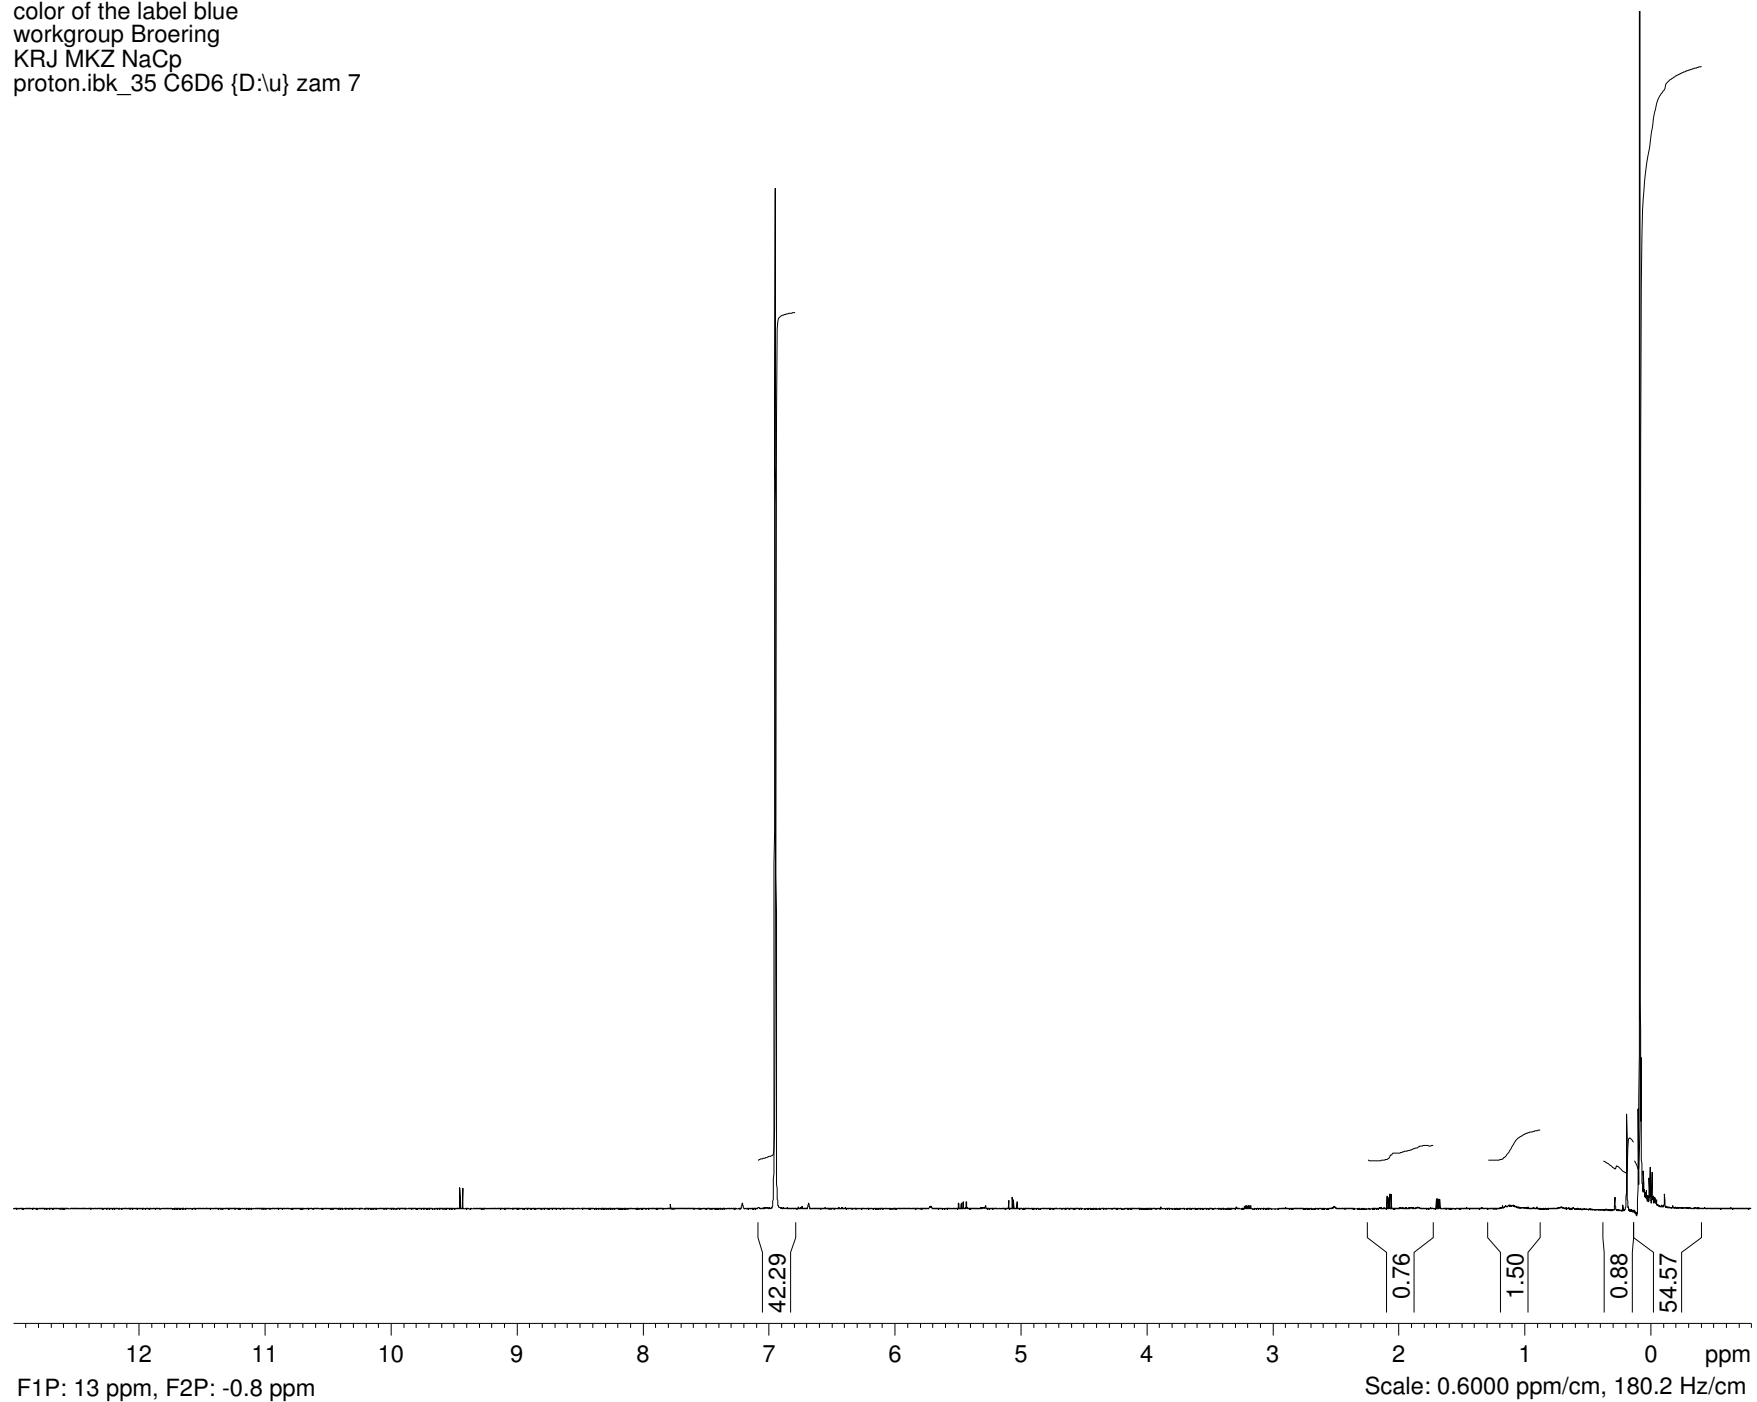

Current Data Parameters
NAME zam-170502-111227_ab
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20170502
Time 11.30 h
INSTRUM AVIIHD300N
PROBHD Z104275_0359 (
PULPROG zg30
TD 49152
SOLVENT C6D6
NS 24
DS 2
SWH 6203.474 Hz
FIDRES 0.252420 Hz
AQ 3.9616511 sec
RG 203.32
DW 80.600 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 300.2618538 MHz
NUC1 1H
P1 12.00 usec
PLW1 10.85099983 W

F2 - Processing parameters
SF 300.2600610 MHz
SR 60.99 Hz
SI 32768
WDW EM
LB 0 Hz
GB 0
SSB 0
PC 1.00