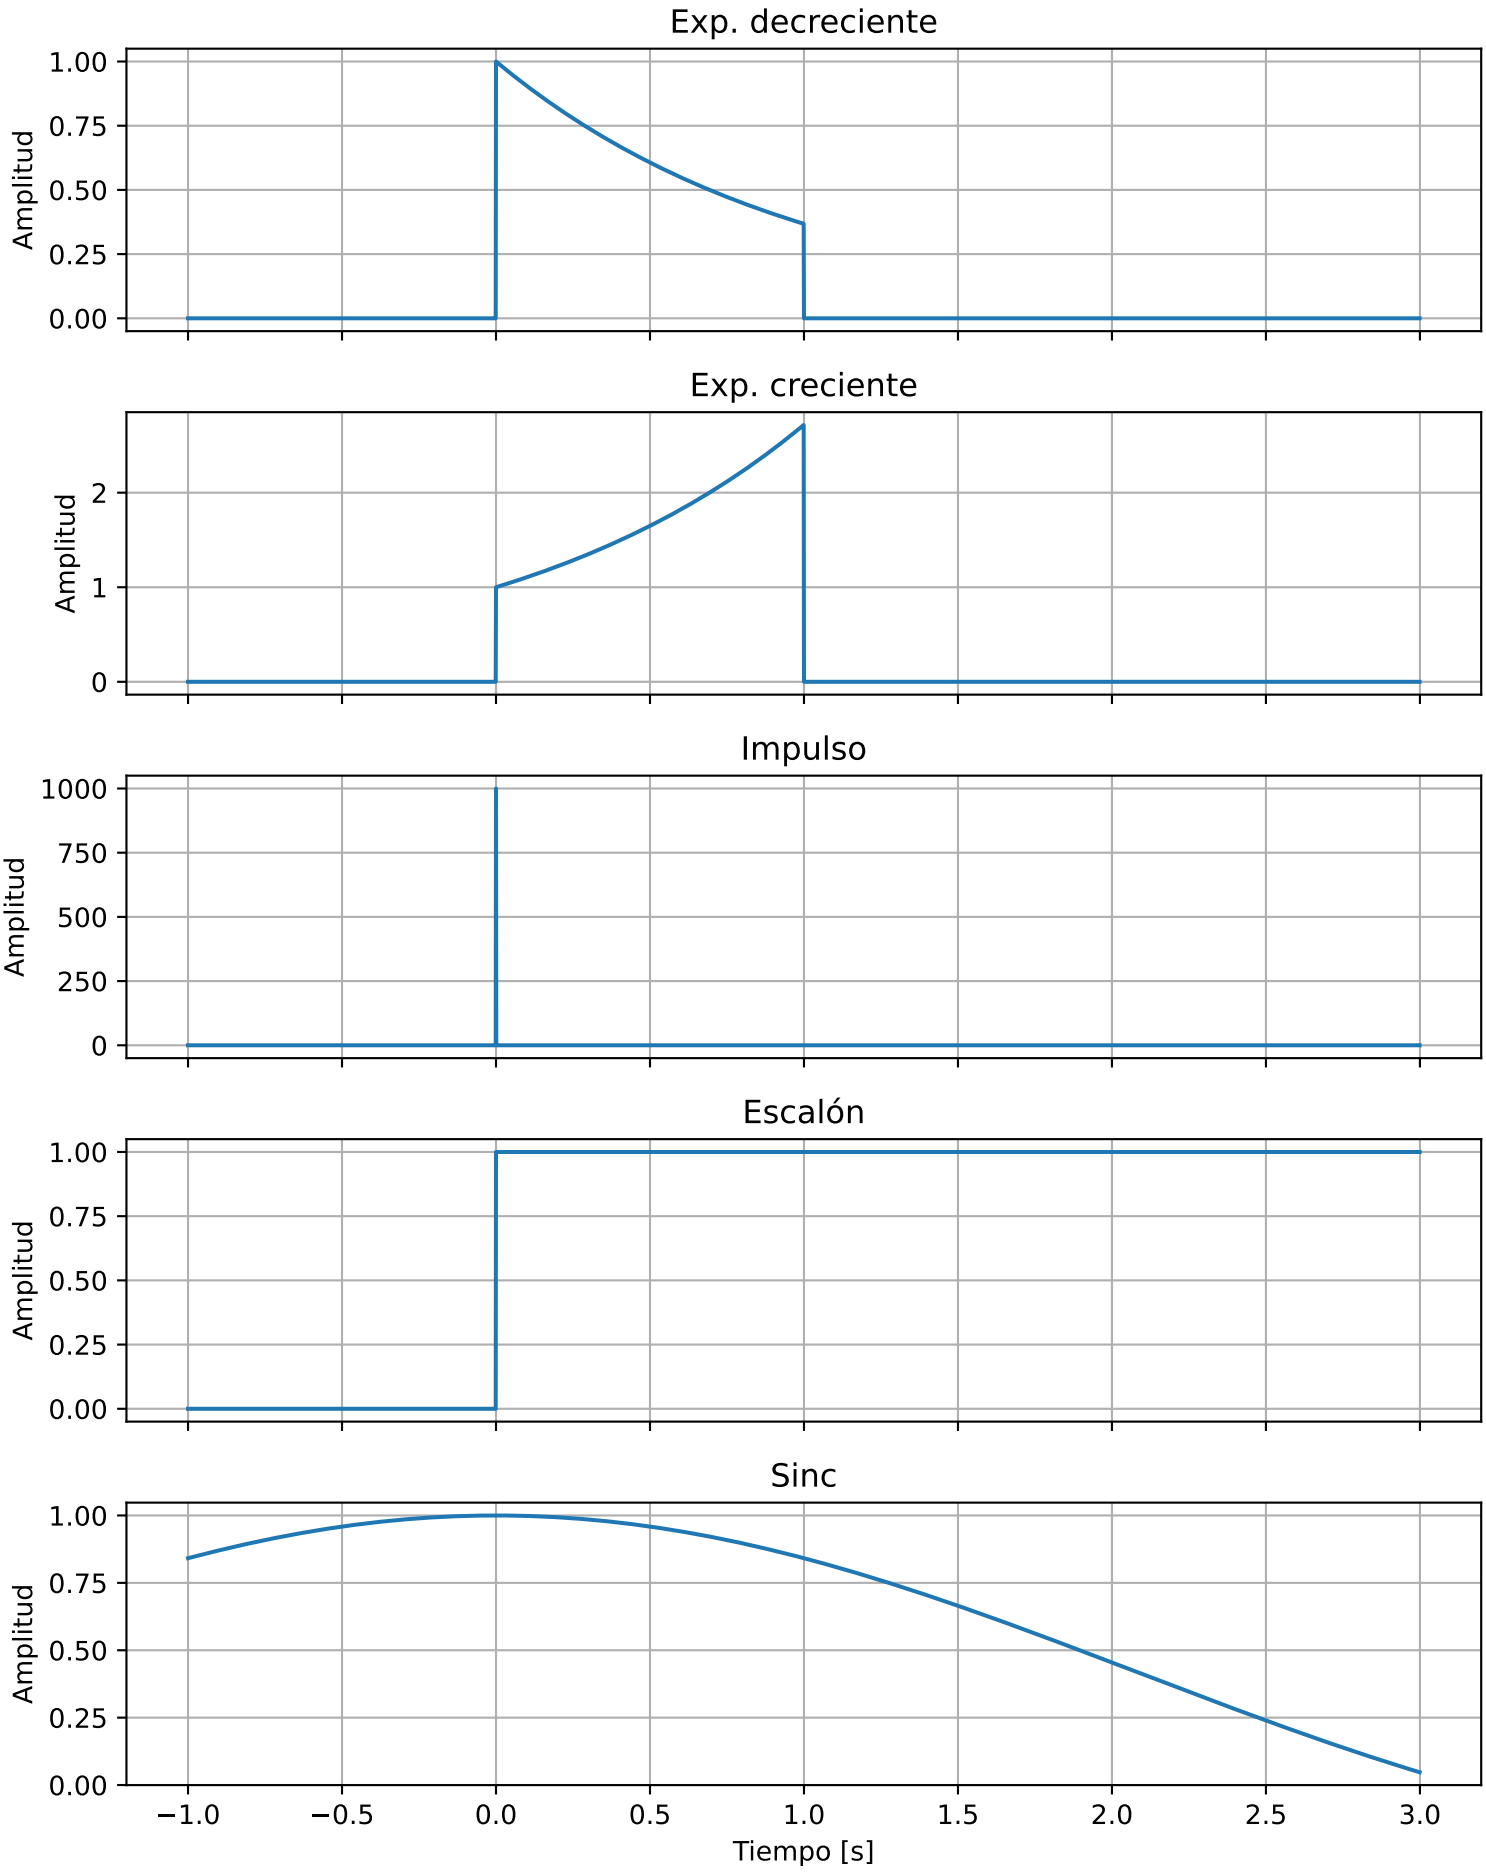
Exp. decreciente
Amplitud
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Exp. creciente
Amplitud
2
1
0
Impulso
Amplitud
1000
750
500
250
0
Escalón
Amplitud
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Sinc
Amplitud
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Tiempo [s]