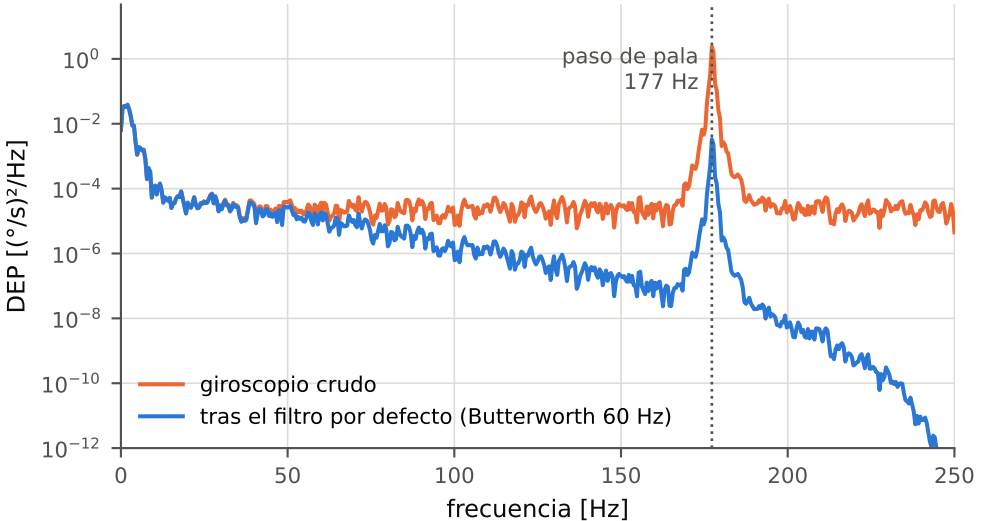
Giroscopio x en hover, muestreado a 500 Hz (Nyquist 250 Hz)
paso de pala
177 Hz
DEP [(°/s)²/Hz]
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-8
10^-10
10^-12
giroscopio crudo
tras el filtro por defecto (Butterworth 60 Hz)
0
50
100
150
200
250
frecuencia [Hz]