

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1806  
CALIBRATION DATE: 09-Dec-11

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999751e-001

rtca1 = 1.903503e-006


rtca2 = -3.322430e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999770	0.9999770	-0.0
4.4999	0.9999830	0.9999830	-0.0
15.0000	0.9999960	0.9999962	0.2
18.5000	0.9999990	0.9999989	-0.1
24.0000	1.0000020	1.0000017	-0.3
29.0000	1.0000020	1.0000024	0.4
32.5000	1.0000020	1.0000019	-0.1

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

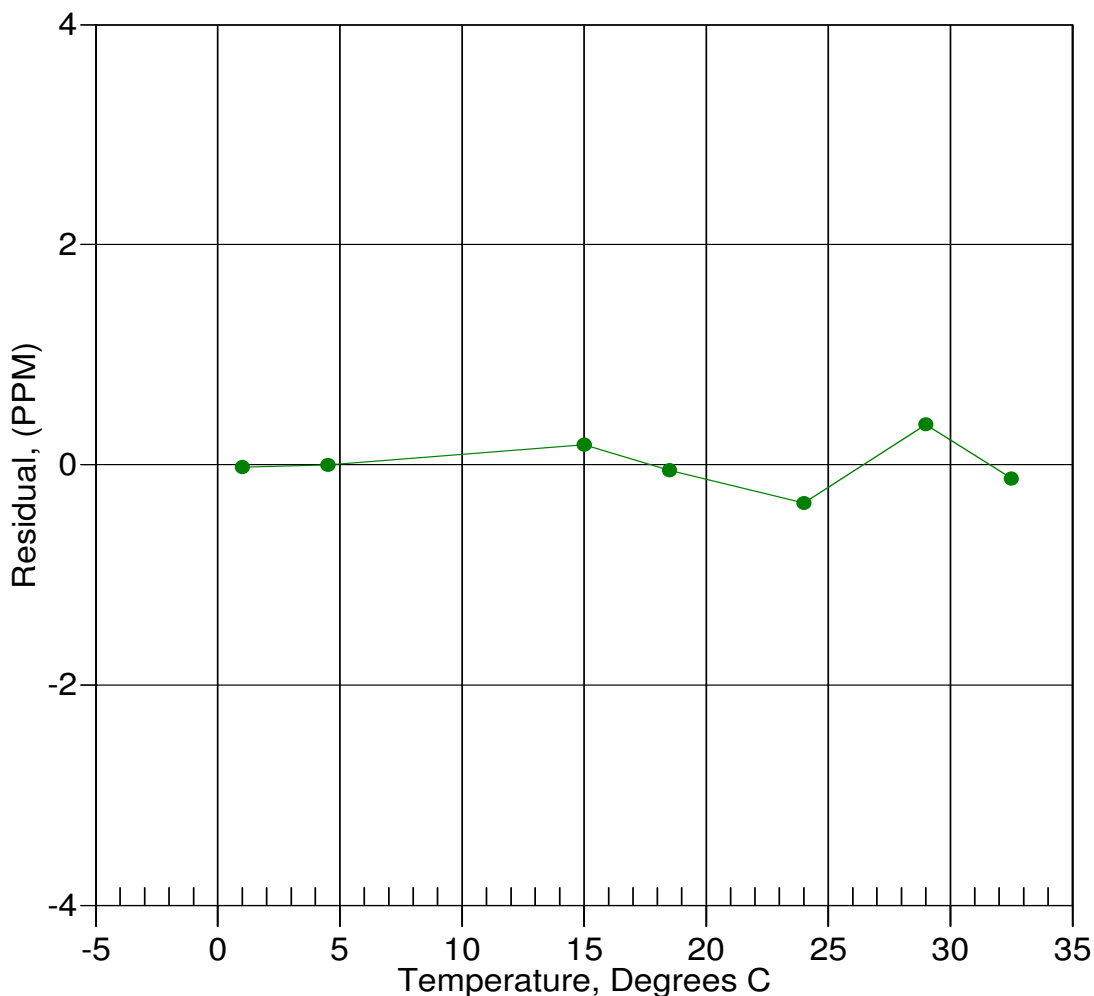

09-Dec-11 0.00