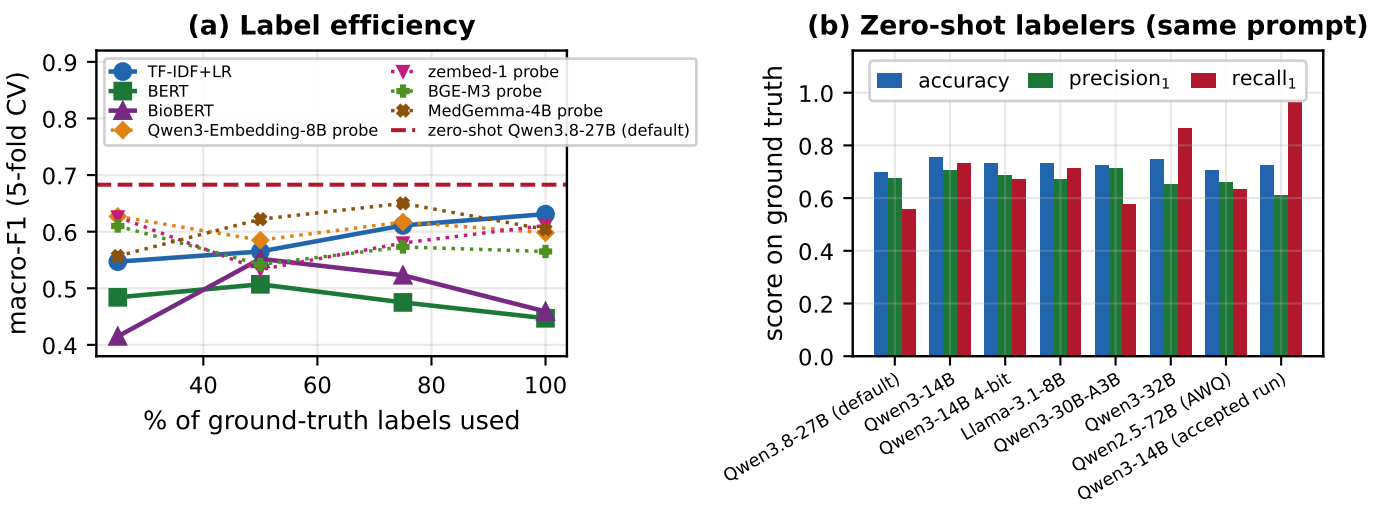
(a) Label efficiency
macro-F1 (5-fold CV)
% of ground-truth labels used
TF-IDF+LR
BERT
BioBERT
Qwen3-Embedding-8B probe
zembed-1 probe
BGE-M3 probe
MedGemma-4B probe
zero-shot Qwen3.8-27B (default)
(b) Zero-shot labelers (same prompt)
score on ground truth
accuracy
precision$_1$
recall$_1$
Qwen3.8-27B (default)
Qwen3-14B
Qwen3-14B 4-bit
Llama-3.1-8B
Qwen3-30B-A3B
Qwen3-32B
Qwen2.5-72B (AWQ)
Qwen3-14B (accepted run)