


在向外EE增强25%的圆核工作点附近，左移有局部改善；TB仍有缺口

● 噪声847101 ▲ 噪声847102 患者FIT参考

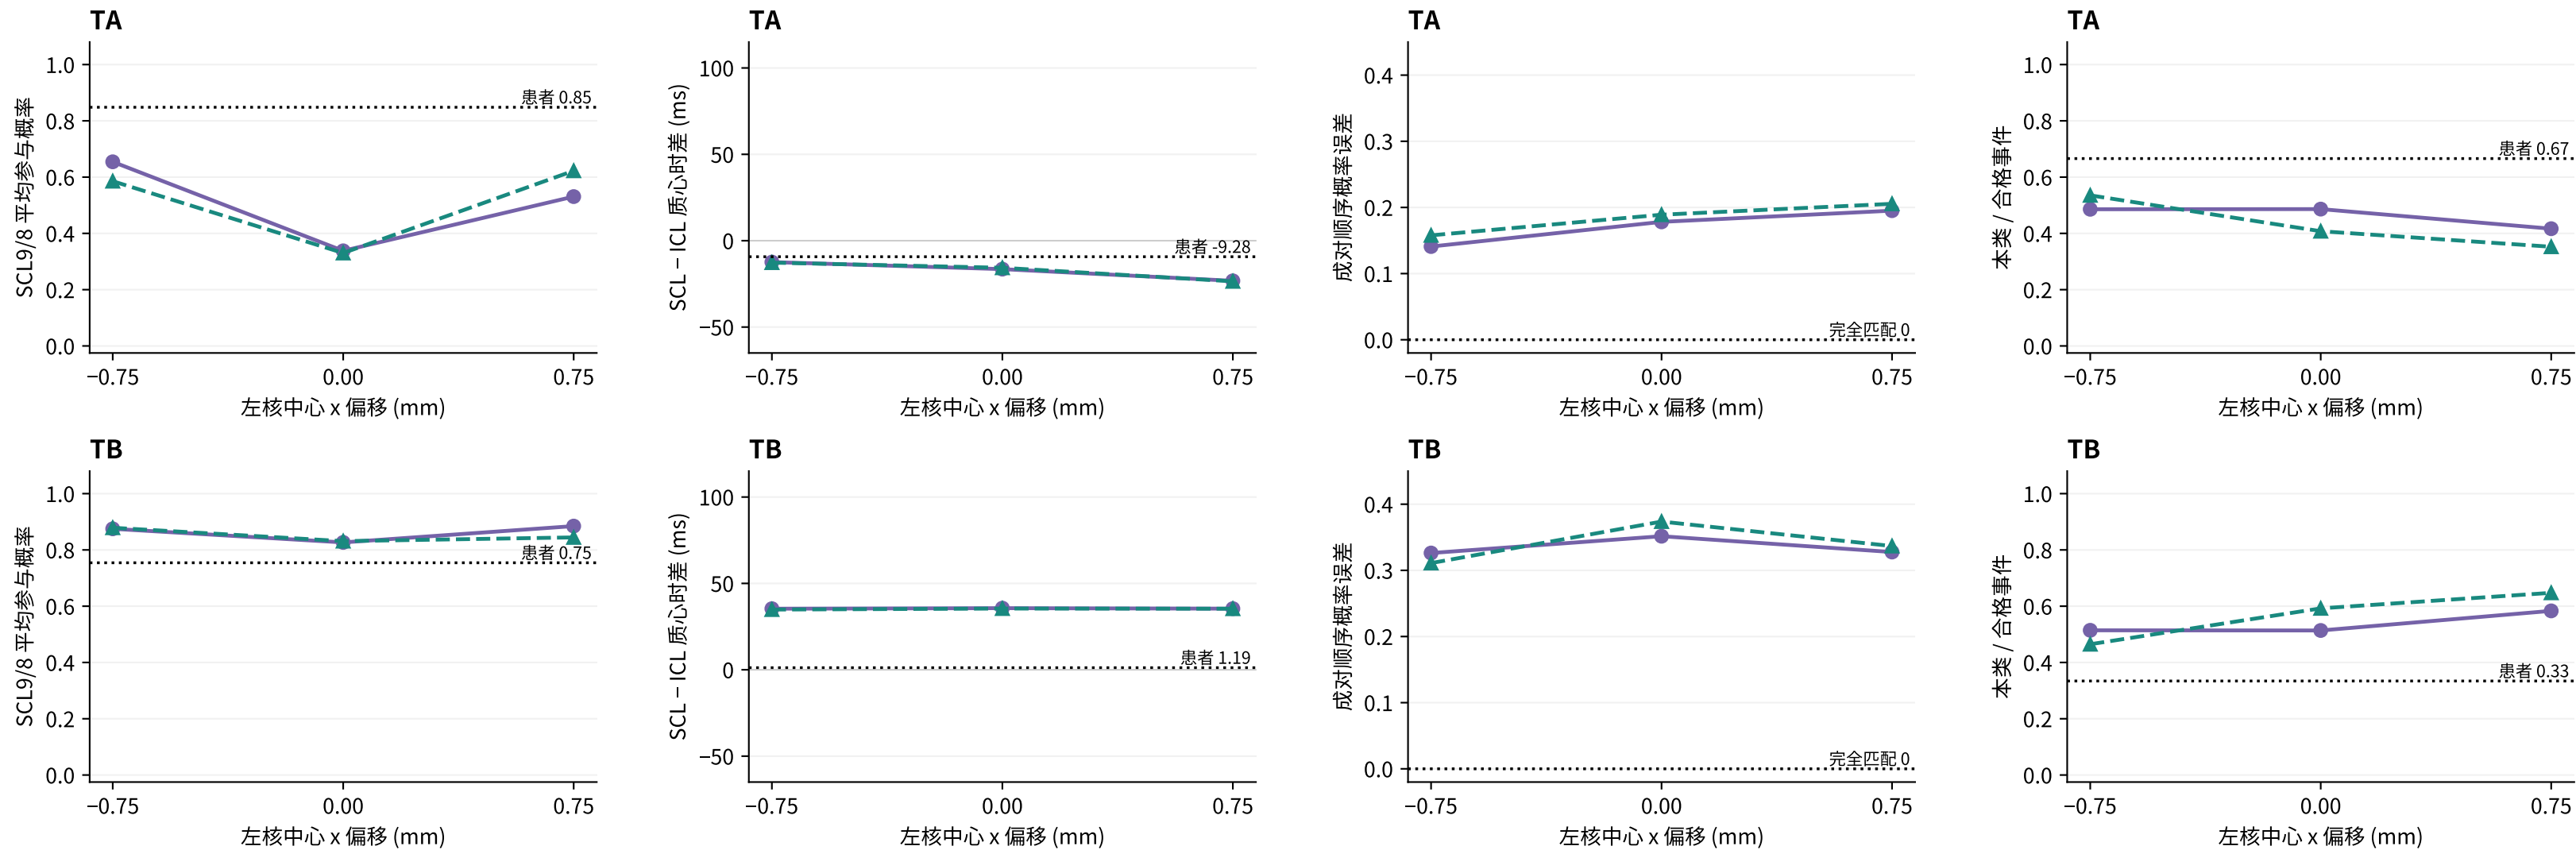

同一网络2511、两次噪声分别配对；y、半径、阈值和连接参数不变，但平移会改变实际成员与邻接。
顺序误差：两触点共同参与时，先后概率与患者之差的绝对值，再在可比较触点对上等权平均；0只表示该摘要完全匹配。
这些是开发数据中的响应，不是已确认的最优位置。下一批将用两张新网络和两条新噪声复测左移及直接对照。